


Exame n.º :722485


CPF :065.382.121-23	Paciente :VANDERSON SILVA DE ALMEIDA	RG :27741885/SESP MT
CNPJ :03.819.157/0011-03	Razão :CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Nascimento :19/06/1995	Idade : 29 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :MONTADOR	
Data do Exame : 28/02/2025		

Orelha Direita

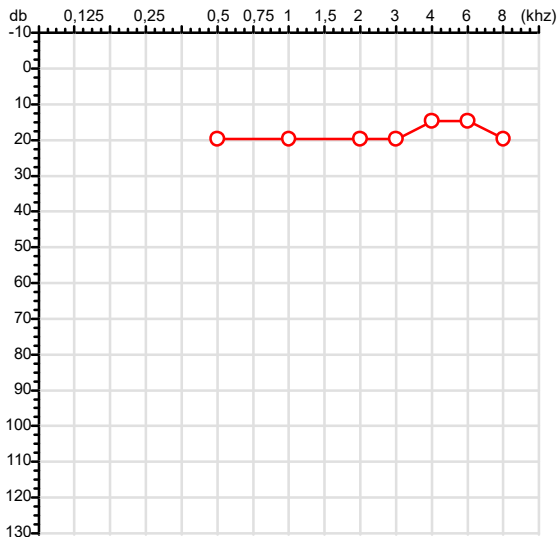

Audiometria

Orelha Esquerda

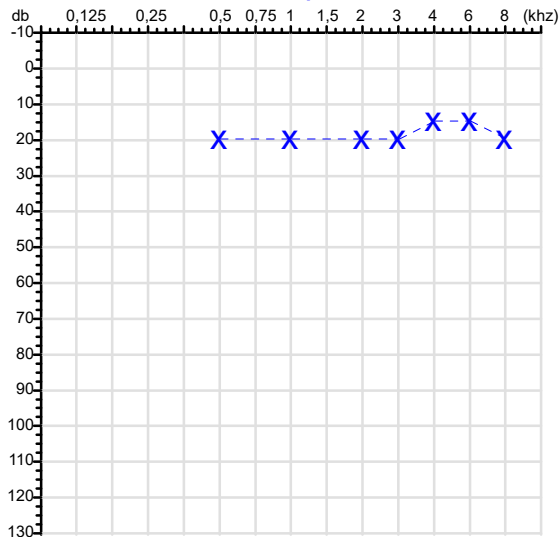

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	15	15	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	15	15	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	15	15	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	15	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejanim da Costa
Médica
 Drª Amanda Bejanim da Costa
 CRM-MT N° 15466
 NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :B234C8ECF239DCDA67506E639967C6A1
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vanderson Silva de Almeida

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2024