



|             |                      |        |            |          |    |             |          |         |                         |                  |       |             |       |
|-------------|----------------------|--------|------------|----------|----|-------------|----------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | JESSICA DAIANE LOPES |        | ID1        | 724024   |    | Sexo        | Feminino | Idade   | 34,4                    | Peso (kg)        | 70,00 | Altura (cm) | 167,0 |
| Agrupamento | --                   | D.O.B. | 18/09/1990 | ID2      | -- | BMI (kg/m2) | 25,1     | Fumante | Sim                     | Anos de Tabag... | 10    | Cig/Dia     | 20    |
| Técnico     | --                   | Médico | --         | Classe 2 |    | --          | Etnia    |         | Outros/Não Especificado |                  |       |             |       |

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:35



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                                                                           |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| FVC         | L | <b>2,93</b> | 3,68 | 79     |  |  |
| FEV1        | L | <b>2,44</b> | 3,10 | 79     |  |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>83,6</b> | 84,5 | 99     |  |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>83,6</b> | 84,5 | 99     |  |  |

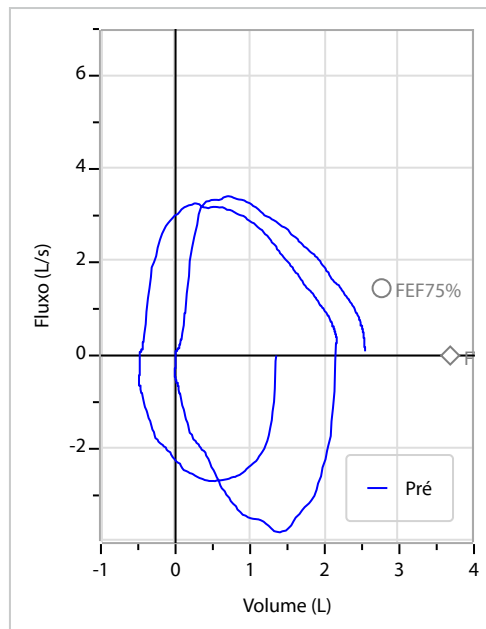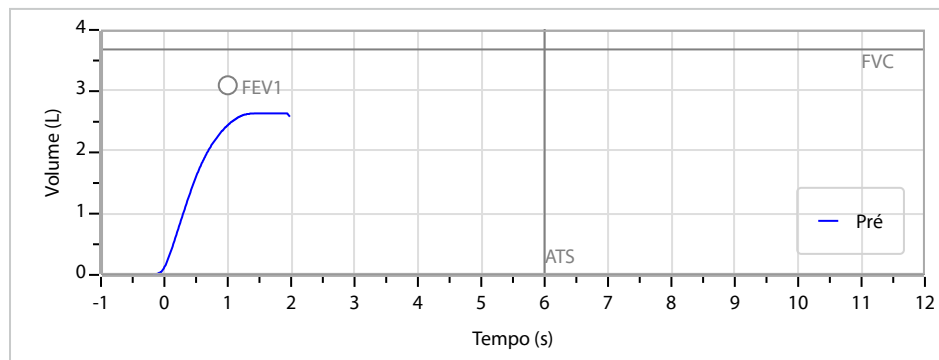

## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 83,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,93 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_


# Exame n.º :724024

CPF :029.087.371-16  
CNPJ :20.404.890/0001-04  
Nascimento :18/09/1990  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 10/03/2025

Paciente :JESSICA DAIANE LOPES  
Razão :FELIPE LUIZ PINHEIRO NORATO CIA LTDA  
Idade : 34 anos  
Setor :GERAL  
Função :CLASSIFICADOR (A)

RG :13102222/SSP MT

## Orelha Direita

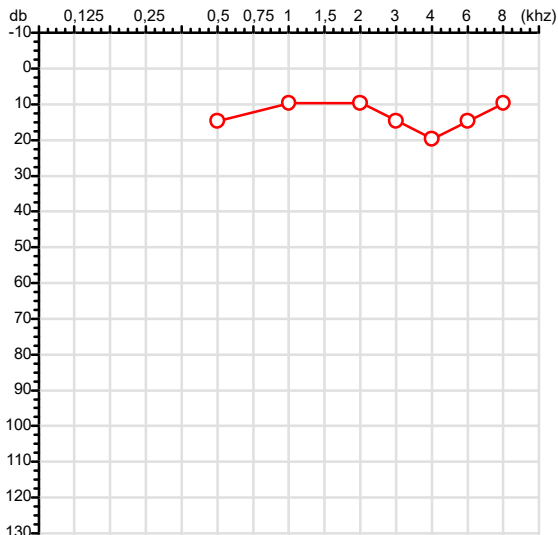

## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 15 | 17 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

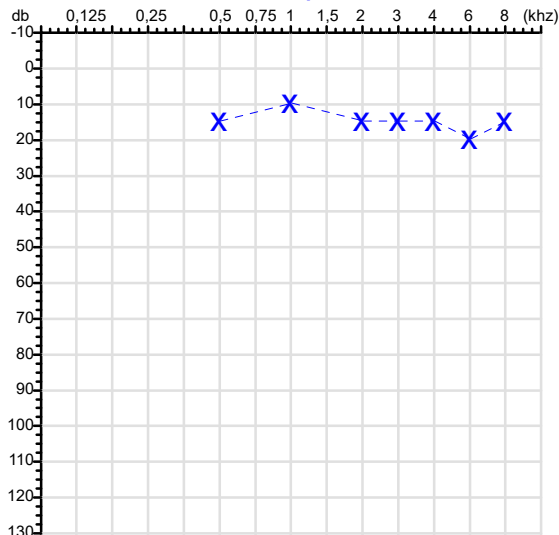

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B9B109C42F0497FC2F08276FB0F24F9F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jessica Daiane Lopes*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024