

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>520002            | Paciente:<br><b>Daniel Luis Lopes Costa</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>29 (A)    |
| Atendido em:<br>13/03/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 10219003629 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/03/2025 Liberado em: 14/03/2025 11:12

### Eritrograma

|                                            |             | Valores de Referência       |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> ..... | <b>4,61</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....                   | <b>13,9</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....                      | <b>42,0</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....                | <b>91,1</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....                | <b>30,2</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....              | <b>33,1</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....                                   | <b>13,9</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                         |                             |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....         | <b>5.180/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
|                         |                             | % /mm <sup>3</sup>                              |
| Neutrófilos.....        | <b>60,3%</b>                | <b>3.124/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....         | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....            | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....        | <b>60,3%</b>                | <b>3.124/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....        | <b>5,4%</b>                 | <b>280/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....          | <b>0,6%</b>                 | <b>31/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos....  | <b>29,1%</b>                | <b>1.507/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.... | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....          | <b>4,6%</b>                 | <b>238/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                    |                               |                                   |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....     | <b>225.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....           | <b>10,9/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito..... | <b>0,244%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....           | <b>14,7</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963


A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 725131  
Primeiro Nome: DANIEL LUIS  
Sobrenome: LOPES COSTA  
Data: 13/03/2025

Data de nascimento: 16/04/1995  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 71.0  
Altura (cm): 190.0

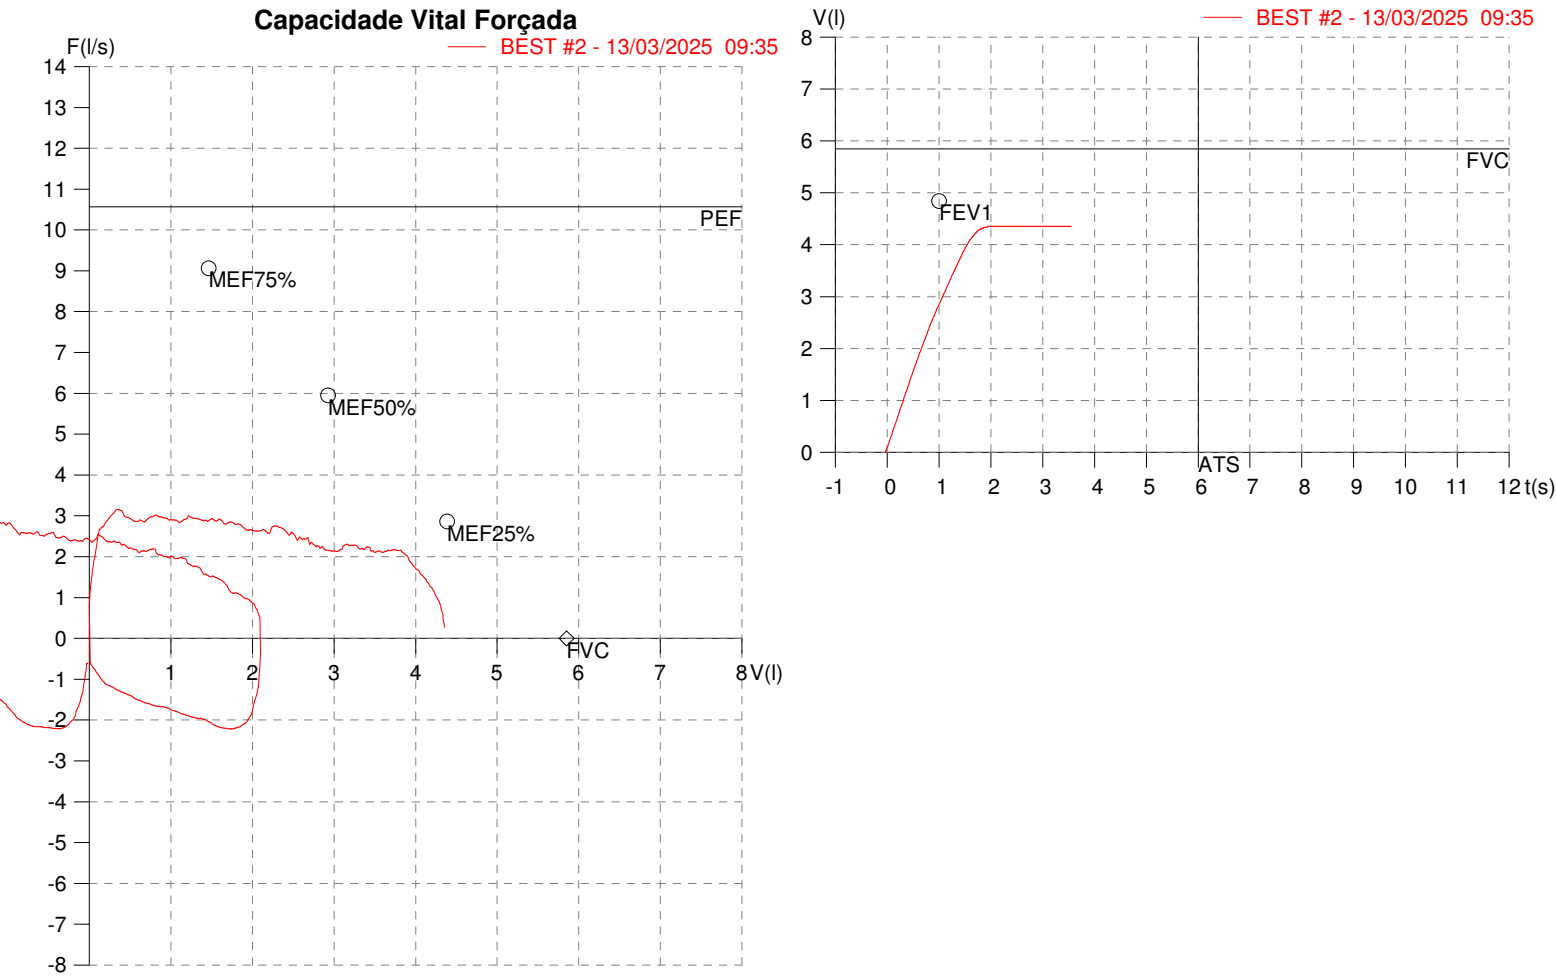

| Parâmetro       | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#2 | % Prev. |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC        | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 5.85  | 4.38   | 74.9    |
| FVC             | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 5.85  | 4.38   | 74.9    |
| FEV1            | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 4.84  | 2.84   | 58.7    |
| PEF             | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 10.57 | 3.15   | 29.8    |
| FEV1/FVC% %     |         | FEV1 em % da FVC                  | 82.0  | 64.8   | 79.1    |
| FEF25-75% l/sec |         | Fluxo expiratório médio forçado   | 5.14  | 2.56   | 49.9    |
| MEF75% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 9.06  | 2.89   | 31.9    |
| MEF50% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.95  | 2.62   | 43.9    |
| MEF25% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.87  | 2.27   | 79.2    |
| FET100% sec     |         | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.9    |         |
| PEFr l/min      |         | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 634.1 | 189.1  | 29.8    |

Diagnóstico:  
Anormalidade MODERADO

Impresso 13/03/2025


# Exame n.º :725131

CPF :102.190.036-29  
CNPJ :37.457.942/0001-03  
Nascimento :16/04/1995  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 13/03/2025

Paciente :Daniel Luis Lopes Costa  
Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Idade : 29 anos  
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

## Orelha Direita

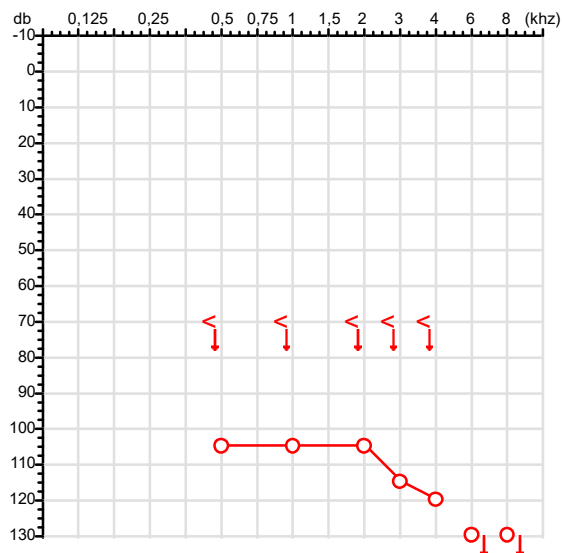

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   | 8   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | 105 | 105 | 105 | 115 | 120 | AUS | AUS |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1   | 2   | =   | 3   | 4   | 6   | =   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 120 | AUS | 122 |


### Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

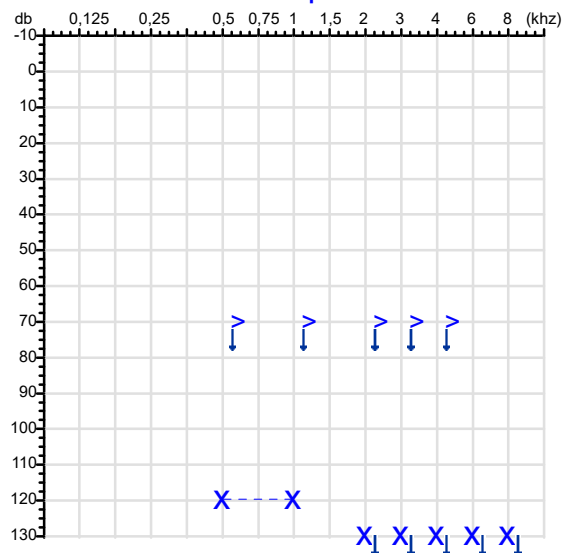

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   | 8   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | 120 | 120 | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | AUS | AUS | AUS | AUS | AUS | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1   | 2   | =   | 3   | 4   | 6   | =   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | 120 | 120 | AUS | 123 | AUS | AUS | AUS | 130 |

### Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :80C5D23700F0E4DC9394613B3C00C7DC  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Daniel Luis Lopes Costa**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024