



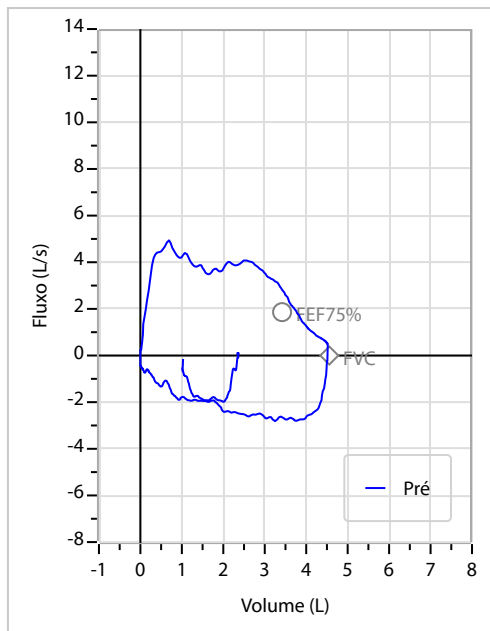

Nome	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA		ID1	726180	Sexo	Masculino	Idade	26,3	Peso (kg)	74,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	04/11/1998	--	BMI (kg/m2)	25,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:34	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,53	4,56	99	<	

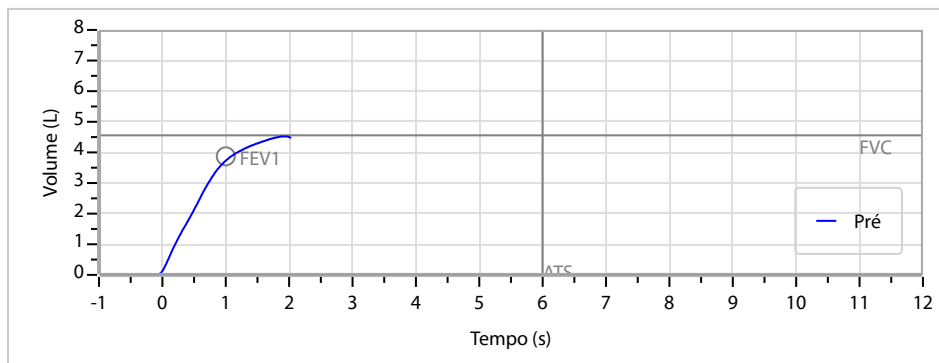

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 81,9% e um valor FVC de 4,53 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo : 2503181145419 Data : 18/03/2025
Paciente : PEDRO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA
Nasc. : 04/11/1998 RG : CPF : 06181408169
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=279508672791099573559399206070>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57590454000187 Fantasia : MUNDO DA OBRA
Razão Social : OBRATUDO ATACAREJO DA CONSTRUCAO LTDA
Endereço : ROD PALMIRO PAES DE BARROS N.º 290 Complemento : LOTE A
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78085702

Funcionário

Nome : Pedro Henrique Gomes de Almeida Setor: GERAL
CPF : 06181408169 Cargo: ASSISTENTE DE VENDAS
RG : / Nascimento: 04/11/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de março de 2025


Alexandra Fonseca de Anunciação
Médica
CRM-MT 14029

Drª Alexandra Fonseca de Anunciação

CRM-MT N° 14029

Autenticação Assintatura :2725593FD97A5512029C4D01F900AB57
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 2503181139519

Data : 18/03/2025

Paciente : PEDRO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA

Nasc. : 04/11/1998 RG :

CPF : 06181408169

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=868197649149744245828637362840>



Exame n.º :726180


CPF :061.814.081-69
CNPJ :57.590.454/0001-87
Nascimento :04/11/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/03/2025

Paciente :Pedro Henrique Gomes de Almeida
Razão :OBRATUDO ATACAREJO DA CONSTRUCAO LTDA
Idade : 26 anos
Setor :GERAL
Função :ASSISTENTE DE VENDAS


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

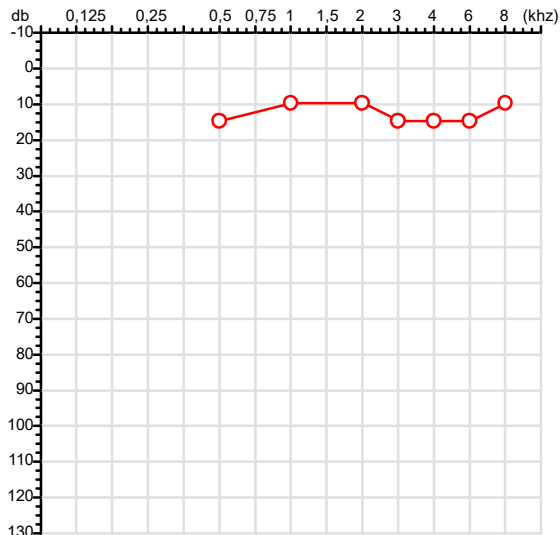

Orelha Esquerda

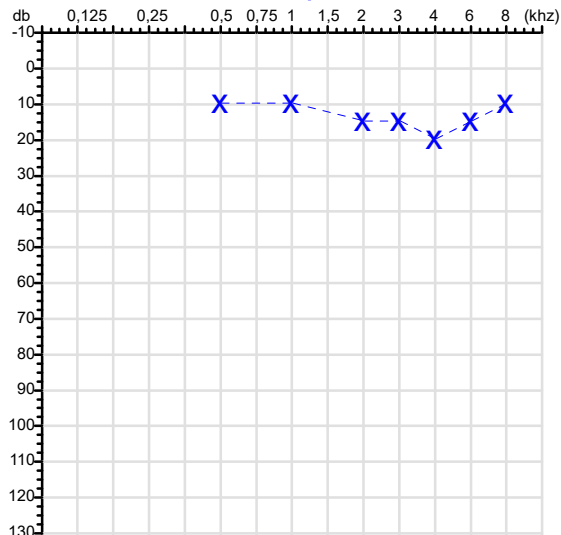

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	20	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9D6BCD02DECB7703C28B45B9AAE5B7F0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Pedro Henrique Gomes de Almeida*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024