



|             |                          |        |            |          |        |             |                         |         |      |                  |       |             |       |
|-------------|--------------------------|--------|------------|----------|--------|-------------|-------------------------|---------|------|------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | CLEBER OLIVEIRA DA SILVA |        |            | ID1      | 727019 | Sexo        | Masculino               | Idade   | 38,5 | Peso (kg)        | 89,00 | Altura (cm) | 176,0 |
| Agrupamento | --                       | D.O.B. | 16/08/1986 | ID2      | --     | BMI (kg/m2) | 28,7                    | Fumante | Não  | Anos de Tabag... | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                       | Médico | --         | Classe 2 | --     | Etnia       | Outros/Não Especificado |         |      |                  |       |             |       |

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:45



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score                |  |
|-------------|---|-------|------|--------|------------------------|--|
| FVC         | L | 3,60  | 4,75 | 76     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | 3,42  | 3,88 | 88     | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | 95,0  | 82,0 | 116    | <div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | 95,0  | 82,0 | 116    | <div><div></div></div> |  |

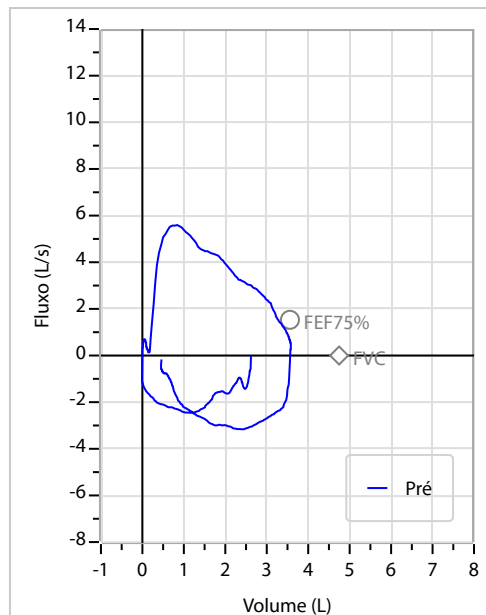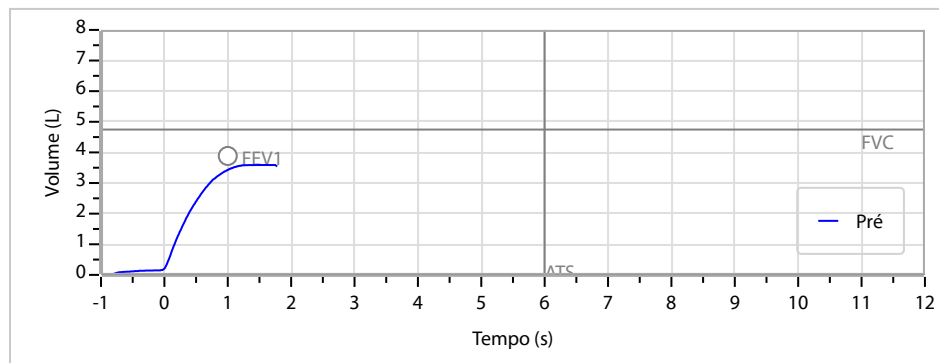

## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,60 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 18111

## Exame n.º :727019


CPF :009.777.951-28  
CNPJ :20.729.709/0010-20  
Nascimento :16/08/1986  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 21/03/2025

Paciente :Cleber Oliveira da Silva  
Razão :CONSTRUTORA NSG LTDA  
Idade : 38 anos  
Setor :GERAL  
Função :AUXILIAR DE MANUTENCAO


RG :16316274/SSP/MT

## Audiometria

## Orelha Direita

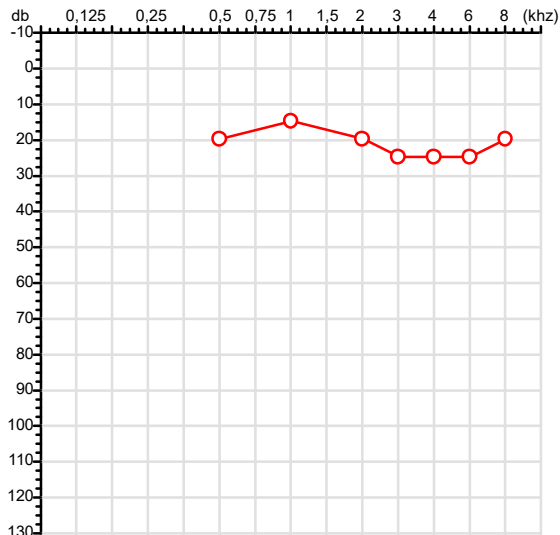

## Orelha Esquerda

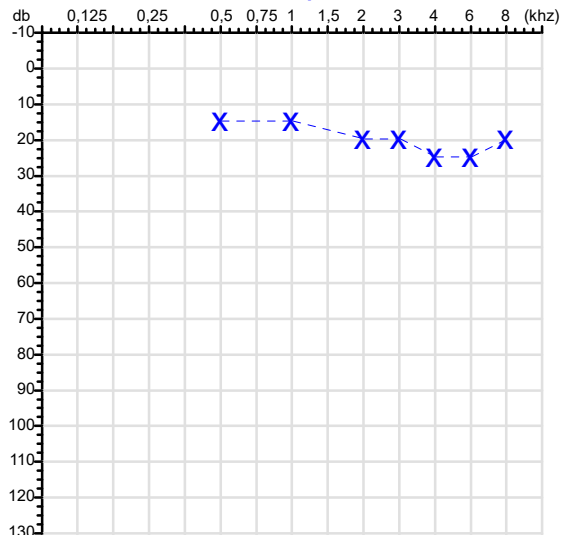

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 20 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :0C73A3B2C245475AD8CF4332556FAEB0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Cleber Oliveira da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024