



CPF :110.762.568-80 Paciente :REINALDO MACIEL DE SOUZA RG :/
 CNPJ :36.920.895/0001-20 Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA
 Nascimento :10/03/1971 Idade : 54 anos
 Motivo :Periódico Setor :FORMAS / FABRICACAO ARTEFATOS DE CONCRETO
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE PRODUCAO
 Data do Exame : 14/04/2025

Audiometria

Orelha Direita

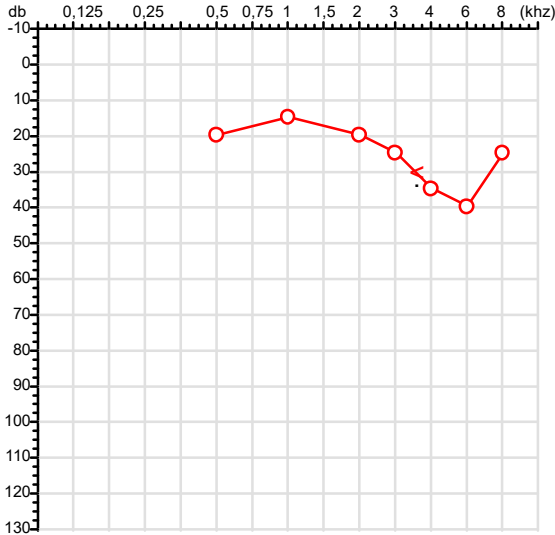

Orelha Esquerda

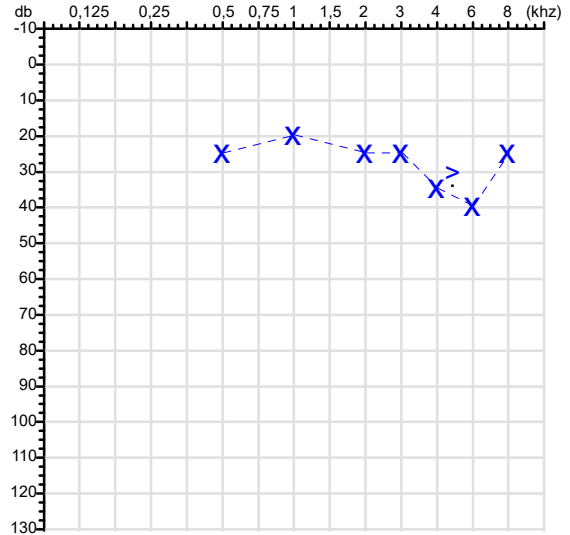

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	35	40	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	25	35	40	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	35	40	33

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	25	35	40	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :73CEC651BE466FD5819BD9C20DD9DCB5
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Reinaldo Maciel de Souza
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024