


Exame n.º :737061

CPF :026.622.841-02
CNPJ :26.163.786/0001-51
Nascimento :24/02/1987
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 06/05/2025

Paciente :Helton Junior Luz de Araujo
Razão :PRIME INOX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS METALURGICOS LTDA ME
Idade : 38 anos
Setor :GERAL
Função :ENCARREGADO DE PRODUCAO

RG :16809475/SSP/MT

Orelha Direita

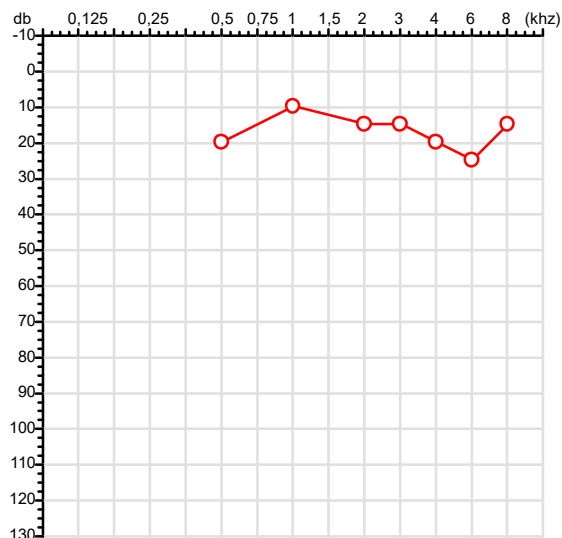

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :94465570C6D41FA78A8C678D1271EED9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Helton Junior Luz de Araujo


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

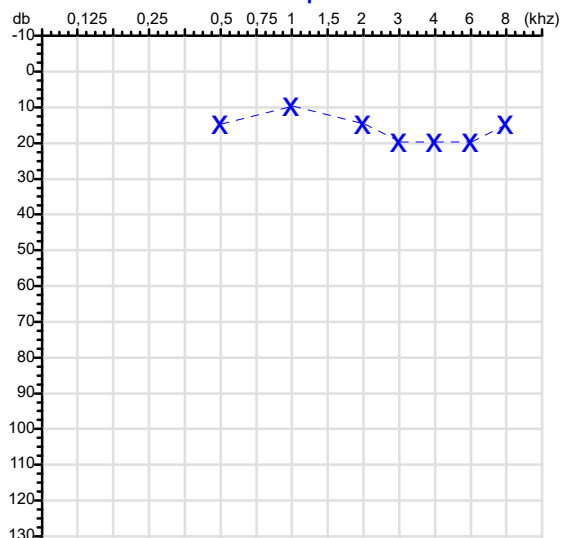

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 737061
Primeiro Nome: HELTON JUNIOR
Sobrenome: D ARAUJO
Data: 06/05/2025

Data de nascimento: 24/02/1987
Sexo: Macho
Peso (kg): 72.0
Altura (cm): 175.0

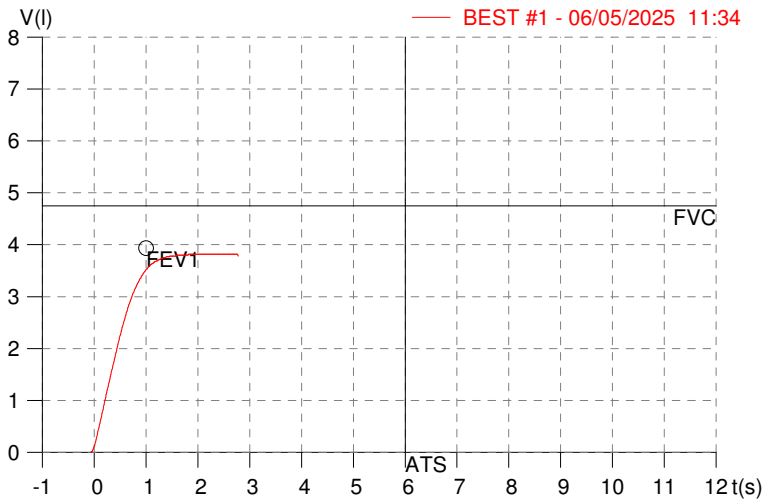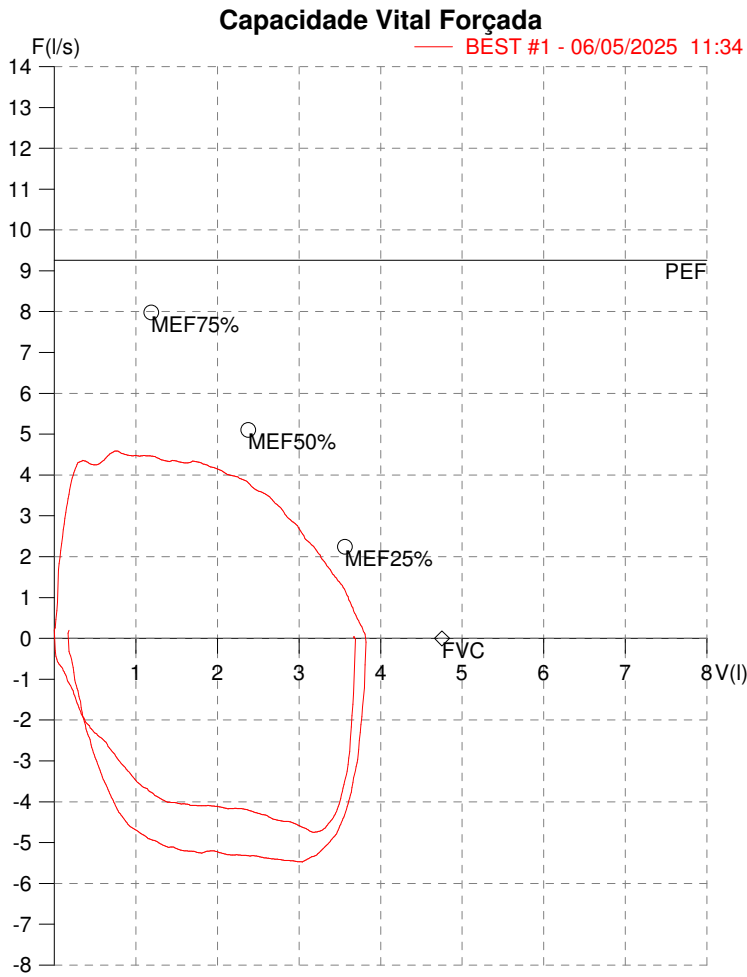

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.75	3.83	80.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.75	3.83	80.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.93	3.51	89.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.26	4.59	49.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.47	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.4	91.5	113.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.46	3.97	89.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.98	4.47	56.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.10	4.20	82.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.24	2.96	132.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	555.7	275.3	49.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 06/05/2025