


Exame n.º :737649

CPF :062.021.461-92
CNPJ :07.175.357/0001-50
Nascimento :05/03/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/05/2025

Paciente :Jairson de Abreu Bento
Razão :TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA
Idade : 28 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

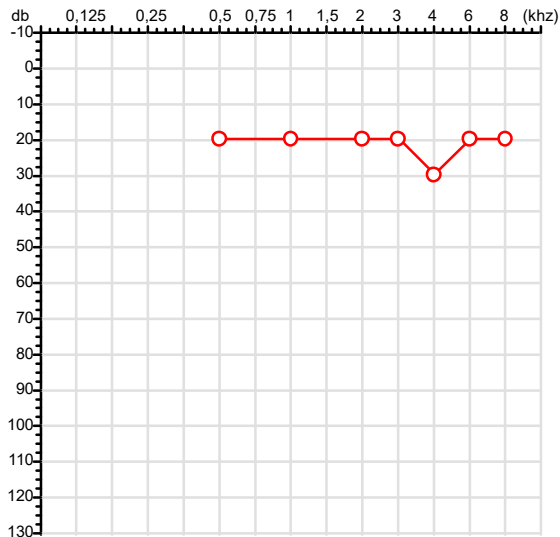

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	30	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	30	20	23


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

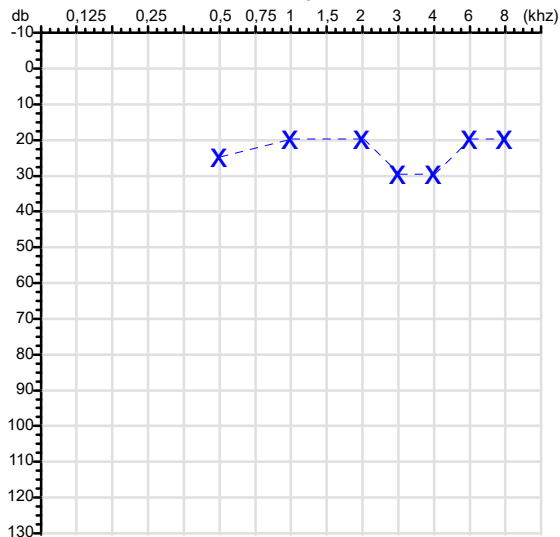

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	30	30	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	30	30	20	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :69977C410DD8AC39FBD2F7F802A7066E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jairson de Abreu Bento



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 08/05/2025
Primeiro Nome:jairson de abreu
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 106.0

Data de nascimento:05/03/1997
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

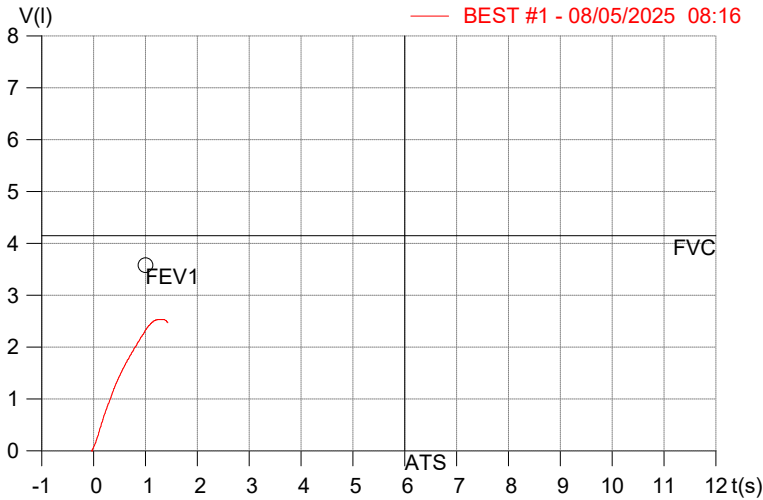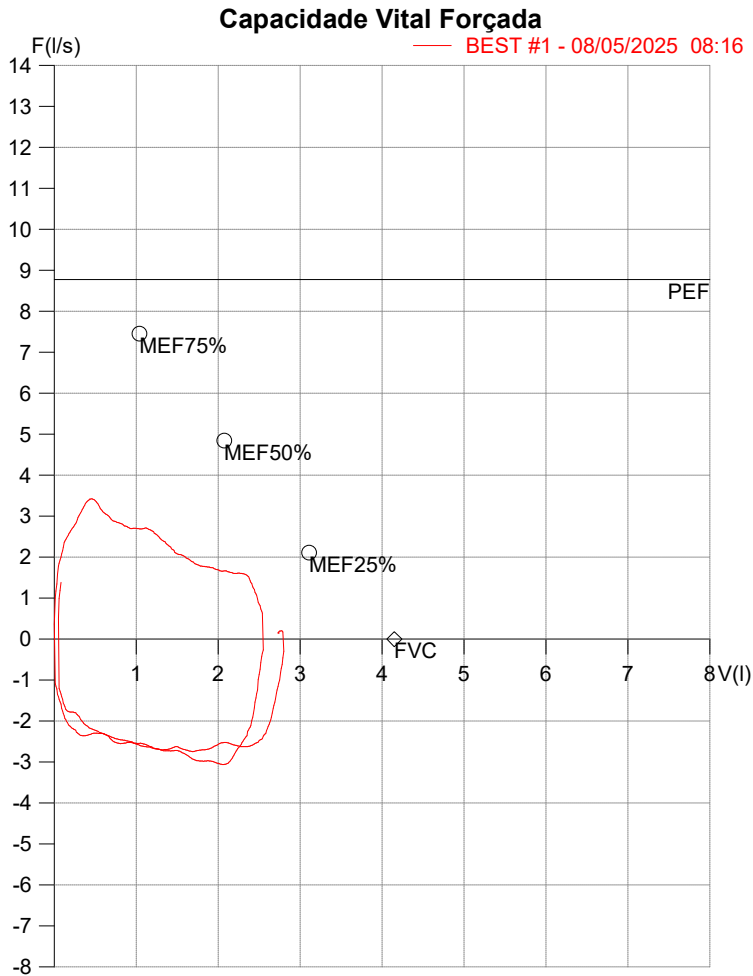

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.15	2.56	61.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.15	2.56	61.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.58	2.31	64.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.77	3.42	39.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.06	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.2	90.4	110.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.60	2.31	50.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.45	3.01	40.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.85	2.49	51.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.11	1.75	82.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	526.2	205.3	39.0

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado