


Exame n.º :738377

CPF :701.536.726-25
CNPJ :07.175.357/0001-50
Nascimento :25/03/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/05/2025

Paciente :Elielton Gomes Dos Santos
Razão :TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA
Idade : 30 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

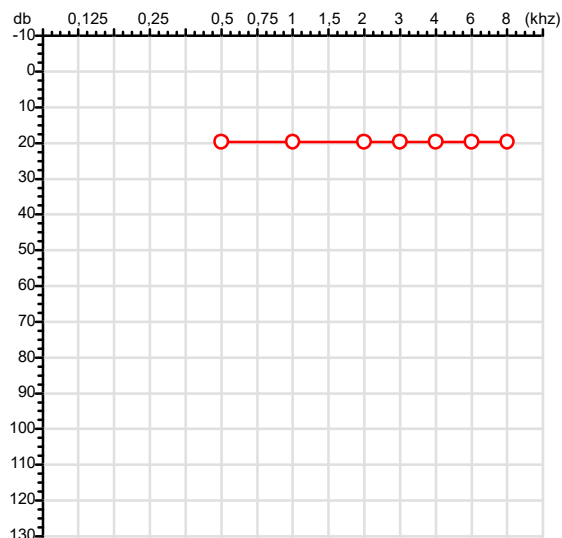

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

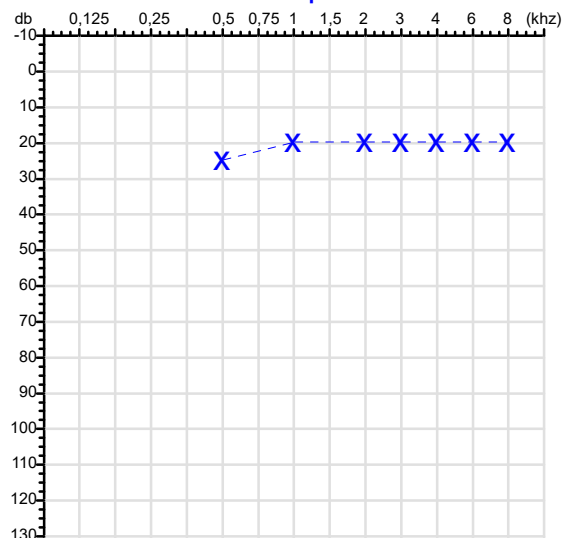

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :013CC62BB9922E1D6339C379BADA5298

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elielton Gomes Dos Santos

**** Assinado por biometria ****



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 12/05/2025
Primeiro Nome: ELIENTON GOMES
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 25/03/1995
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

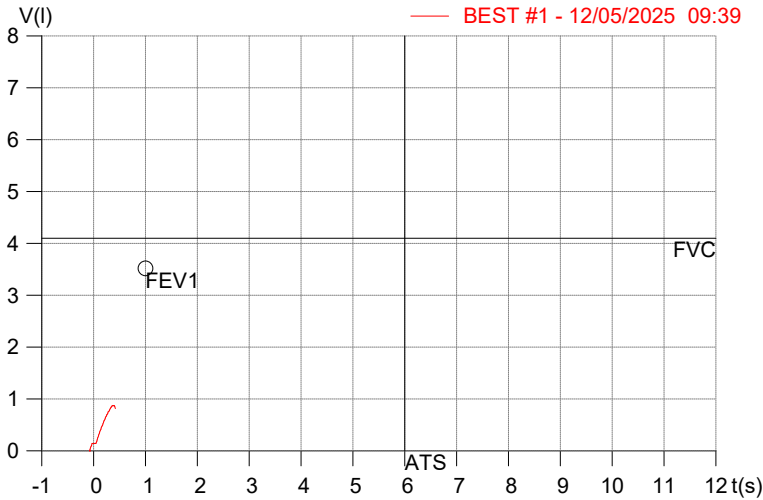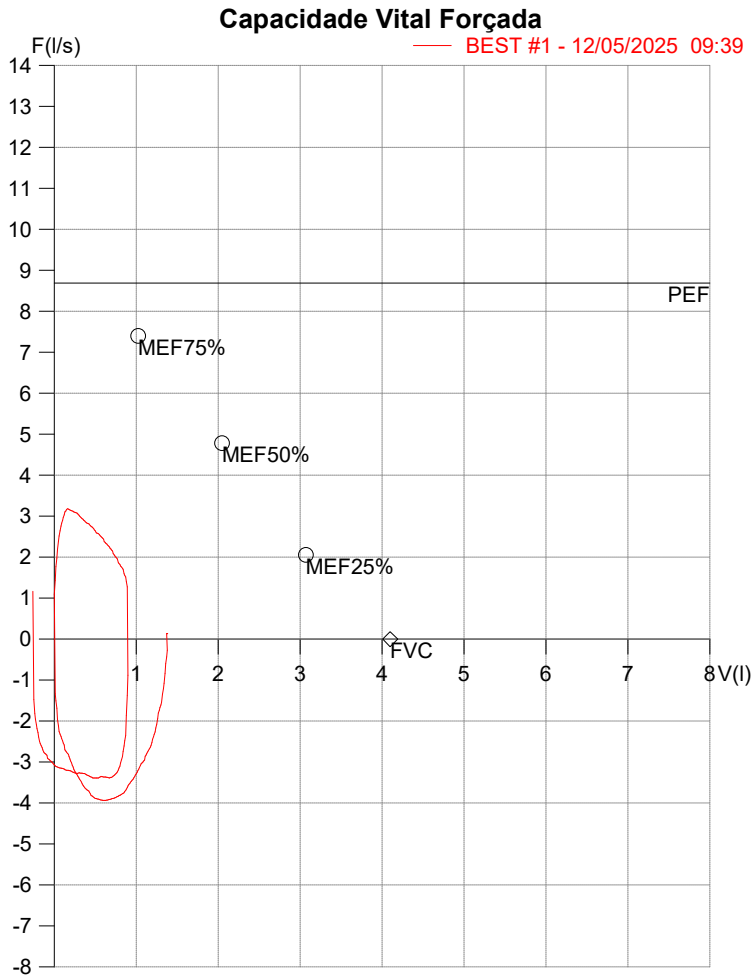

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.10	0.92	22.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.10	0.92	22.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.68	3.18	36.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.39	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.51	2.70	59.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.40	3.11	42.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.78	2.77	57.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.06	2.25	109.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	521.0	190.9	36.6

Diagnóstico:
Espirometria normal