



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61838884000657 Fantasia : DISTRIBUIDORA CUMMINS BRASIL
Razão Social : CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA
Endereço : AV. RIO BRANCO N.º 116 Complemento : 10º ANDAR
Cidade / UF : RIO DE JANEIRO / RJ CEP : 20040001

Funcionário

Nome : Beatriz Amanda Gomes Ferreira Setor: GERAL
CPF : 10175438102 Cargo: APRENDIZ
RG : / Nascimento: 29/04/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :BC7A67E96299E00A4E5C1018257AF8C9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :738388


CPF :101.754.381-02
CNPJ :01.430.943/0001-17
Nascimento :29/04/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/05/2025

Paciente :Beatriz Amanda Gomes Ferreira
Razão :CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA
Idade : 21 anos
Setor :GERAL
Função :APRENDIZ


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

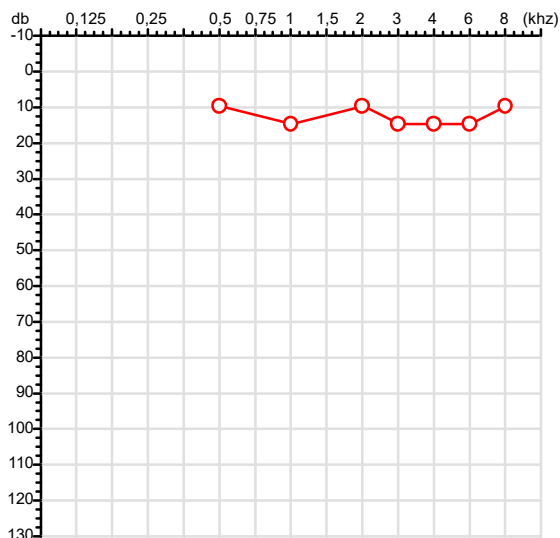

Orelha Esquerda

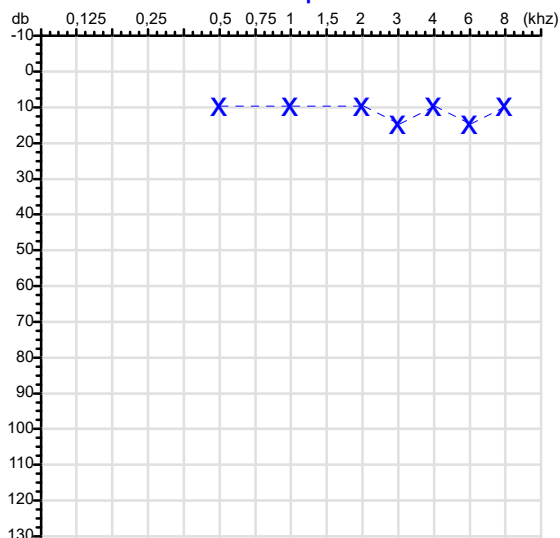

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	15	15	15	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :40A18B5C6F0C62C9A362707BF07EA0A1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Beatriz Amanda Gomes Ferreira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024