

Exame n.º :738937


CPF :631.849.231-34
CNPJ :18.229.874/0001-80
Nascimento :11/09/1975
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/05/2025

Paciente :JORGE ANTONIO FARIAS DA COSTA
Razão :AD MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Idade : 49 anos
Setor :GERAL
Função :MARCENEIRO


RG :09019766/SSP GO

Audiometria

Orelha Direita

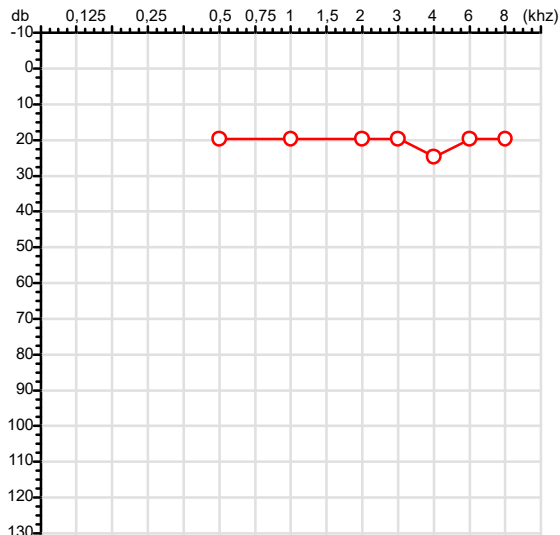

Orelha Esquerda

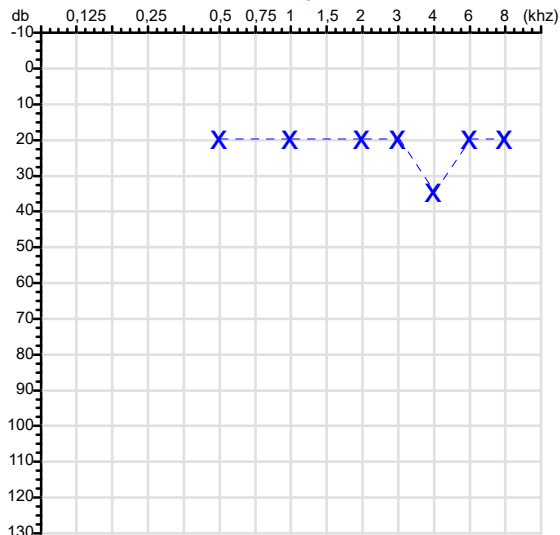

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	35	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	35	20	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :4DE9D0EC3A80DD3FA0483490E11C4938

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>Jorge Antonio Farias da Costa

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 14/05/2025
Primeiro Nome: JORGE ANTONIO FARIAS
Sobrenome: DA COSTA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 11/09/1975
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

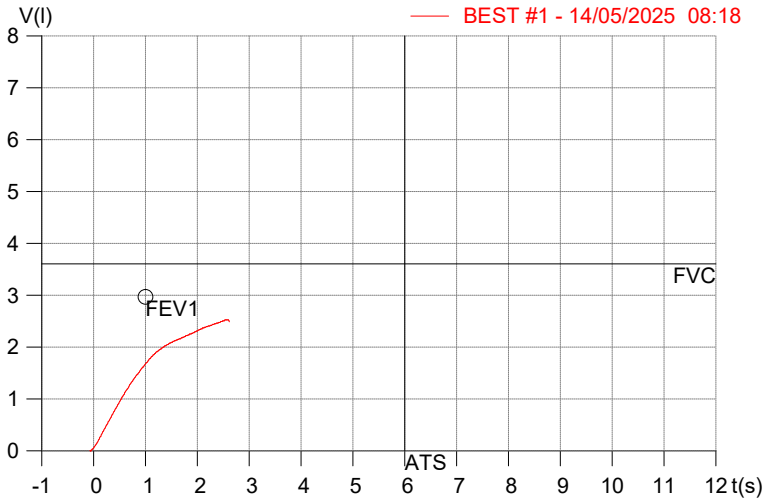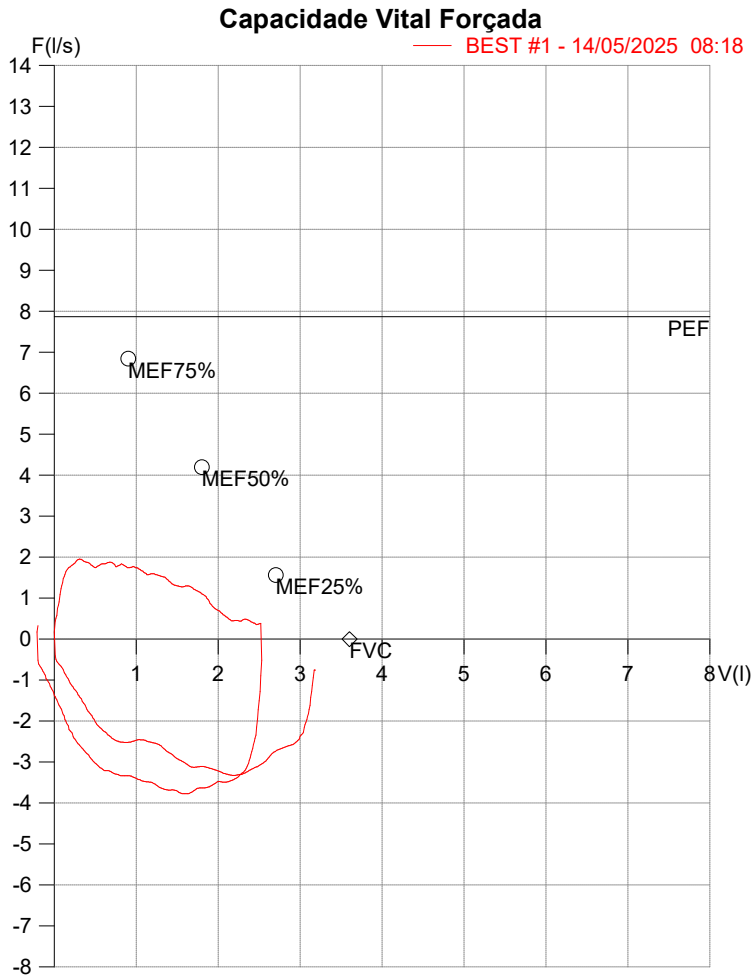

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.60	2.54	70.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.60	2.54	70.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.97	1.67	56.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.87	1.95	24.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.78	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.4	65.6	83.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.70	1.46	39.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.85	1.83	26.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.20	1.56	37.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.56	0.92	58.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	472.0	116.9	24.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada