

Exame n.º :739818


CPF :058.476.061-25
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :16/05/1990
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 16/05/2025

Paciente :JIUMAR BENEDITO DE JESUS
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 35 anos
Setor :TRANSPORTE
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

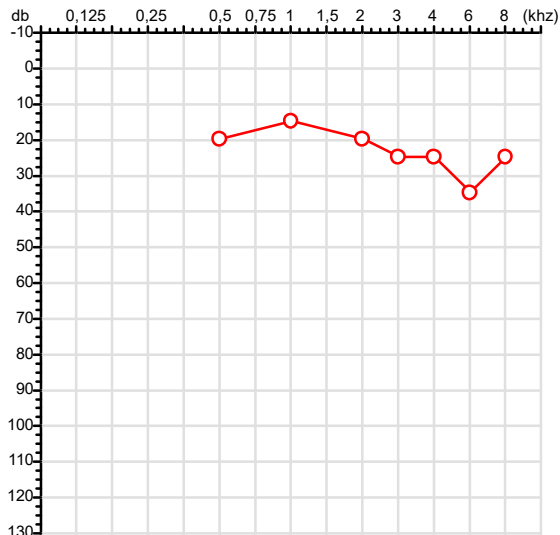

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

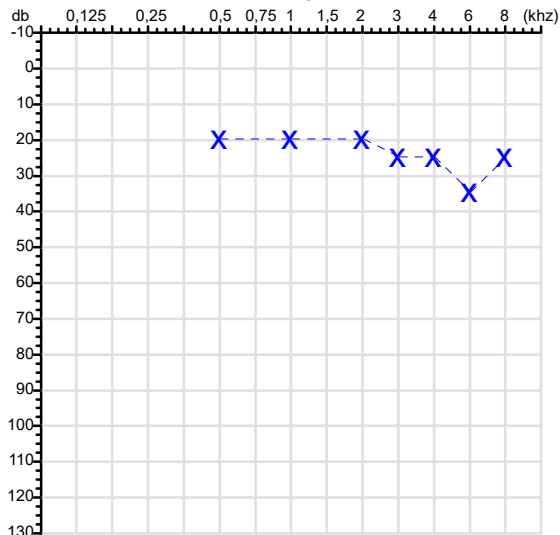

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :08B4CA87136622DDD7A970C72ED7E593

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Jiumar Benedito de Jesus*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 739818
Primeiro Nome: Jiumar Benedito
Sobrenome:
Data: 16/05/2025

Data de nascimento: 16/05/1990
Sexo : Macho
Peso (kg): 120.0
Altura (cm): 170.0

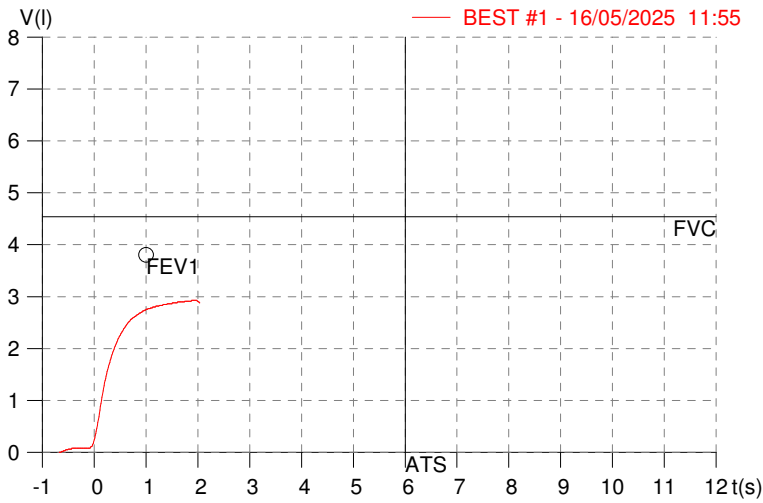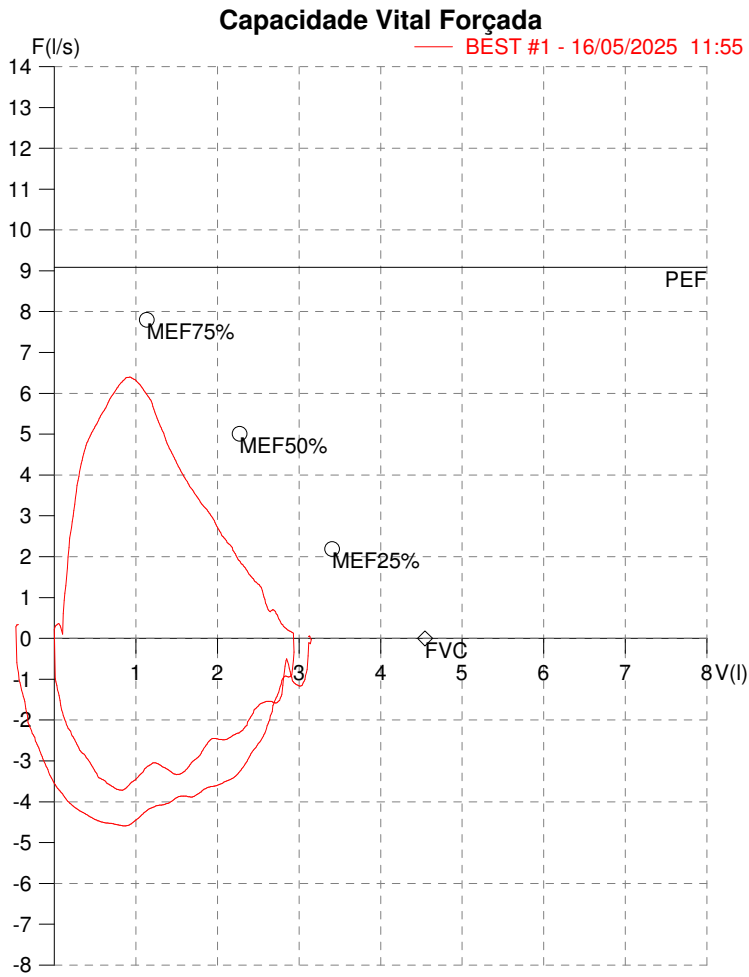

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.54	2.95	64.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.54	2.95	64.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.80	2.76	72.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.08	6.40	70.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.59	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.9	93.5	115.5
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.49	3.95	88.0
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.80	6.04	77.5
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.01	4.43	88.4
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	2.15	98.5
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	545.0	383.8	70.4

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada

Impresso 16/05/2025