
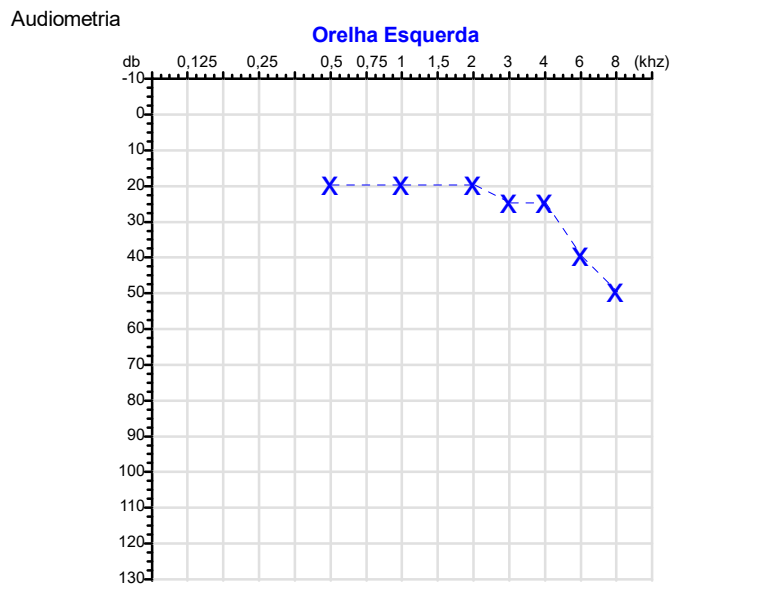


CPF :474.305.081-20	Paciente :CARLOS ROBERTO AKERLEY	RG :/
CNPJ :36.920.895/0001-20	Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA	
Nascimento :11/10/1969	Idade : 55 anos	
Motivo :Periódico	Setor :FORMAS / FABRICACAO ARTEFATOS DE CONCRETO	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 19/05/2025		

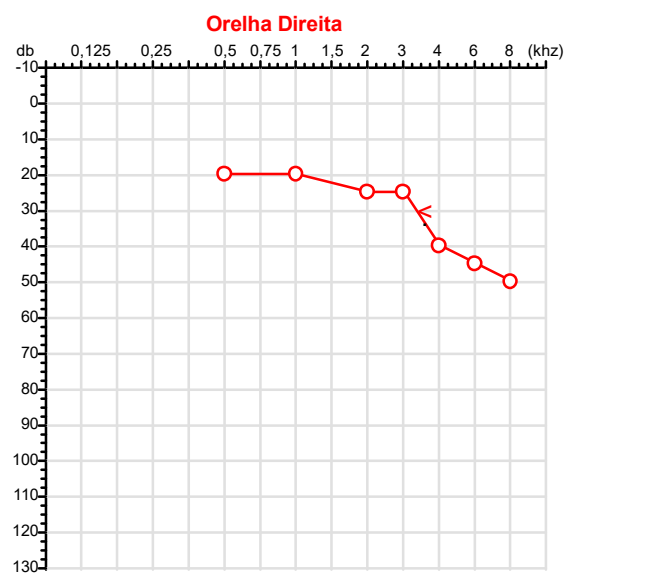

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	40	45	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	40	50

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	40	45	37

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :B1EC8F1845EA044740ECCF8BC80E0268
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Roberto Akerley
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024