



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45907897000170 Fantasia : NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Razão Social : MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NORTAO LTDA
Endereço : R SIDONIO RONDON DE MORAIS N.º 5 Complemento : QUADRA110 LOTE 05
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78135154

Funcionário

Nome : Fabio Luan Carvalho Duarte Setor: ENTREGA
CPF : 10615528104 Cargo: AJUDANTE GERAL NIVEL II
RG : / Nascimento: 30/11/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 20 de maio de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :2B75A1CB8210590B604C5BFD1D8F6AAF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :740602


CPF :106.155.281-04
CNPJ :45.907.897/0001-70
Nascimento :30/11/2005
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/05/2025

Paciente :Fabio Luan Carvalho Duarte
Razão :MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NORTAO LTDA
Idade : 19 anos
Setor :ENTREGA
Função :AJUDANTE GERAL NIVEL II

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

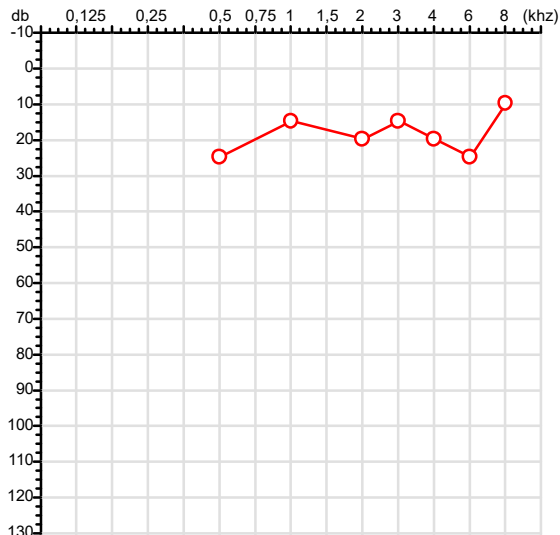

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	15	20	25	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :DD52D8638FB8EA44A8BC296A7BE610EB


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Fabio Luan Carvalho Duarte

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

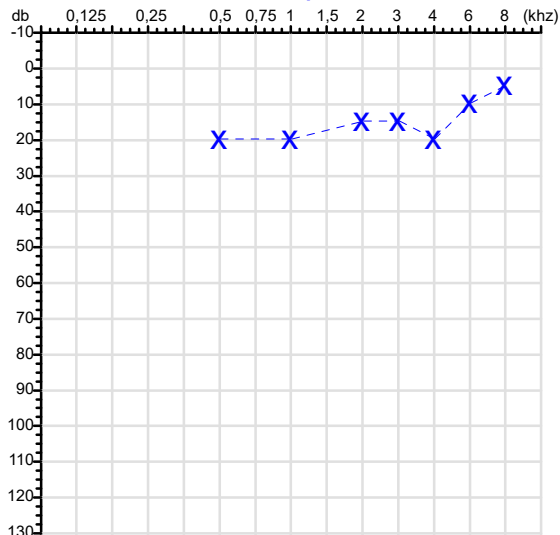

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	15	15	20	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	15	18	15	20	10	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 27/05/2025
Primeiro Nome: FABIO LUAN CARVALHO
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 79.0

Data de nascimento: 30/11/2005
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 27/05/2025 08:55

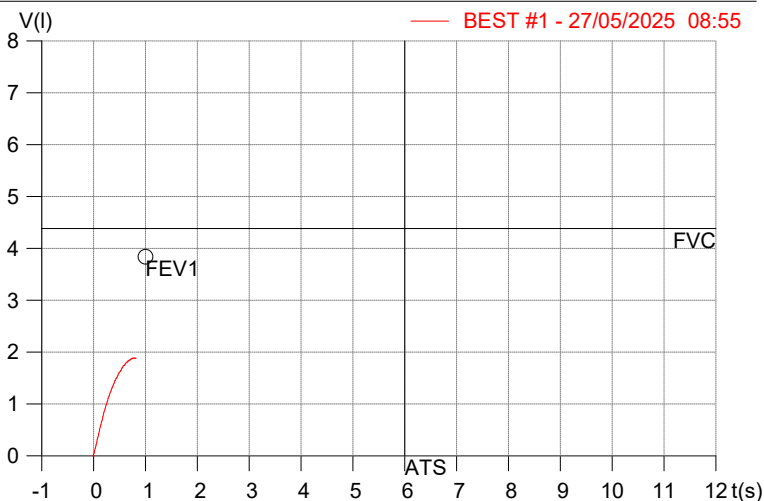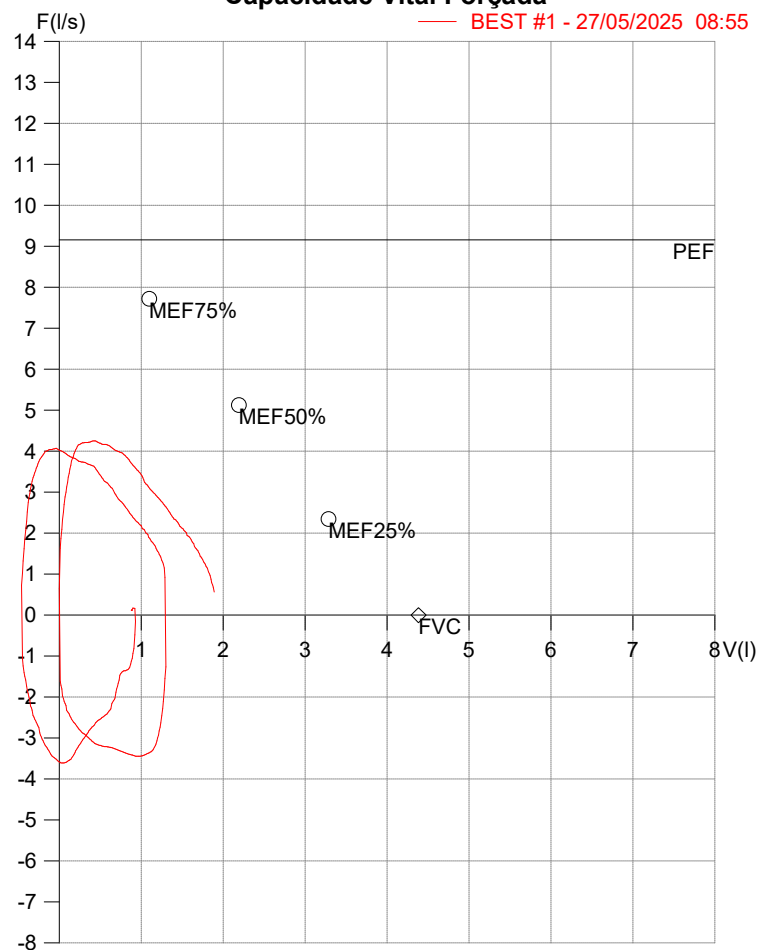

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.38	1.91	43.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.38	1.91	43.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.16	4.25	46.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.99	3.31	66.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.72	4.20	54.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.13	3.54	69.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.34	2.32	99.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	549.4	254.9	46.4

Diagnóstico:
Espirometria normal