



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 742606

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Antonio Pereira Feitosa

Setor: TERRAPLANAGEM

CPF : 056.243.883-14

Cargo: APONTADOR DE MAO-DE-OBRA

RG : /

Nascimento: 17/10/1994

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	POEIRA		ERGONÔMICO	POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	29/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	29/05/2025	EXAME CLINICO
281	29/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	29/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	29/05/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 29 de maio de 2025

Antonio Pereira Feitosa

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=742606>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Antonio Pereira Feitosa Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 05624388314 Cargo: APONTADOR DE MAO-DE-OBRA
RG : / Nascimento: 17/10/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :A0CF7A22ACA6E5E082CCDF6D416BFC51
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :742606


CPF :056.243.883-14
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :17/10/1994
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/05/2025

Paciente :Antonio Pereira Feitosa
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 30 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :APONTADOR DE MAO-DE-OBRA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

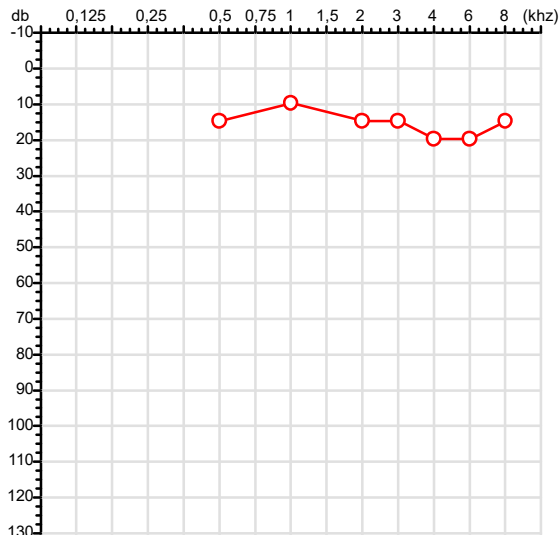

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2CAD53B6FBBA3351E1F61DE2D230CDFB


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Antonio Pereira Feitosa*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

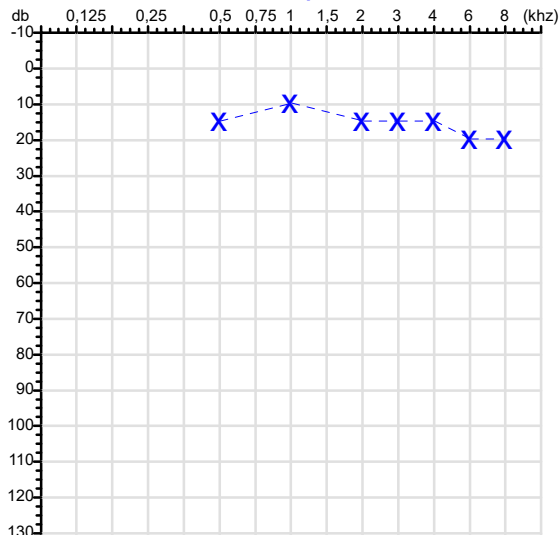

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 742606
Primeiro Nome: Antonio Pereira Feit
Sobrenome:
Data: 29/05/2025

Data de nascimento: 17/10/1994
Sexo : Macho
Peso (kg): 71.0
Altura (cm): 175.0

Capacidade Vital Forçada

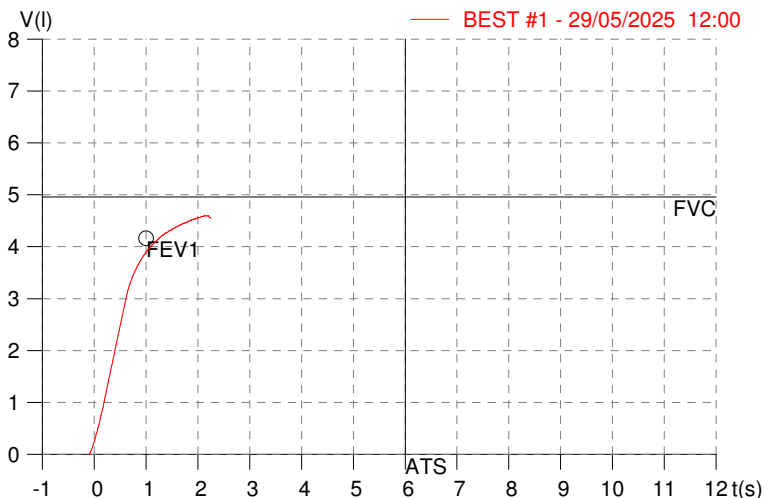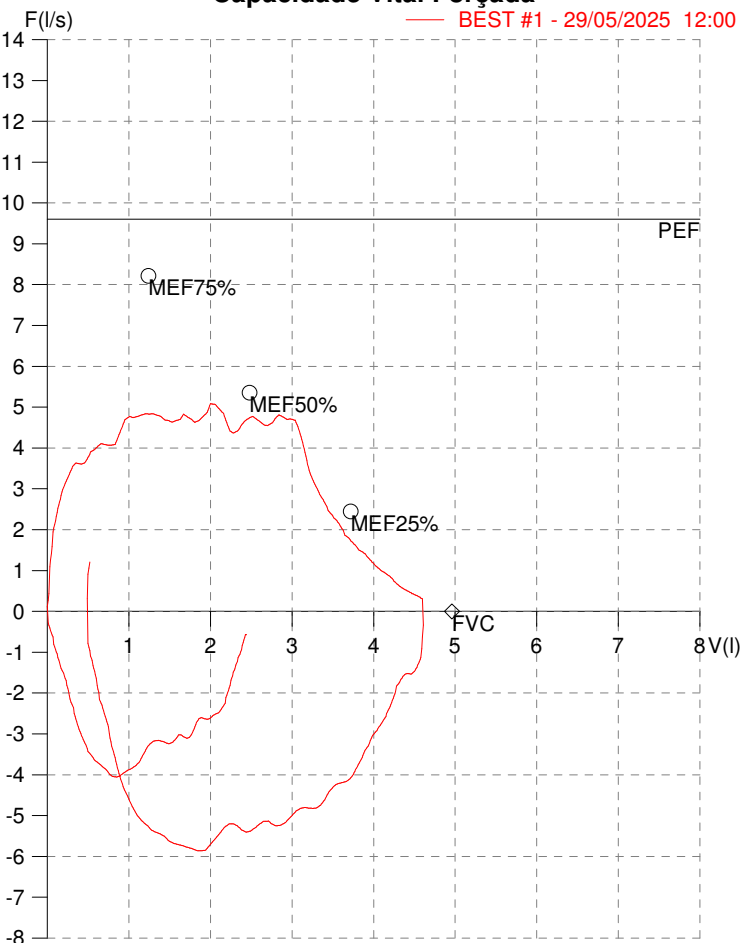

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.96	4.62	93.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.96	4.62	93.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.16	3.89	93.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.61	5.09	52.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.86	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.8	84.2	102.9
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.81	4.33	90.1
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.22	4.81	58.5
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.35	4.42	82.6
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.45	2.48	101.3
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	576.3	305.1	52.9

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 29/05/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 742606

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Antonio Pereira Feitosa

Setor: TERRAPLANAGEM

CPF : 056.243.883-14

Cargo: APONTADOR DE MAO-DE-OBRA

RG : /

Nascimento: 17/10/1994

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	POEIRA		ERGONÔMICO	POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	29/05/2025	ACUIDADE VISUAL	295	29/05/2025	EXAME CLINICO
281	29/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	29/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	29/05/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 29 de maio de 2025

Antonio Pereira Feitosa

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=742606>



Cod.: 530962	Paciente: Antonio Pereira Feitosa	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 29/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05624388314	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/05/2025 Liberado em: 30/05/2025 15:29

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,23	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	51,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	97,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	8.860/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,9%	6.193/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	69,9%	6.193/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,8%	71/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	18/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,5%	2.171/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	4,6%	408/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	201.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.512