

Exame n.º :743035


CPF :030.364.111-86
CNPJ :36.350.293/0001-84
Nascimento :30/08/1990
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/06/2025

Paciente :Silvano Brito Silva
Razão :SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
Idade : 34 anos
Setor :GERAL
Função :MESTRE DE OBRA PLENO


RG :20164726/ssp mt

Audiometria

Orelha Direita

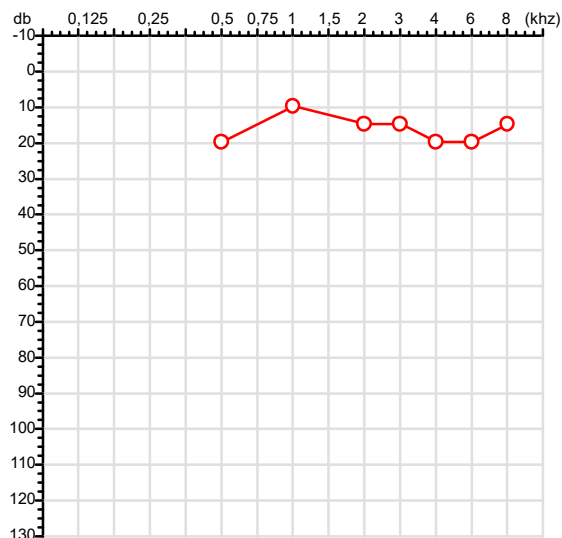

Orelha Esquerda

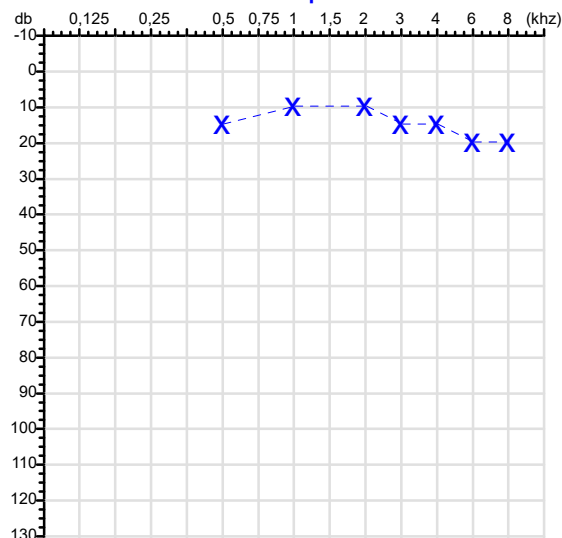

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C3A663D765F544AB41F65C3DF543CA59

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Silvano Brito Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 743035
Primeiro Nome: SILVANO BRITO SILVA
Sobrenome:
Data: 02/06/2025

Data de nascimento: 30/08/1990
Sexo : Macho
Peso (kg): 92.0
Altura (cm): 178.0

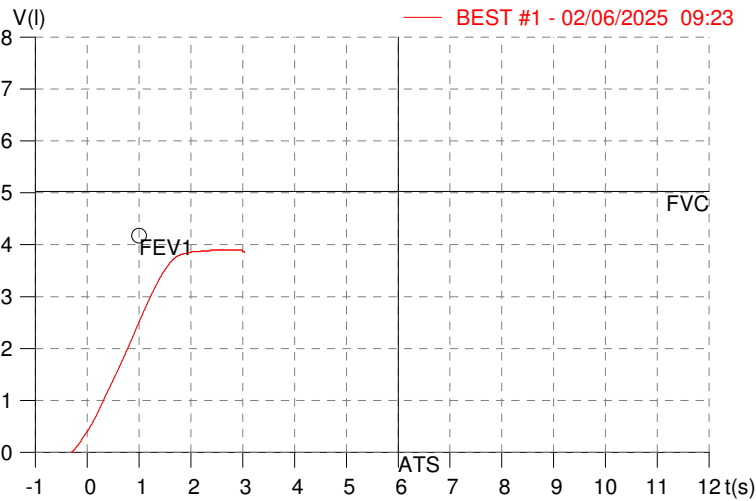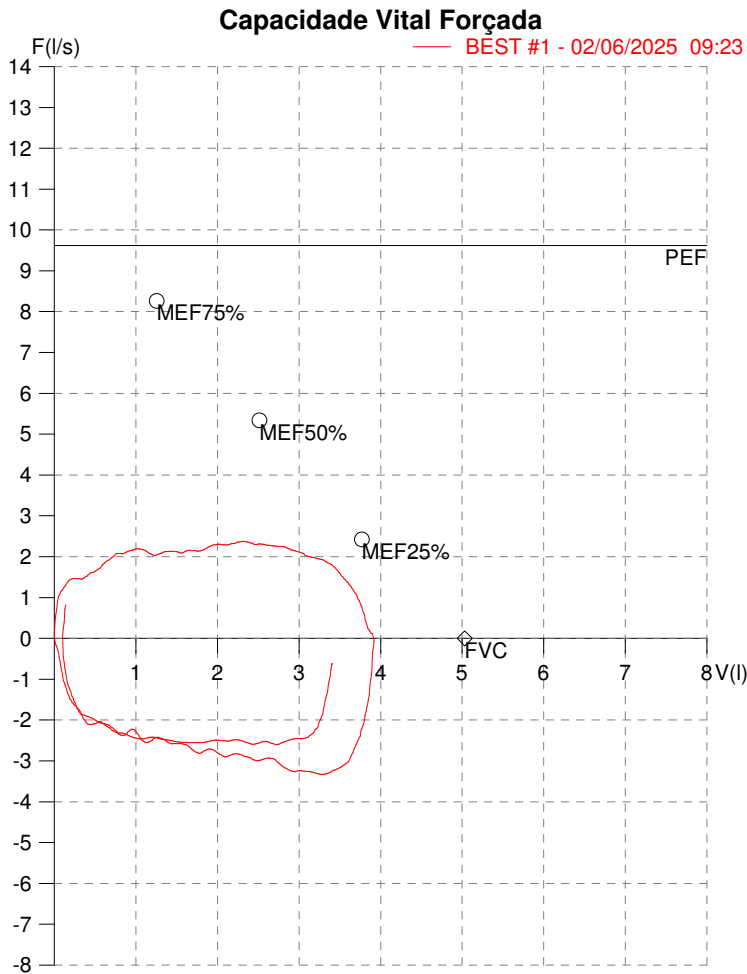

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.03	3.92	77.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.03	3.92	77.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.18	2.48	59.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.62	2.38	24.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.33	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.1	63.2	77.9
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.69	2.21	47.0
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.26	2.16	26.2
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.34	2.29	42.8
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.42	2.16	89.1
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	577.0	142.7	24.7

Diagnóstico:
Anormalidade Moderadamente

Impresso 02/06/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36350293000184 Fantasia : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS
Razão Social : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
Endereço : AVENIDA LISBOA (LOT 1000) - BOA VISTA - CUIABÁ - MT
N.º 474 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048074

Funcionário

Nome : Silvano Brito Silva Setor: GERAL
CPF : 03036411186 Cargo: MESTRE DE OBRA PLENO
RG : 20164726 / ssp mt Nascimento: 30/08/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :A76464DABE09622F4FC79D7EE5AD8EBE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>