

Exame n.º :743049


CPF :991.651.124-15
CNPJ :36.350.293/0001-84
Nascimento :04/10/1974
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/06/2025

Paciente :Francisco de Assis da Silva
Razão :SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
Idade : 50 anos
Setor :GERAL
Função :PEDREIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

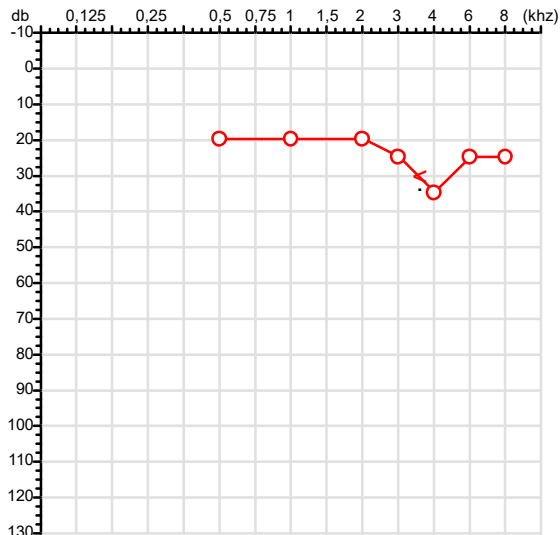

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	25	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	25	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

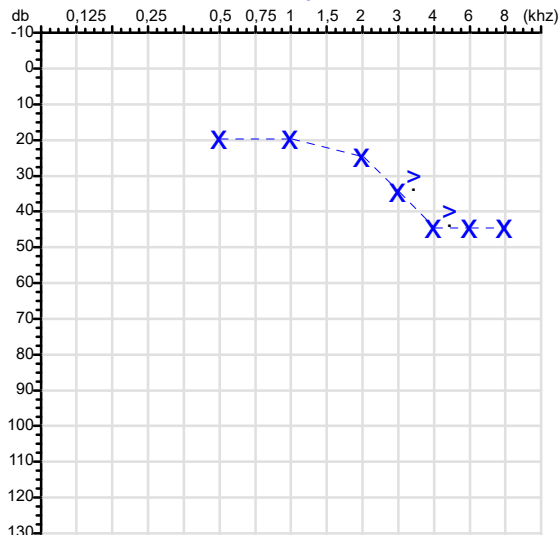

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	45	45	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	45	45	42

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :799C0833BDD72CE365F41AC2FCFAF4A5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Francisco de Assis da Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 743049
Primeiro Nome: FRANCISCO DE ASSIS
Sobrenome:
Data: 02/06/2025

Data de nascimento: 04/10/1974
Sexo : Macho
Peso (kg): 62.0
Altura (cm): 172.0

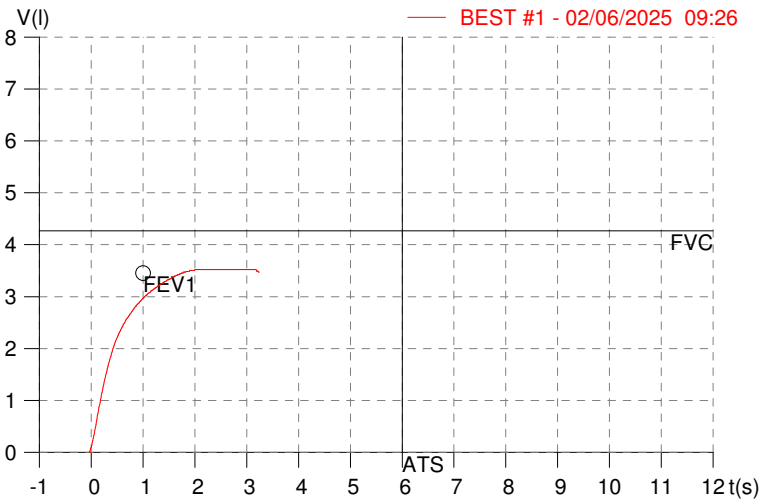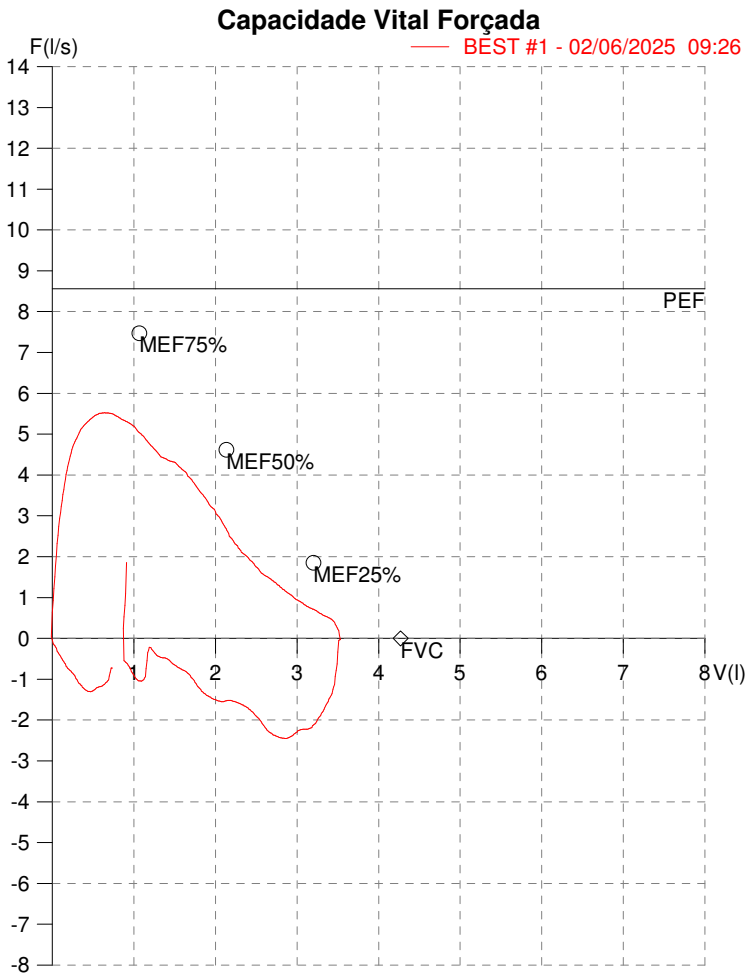

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.27	3.55	83.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.27	3.55	83.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.46	2.98	86.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.56	5.53	64.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.45	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.2	83.9	107.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.89	3.06	78.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.47	5.36	71.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.62	3.76	81.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.85	1.52	82.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	513.6	331.5	64.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 02/06/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36350293000184 Fantasia : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS
Razão Social : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
Endereço : AVENIDA LISBOA (LOT 1000) - BOA VISTA - CUIABÁ - MT
N.º 474 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048074

Funcionário

Nome : Francisco de Assis da Silva Setor: GERAL
CPF : 99165112415 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 04/10/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :5D03EFFBC991DD3B4AA34E2493B79CD5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>