



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 31102241000175 Fantasia : F P HIDROGEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS
Razão Social : F P HIDROGEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
Endereço : AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO N.º 525 Complemento : PAVMTO14 SALA 1302
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048848

Funcionário

Nome : Michele da Silva Alves	Setor: GEOLOGIA
CPF : 30351445838	Cargo: ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL
RG : /	Nascimento: 07/03/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :1512AA2DA802E81D4161660250314BE1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :743422


CPF :303.514.458-38
CNPJ :31.102.241/0001-75
Nascimento :07/03/1982
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/06/2025

Paciente :MICHELE DA SILVA ALVES
Razão :F P HIDROGEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
Idade : 43 anos
Setor :GEOLOGIA
Função :ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

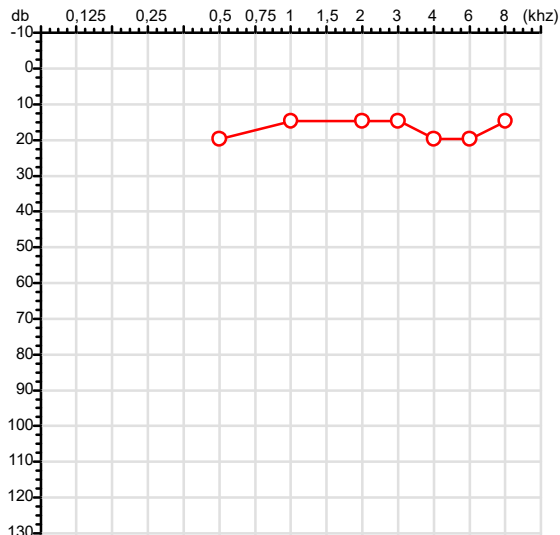

Orelha Esquerda

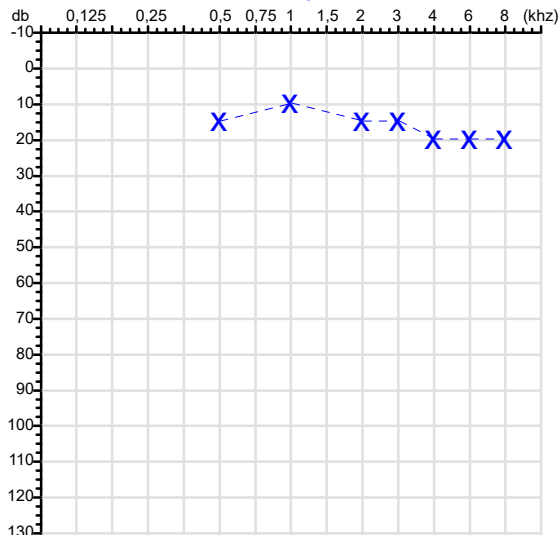

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3D33F930A448F84691AC5B8B8BA5CF3F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Michele da Silva Alves*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 743422
Primeiro Nome: MICHELE DA SILVA
Sobrenome:
Data: 03/06/2025

Data de nascimento: 07/03/1982
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 63.0
Altura (cm): 163.0

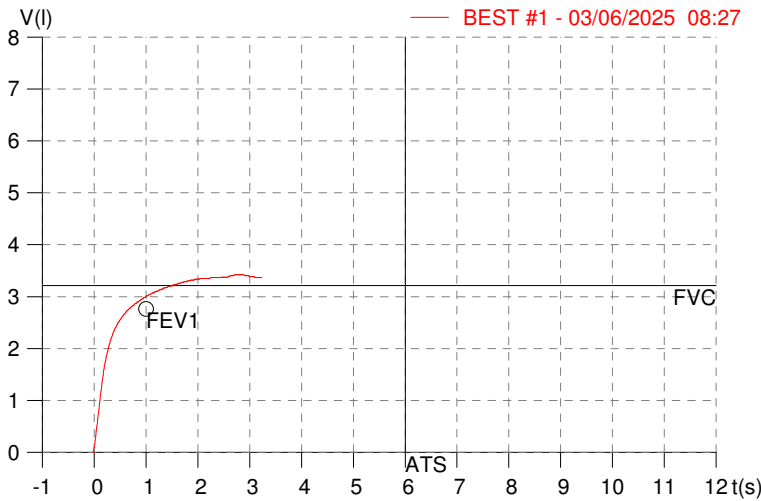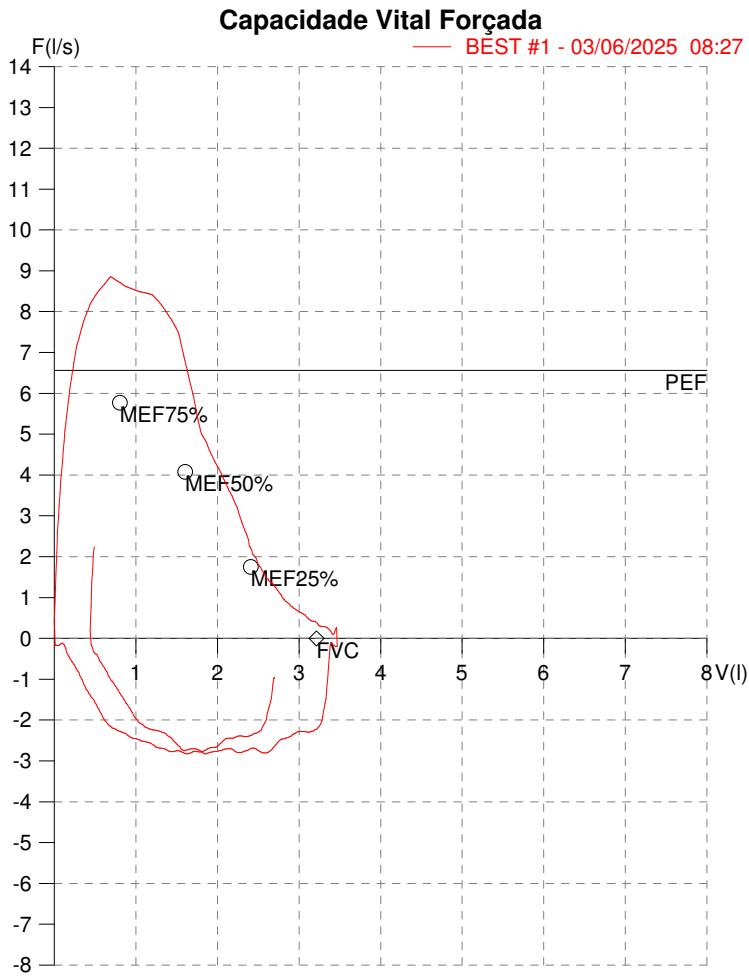

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.21	3.48	108.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.21	3.48	108.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.76	3.04	110.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.57	8.86	134.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.83	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.9	87.4	107.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.50	4.23	121.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.77	8.62	149.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.08	5.36	131.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.75	1.52	87.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	393.9	531.5	134.9

Diagnóstico:
Espirometria normal

Impresso 03/06/2025