

Exame n.º :744766


CPF :000.731.991-68
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :12/06/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/06/2025

Paciente :Carlos Henrique de Campos
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 33 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

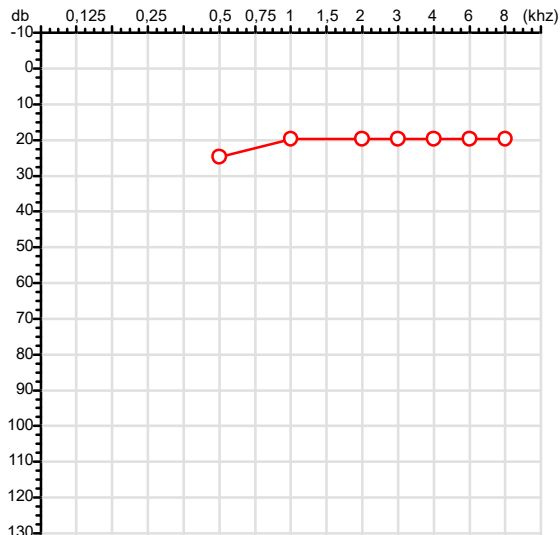

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

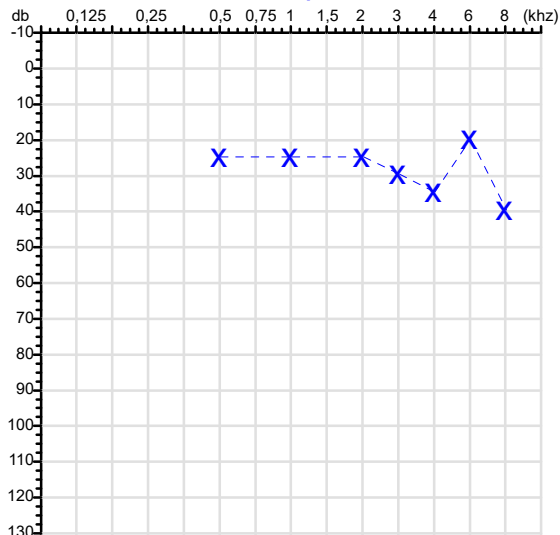

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	30	35	20	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	30	35	20	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :BC9E24E8DB2C4421CD80A2D7E66DA9AD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Henrique de Campos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2024

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 09/06/2025
Primeiro Nome: CARLOS HENRIQUE
Sobrenome: 12/06/1991
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento:12/06/1991
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Sim(2/9)

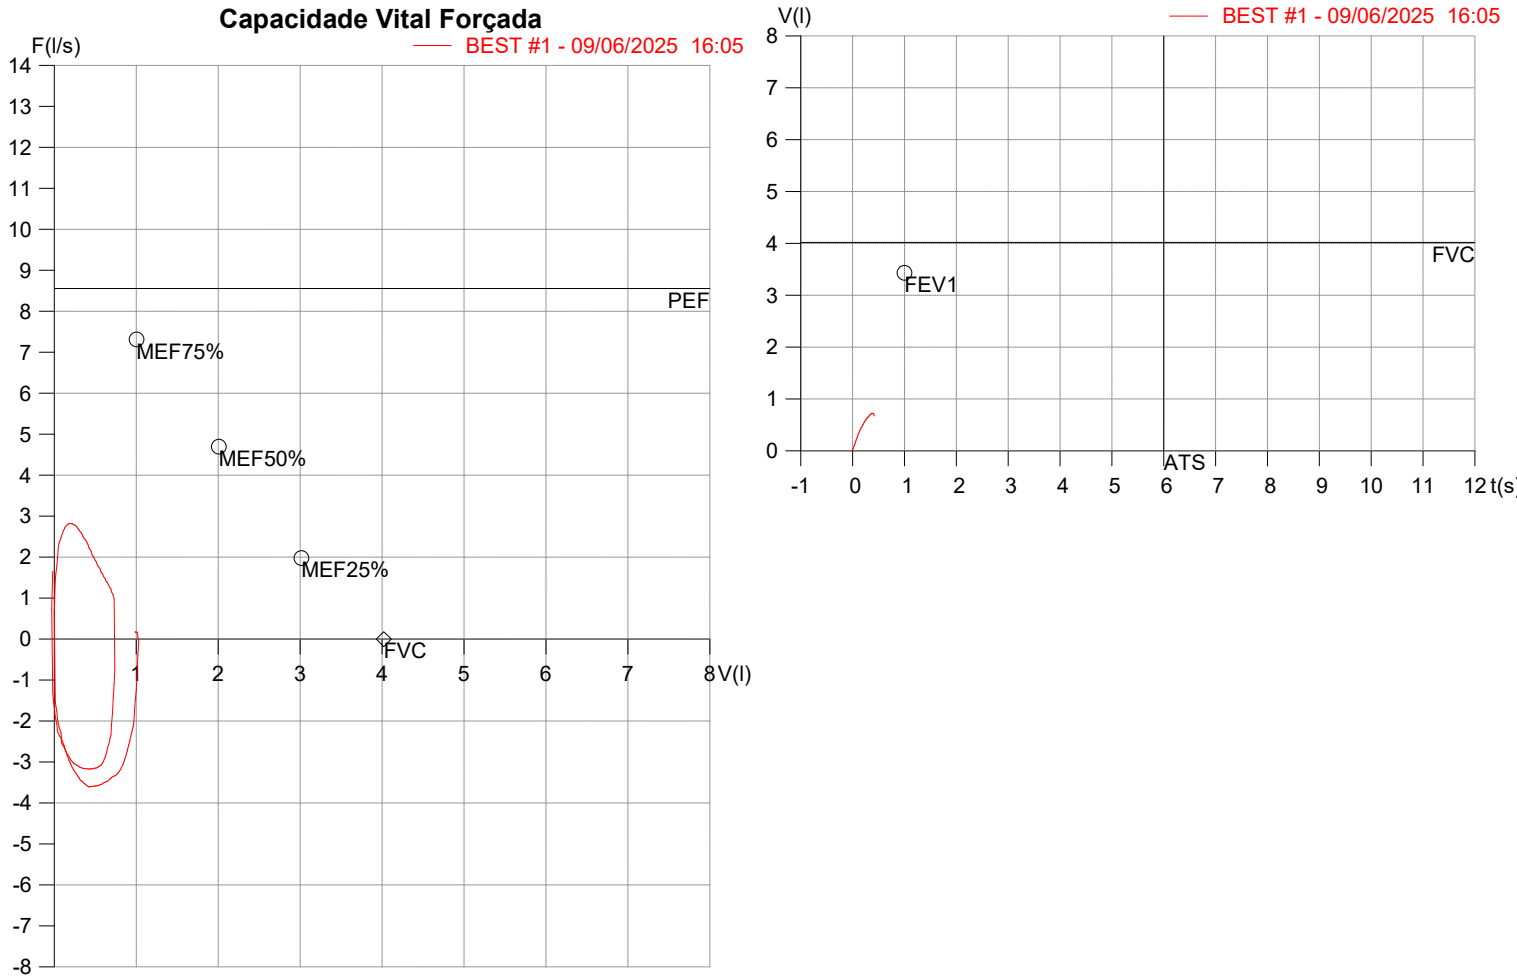

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.02	0.75	18.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.02	0.75	18.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.56	2.82	33.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.17	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.39	2.31	52.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.31	2.82	38.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.69	2.42	51.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	1.71	86.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.4	
LungAge	years	Idade Pulmonar		141	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	513.3	169.2	33.0

Diagnóstico:
Espirometria normal