

## Exame n.º :745389


CPF :887.270.093-00  
CNPJ :18.252.862/0006-81  
Nascimento :13/02/1980  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 11/06/2025

Paciente :CLEITON BARROS FERREIRA  
Razão :CET BRAZIL EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA E TECNOLOGIA LTDA  
Idade : 45 anos  
Setor :GERAL  
Função :ELETRICISTA FORCA CONTROLE


RG :28316363/SESP

## Audiometria

## Orelha Direita

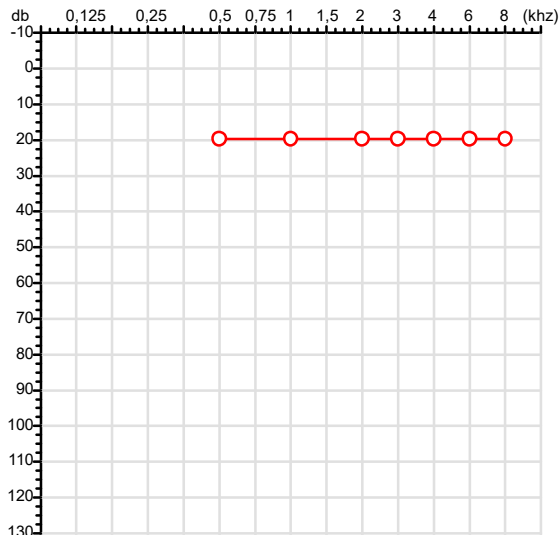

## Orelha Esquerda

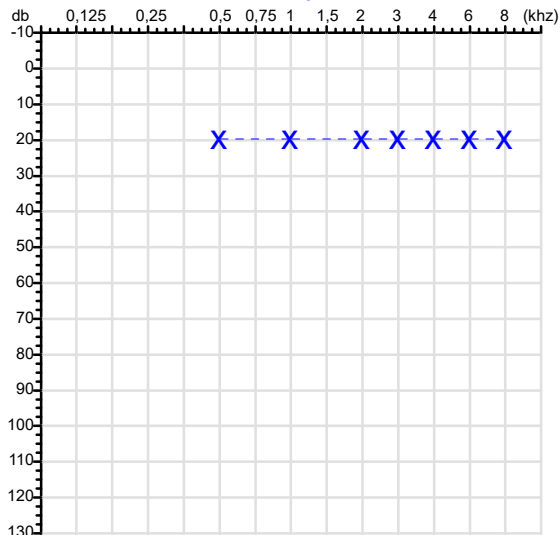

## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas  
Médico  
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas  
CRM-MT 14169  
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :779E7C045862F27A0CA67FB0F8ED61D0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton Barros Ferreira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024



**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 11/06/2025  
**Primeiro Nome:** CLEITON BARROS  
**Sobrenome:** FERREIRA  
**Altura (cm):** 165.0  
**Peso (kg):** 80.0

**Data de nascimento:** 13/02/1980  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:**  
**Fuma:** Não

**Capacidade Vital Forçada**

— BEST #1 - 11/06/2025 08:06

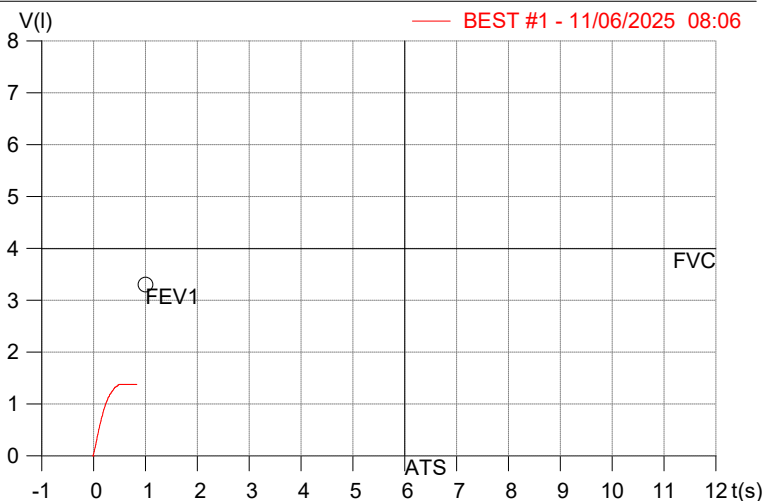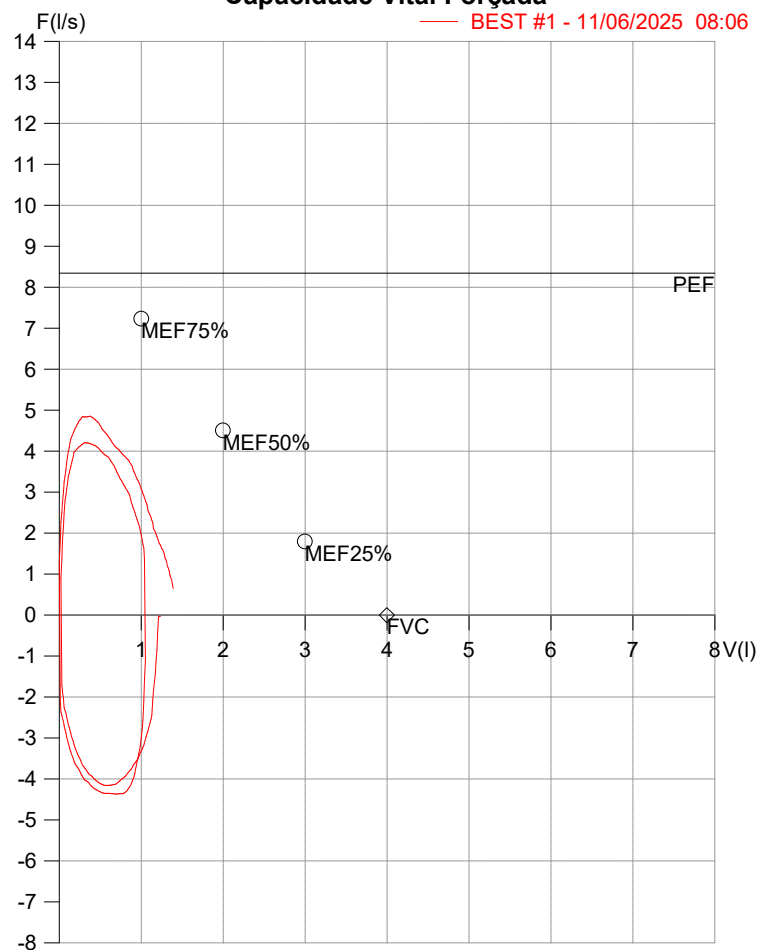

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.99  | 1.42   | 35.5    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.99  | 1.42   | 35.5    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.35  | 4.85   | 58.1    |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 3.97  | 3.95   | 99.6    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.23  | 4.85   | 67.1    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.51  | 4.09   | 90.7    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.80  | 2.86   | 158.9   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 0.5    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 500.8 | 291.1  | 58.1    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal