



Cod.: 533004	Paciente: Ary Pedro Soares	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 11/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 56915071172	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**73 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/06/2025 Liberado em: 11/06/2025 17:46

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

Exame n.º :745502


CPF :569.150.711-72
CNPJ :20.457.742/0001-58
Nascimento :07/03/1977
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/06/2025

Paciente :Ary Pedro Soares
Razão :FOX TRANSPORTES LTDA
Idade : 48 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA

RG :888566/SSP

Audiometria

Orelha Direita

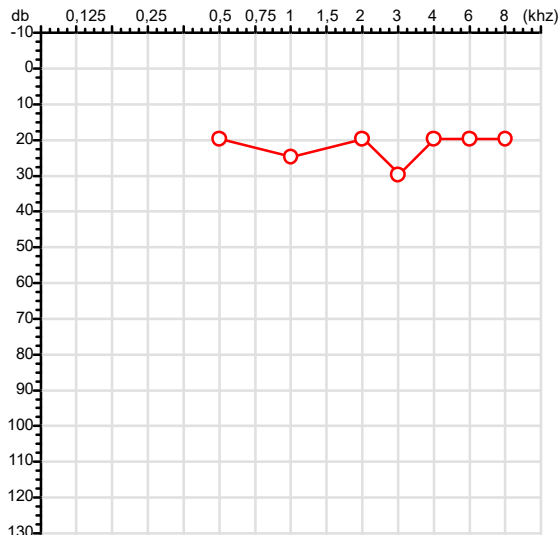

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	30	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	30	20	20	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

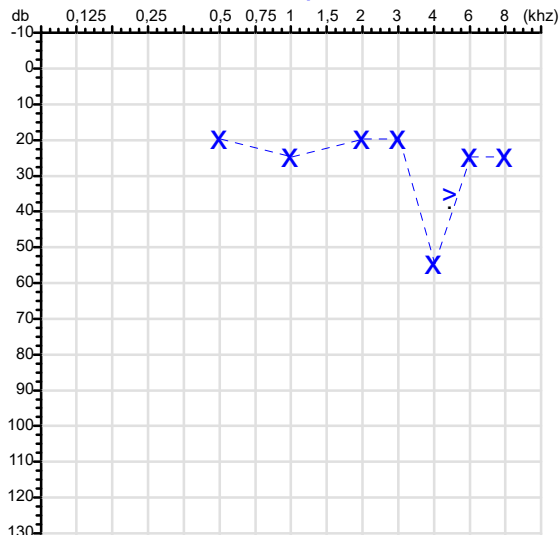

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	20	55	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	20	55	25	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :BA4B13DAB7002DB04A39C03248ECF9F7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ary Pedro Soares

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024