

Exame n.º :754006


CPF :042.175.731-03
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :13/11/1989
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2025

Paciente :Julio Cezar Souza Silva
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 35 anos
Setor :METALURGICA
Função :ARMADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

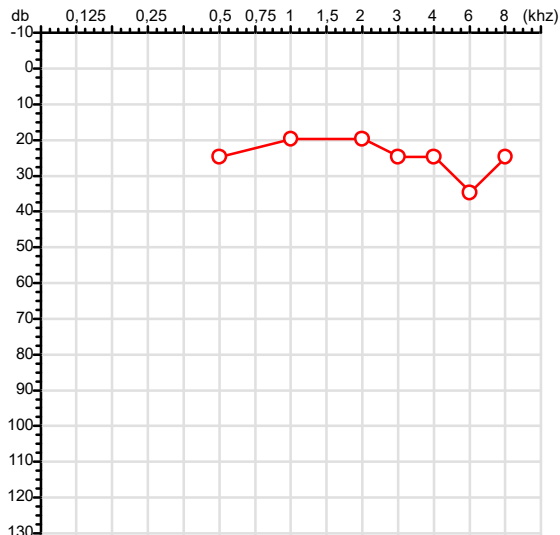

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

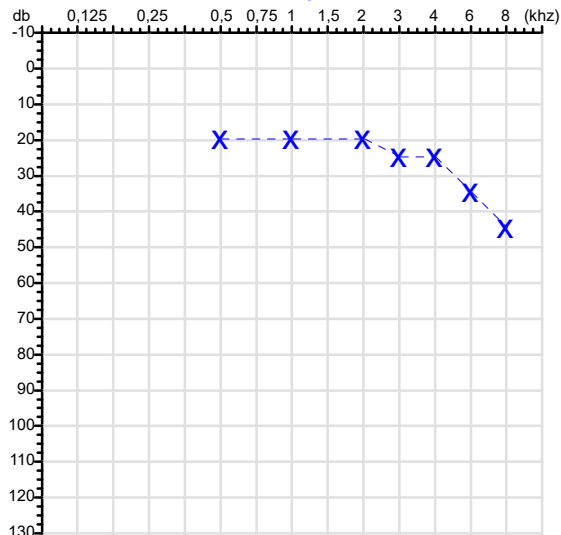

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :35B562C7F22F22AAC71AAAF7774E6E14

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Julio Cezar Souza Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	JULIO CEZAR SOUZA SILVA		ID1	754006	Sexo	Masculino	Idade	35,6	Peso (kg)	130,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/11/1989	--	BMI (kg/m2)	47,8	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	15	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		09:55	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,87	4,10	70		
FEV1	L	2,29	3,43	67		
FEV1/FVC%	%	79,9	83,5	96		
FEV1/Vcmax%	%	79,9	83,5	96		

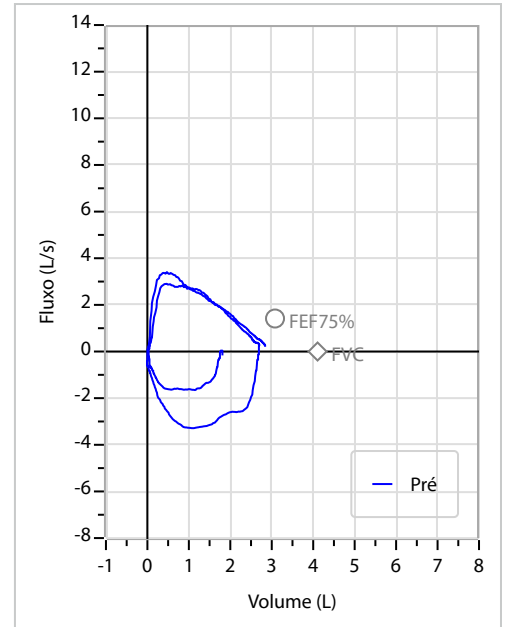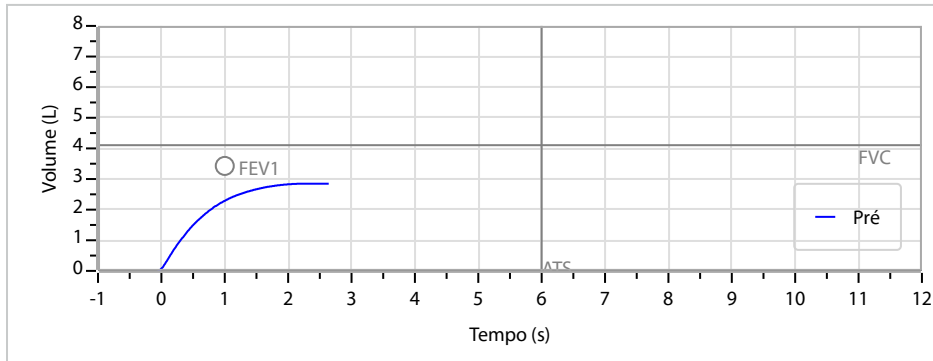

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 79,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,87 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____