

Exame n.º :754384


CPF :270.264.341-87
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :03/10/1964
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/07/2025

Paciente :Alinor Alves da Guia
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 60 anos
Setor :ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

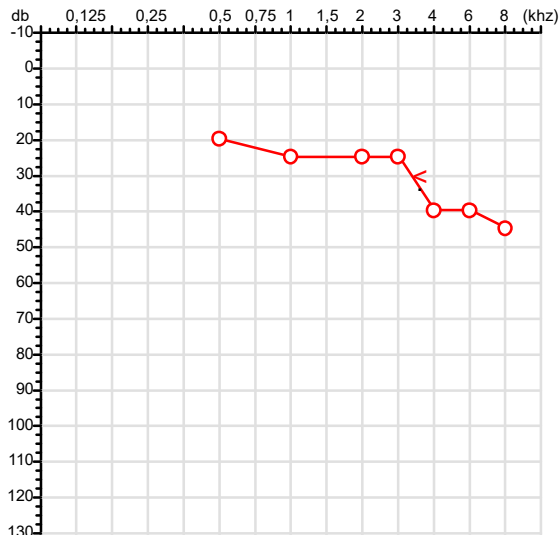

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	25	40	40	45

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	25	40	40	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

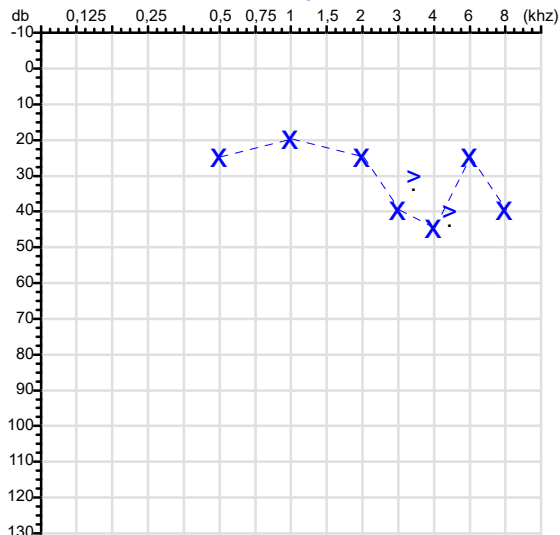

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	40	45	25	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	40	45	25	37

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D9C54A5E03BE8C155BF5D63B2F7153FA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Alinor Alves da Guia*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	ALINOR ALVES DA GUIA		ID1	754384	Sexo	Masculino	Idade	60,8	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	03/10/1964	--	BMI (kg/m2)	19,6	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	40	Cig/Dia	4
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:17	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,94	4,09	96		
FEV1	L	3,92	3,20	123		
FEV1/FVC%	%	99,6	78,4	127		
FEV1/Vcmax%	%	99,6	78,4	127		

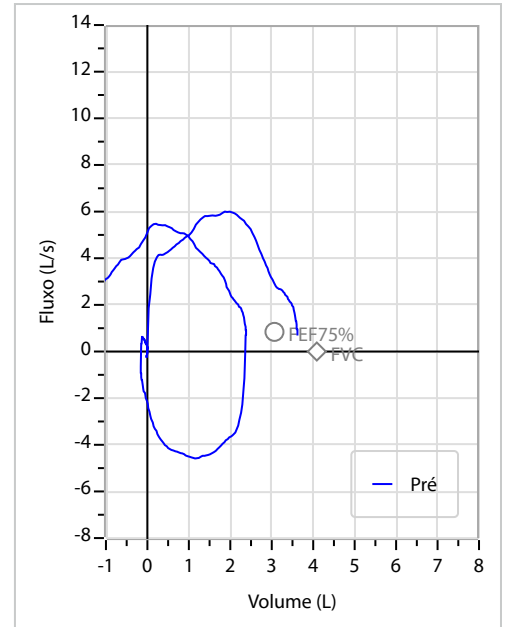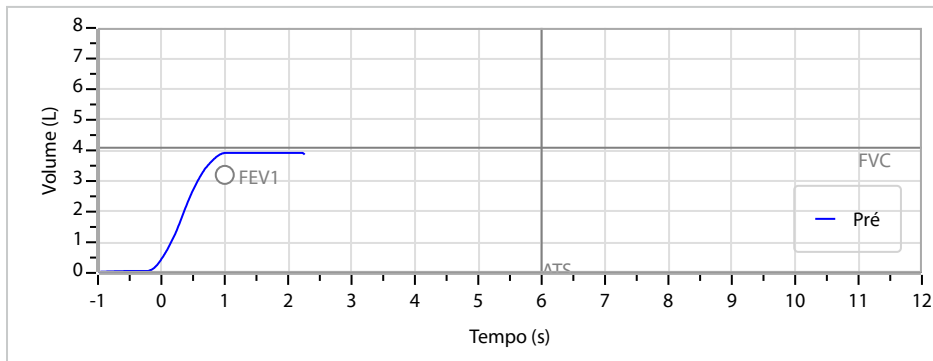

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,6% e um valor FVC de 3,94 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____