


Exame n.º :762685

CPF :061.834.261-30
CNPJ :36.915.163/0001-41
Nascimento :17/05/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/08/2025

Paciente :Luan Cleverson Deolindo Siqueira
Razão :APOLUS ENGENHARIA EIRELI
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

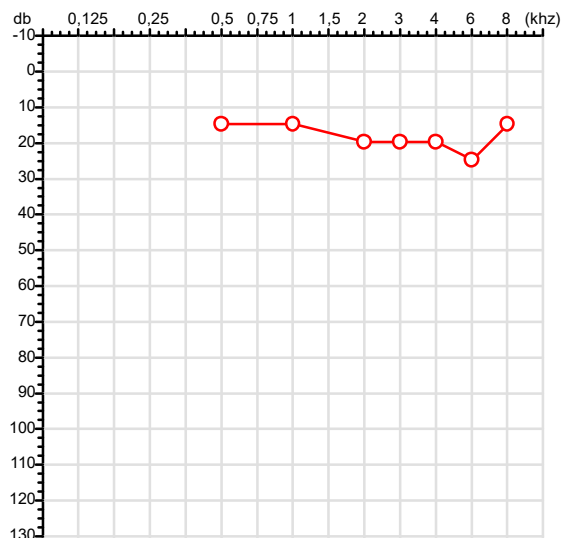

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

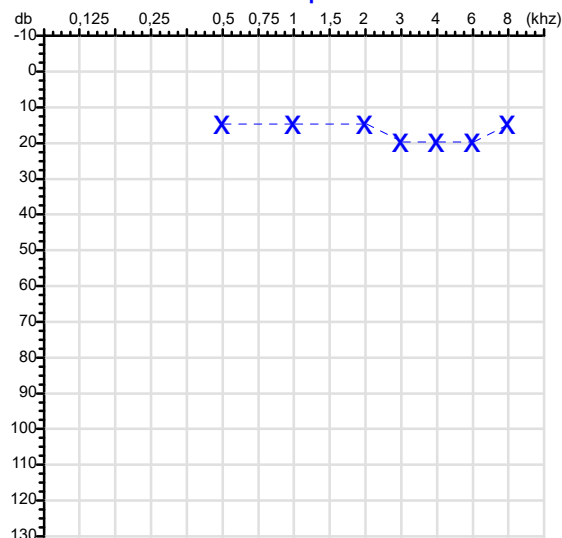

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8B800DE3815A6A175100FBED802AE0F6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luan Cleverson Deolindo Siqueira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 762685
Primeiro Nome: Luan Cleverson Deoli
Sobrenome:
Data: 27/08/2025

Data de nascimento: 17/05/1998
Sexo : Macho
Peso (kg): 105.0
Altura (cm): 182.0

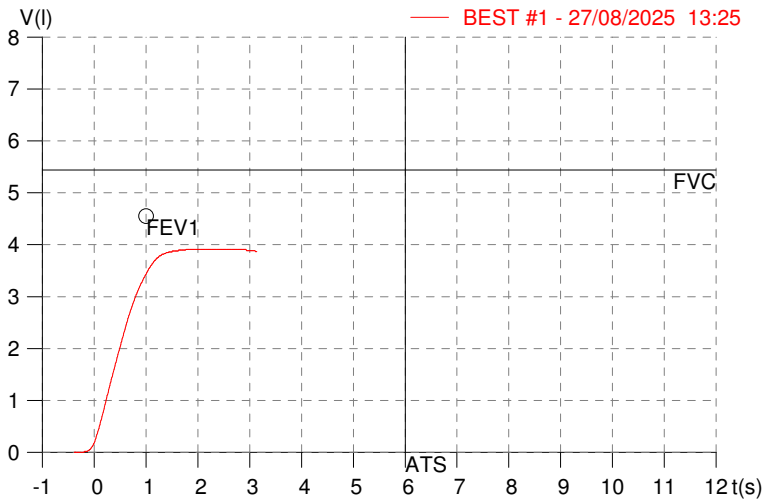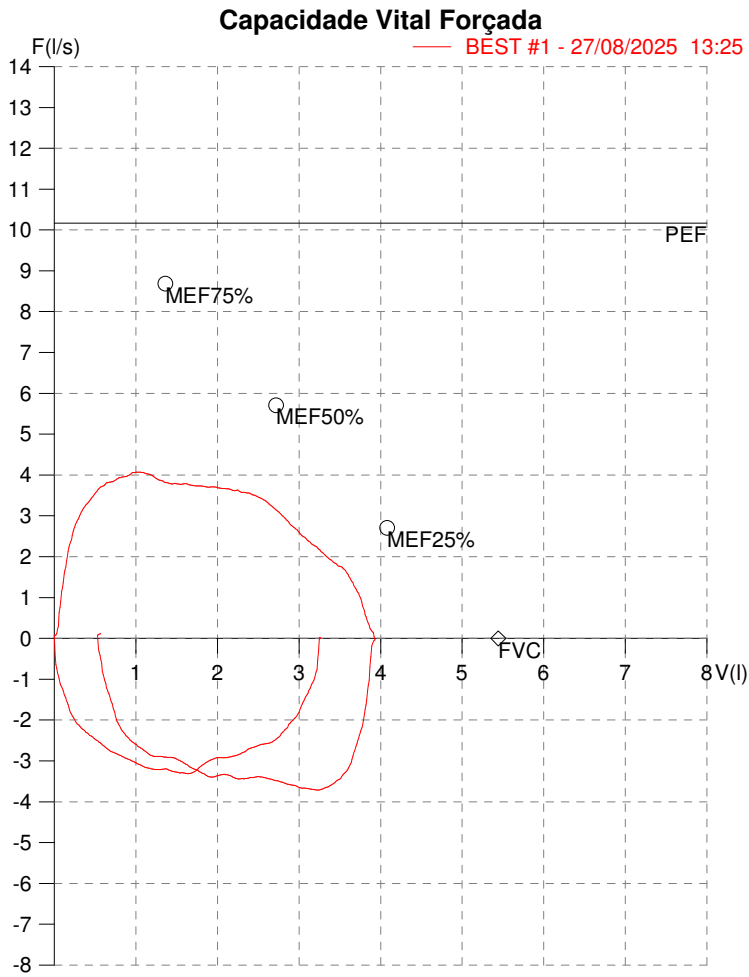

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.44	3.93	72.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.44	3.93	72.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.55	3.42	75.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.16	4.07	40.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.71	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.3	87.1	105.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.07	3.56	70.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.68	4.06	46.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.71	3.71	65.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.71	2.70	99.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	609.8	244.1	40.0

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 27/08/2025