



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36915163000141 Fantasia : APOLUS
Razão Social : APOLUS ENGENHARIA EIRELI
Endereço : AV FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 4149 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080000

Funcionário

Nome : Marcos Vinicius de Campos Verissimo Setor: GERAL
CPF : 06223606125 Cargo: SERVENTE DE OBRA
RG : / Nascimento: 19/08/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 27 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :657A0563A35F1AB55FEE91C67999E372
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :762694

CPF :062.236.061-25
CNPJ :36.915.163/0001-41
Nascimento :19/08/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/08/2025

Paciente :MARCOS VINICIUS DE CAMPOS VERISSIMO
Razão :APOLUS ENGENHARIA EIRELI
Idade : 21 anos
Setor :GERAL
Função :SERVENTE DE OBRA

RG :/

Orelha Direita

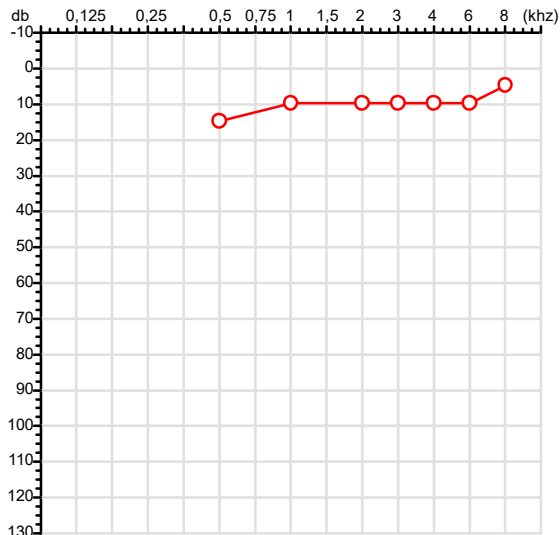

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :E22EFCF0E5640F94A69CC56ABE86E5D9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Vinicius de Campos Verissimo


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

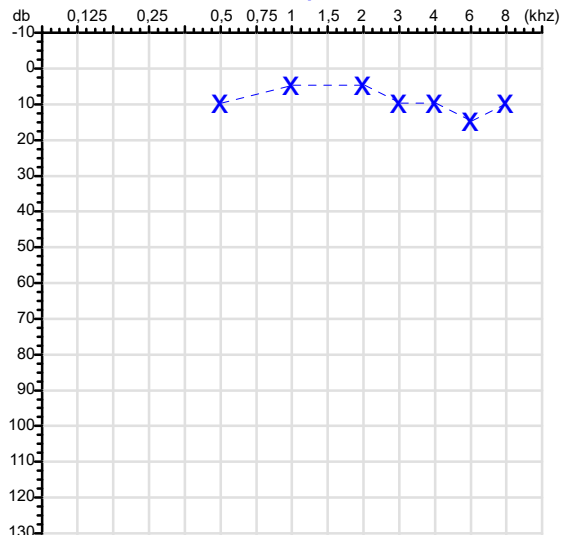

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	15	12

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 762694
Primeiro Nome: Marcos Vinicius de C
Sobrenome:
Data: 27/08/2025

Data de nascimento: 19/08/2004
Sexo : Macho
Peso (kg): 118.0
Altura (cm): 180.0

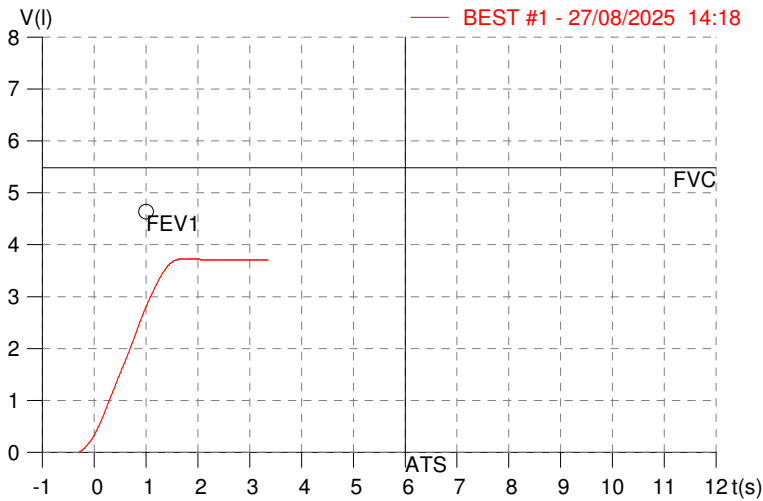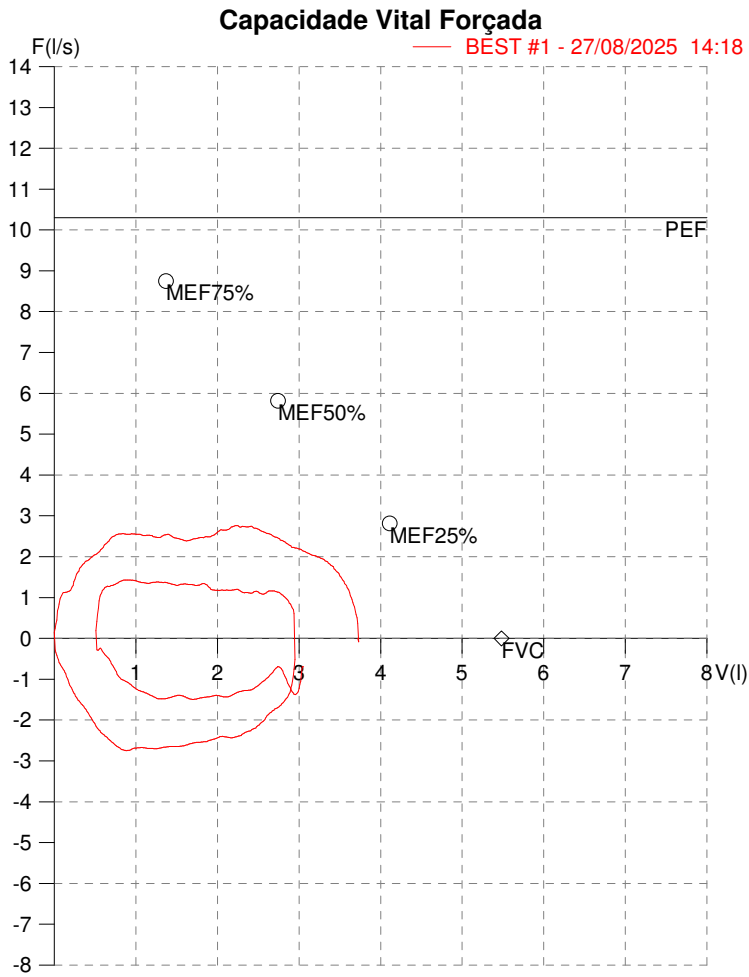

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.48	3.74	68.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.48	3.74	68.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.64	2.78	59.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.30	2.76	26.8
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	83.4	74.2	89.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.29	2.54	48.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.75	2.55	29.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.82	2.49	42.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.81	2.39	85.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	617.9	165.5	26.8

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 27/08/2025