

Exame n.º :763055

CPF :743.158.461-04
CNPJ :03.150.745/0001-25
Nascimento :22/03/1978
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/08/2025

Paciente :Osama Fahmy Mohamed Aly
Razão :HOTEIS GLOBAL S/A
Idade : 47 anos
Setor :ADMINISTRATIVO
Função :COORDENADOR DE IMPLATAÇÃO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

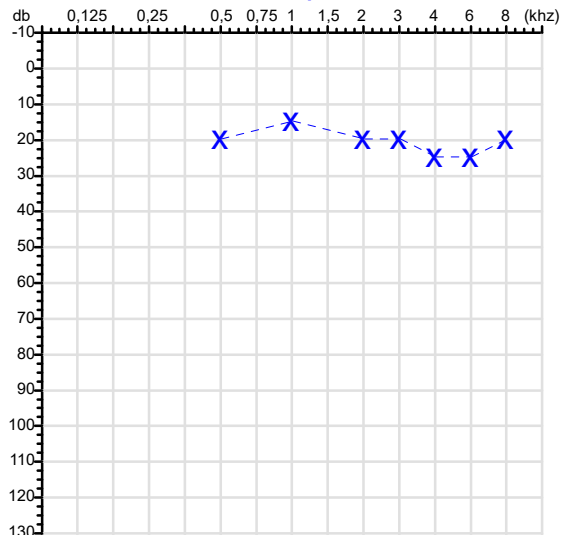

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0BADD527C29D4EBF71CC5BD502A0B422

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Osama Fahmy Mohamed Aly

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 763055
Primeiro Nome OSAMA FAHMY
Sobrenome: MOHAMED
Data: 29/08/2025

Data de nascimento 22/03/1978
Sexo : Macho
Peso (kg): 94.0
Altura (cm): 175.0

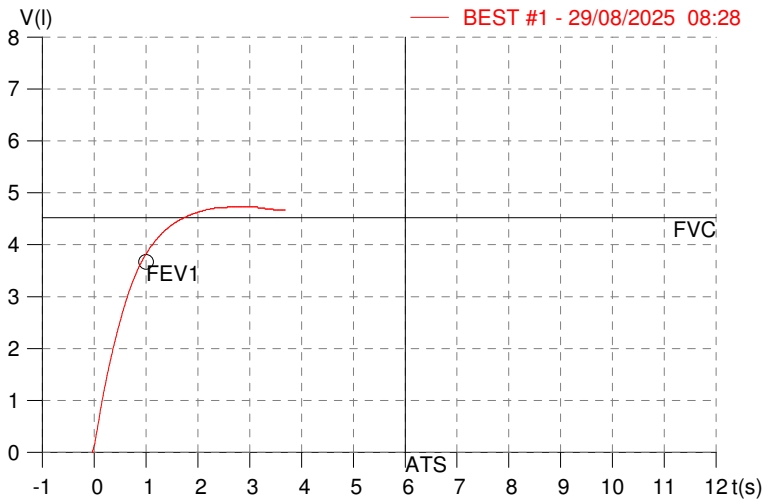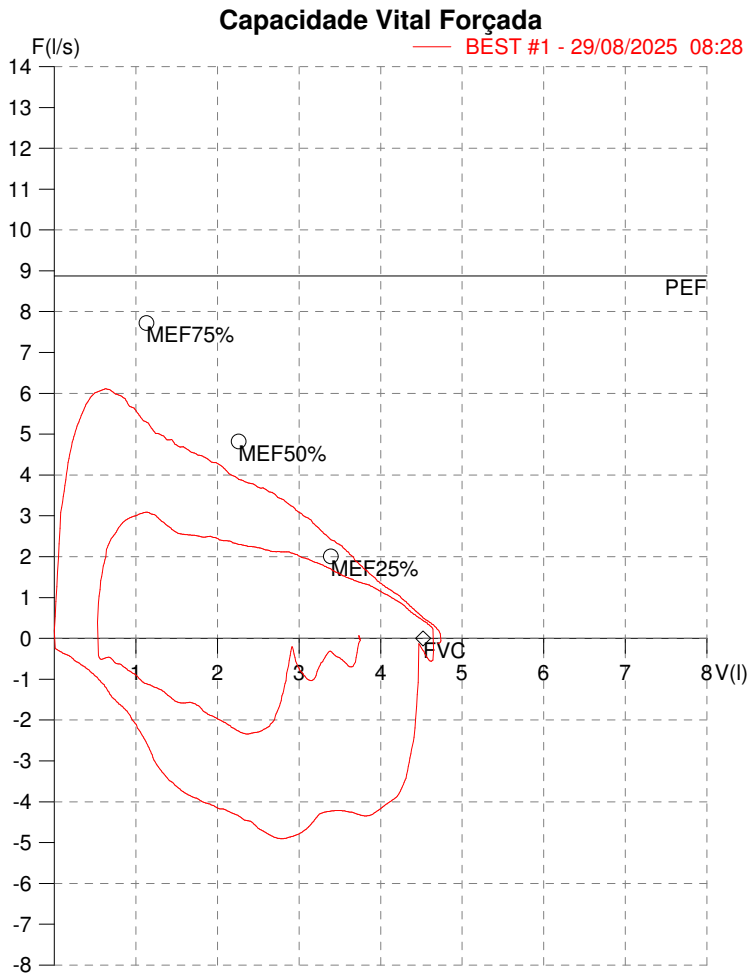

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.52	4.75	105.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.52	4.75	105.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.67	3.81	103.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.87	6.11	68.9
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.8	80.3	101.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.07	3.57	87.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.72	5.16	66.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.83	3.80	78.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.01	2.17	108.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	532.4	366.6	68.9

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 29/08/2025