


Exame n.º :764086

CPF :041.478.911-36
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :21/04/1991
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/09/2025

Paciente :Gessika Souza Franco
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 34 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :19968949/SSP-MT

Orelha Direita

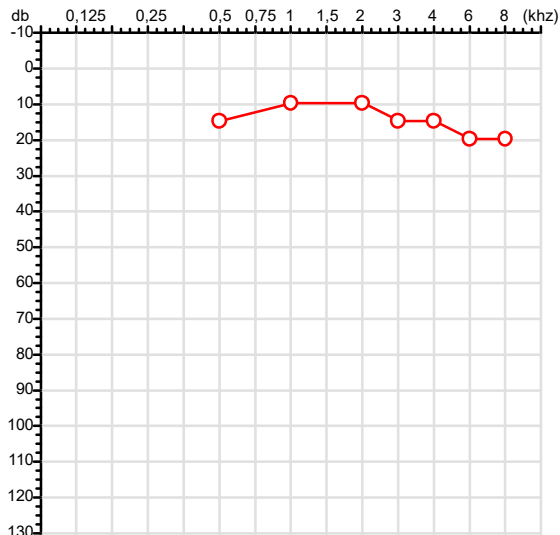

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

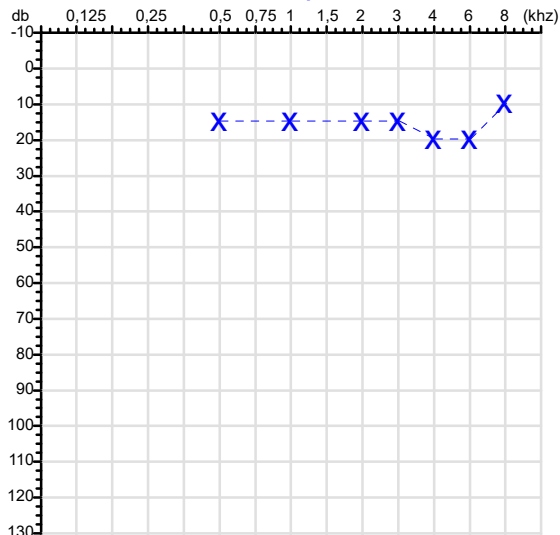

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	20	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2864FBA2EB4EB90FF078900DC63B8557

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gessika Souza Franco

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 764086
Primeiro Nome: GESSIKA SOUZA F
Sobrenome:
Data: 03/09/2025

Data de nascimento: 21/04/1991
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 64.0
Altura (cm): 171.0

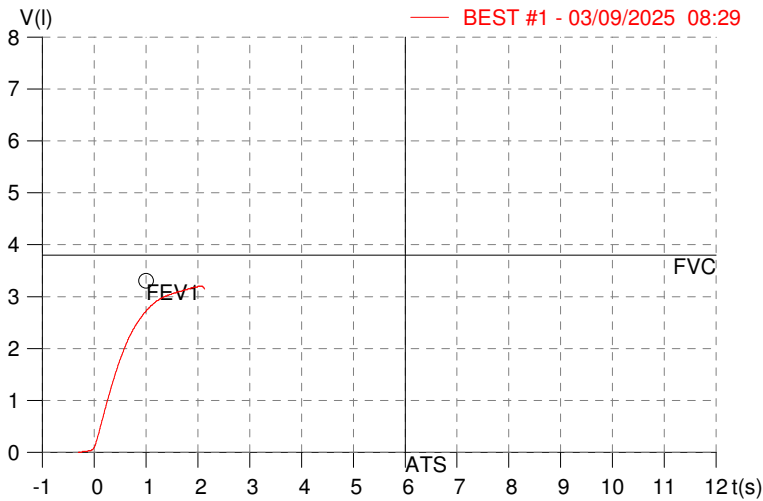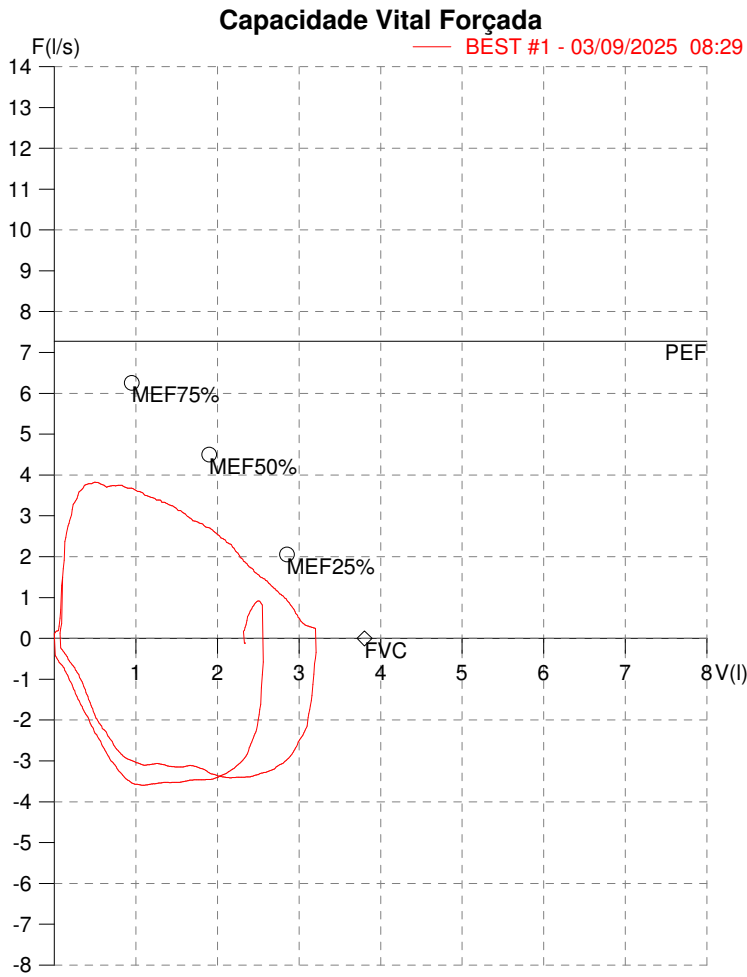

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.80	3.22	84.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.80	3.22	84.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.30	2.71	82.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.28	3.83	52.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.41	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.6	84.3	102.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.90	2.81	72.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.26	3.75	59.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.50	3.04	67.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.06	1.75	85.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	436.5	229.5	52.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 03/09/2025