


Exame n.º :764091

CPF :011.032.091-32
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :18/02/1983
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/09/2025

Paciente :FABIO MIRANDA DA SILVA
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 42 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO I

RG :/

Orelha Direita

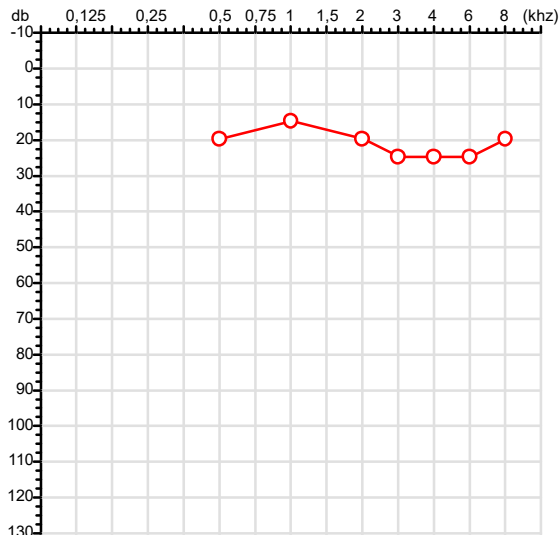

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

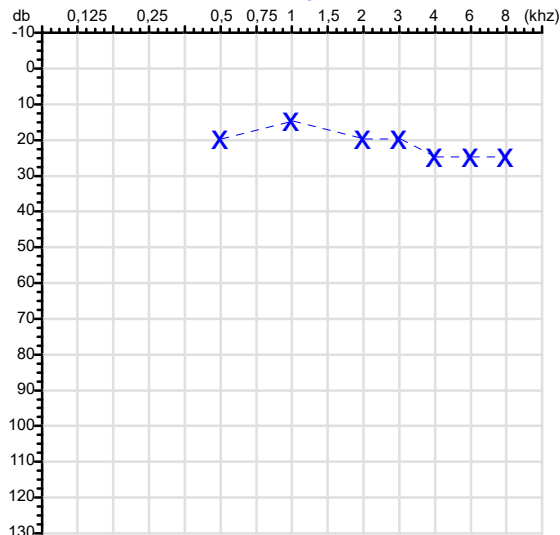

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :05ECFF30C76FE759C3244FE79AF5E3CF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Fabio Miranda da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 764091
Primeiro Nome: FABIO MIRANDA
Sobrenome: SILVA
Data: 03/09/2025

Data de nascimento: 18/02/1983
Sexo: Macho
Peso (kg): 87.0
Altura (cm): 162.0

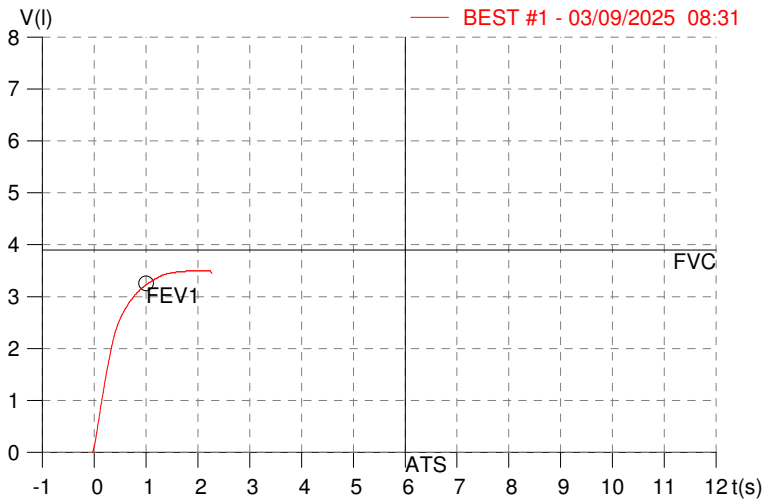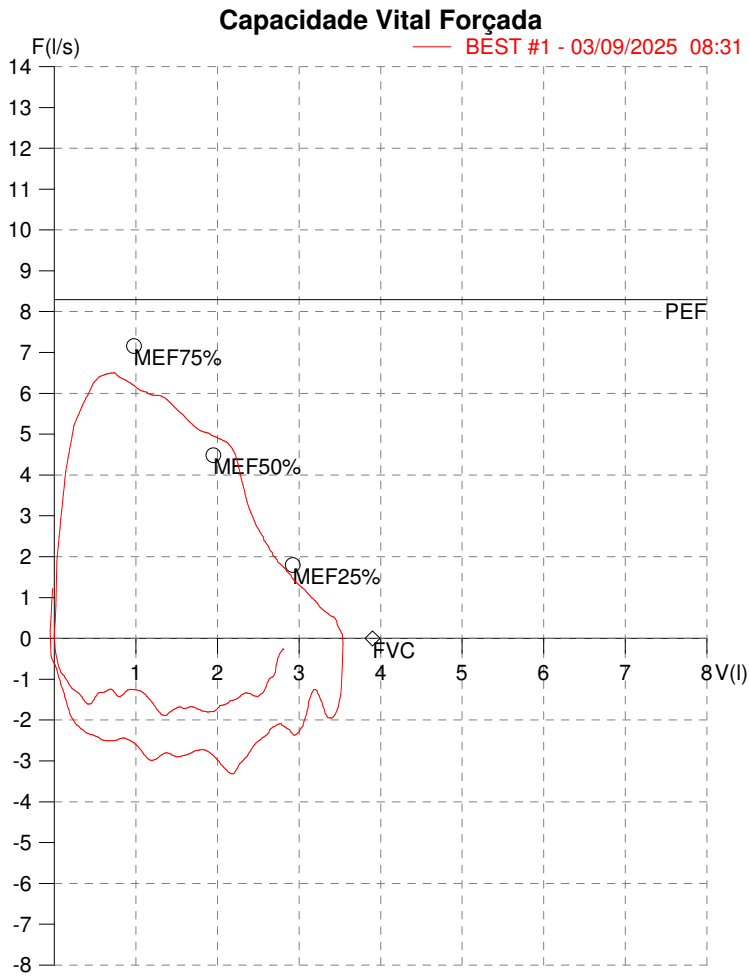

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.90	3.54	90.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.90	3.54	90.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.26	3.25	99.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.29	6.50	78.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.32	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.6	91.9	115.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.04	4.44	110.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.16	6.24	87.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.49	5.08	113.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.80	2.17	120.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	497.4	390.1	78.4

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 03/09/2025