


Exame n.º :764092

CPF :041.367.651-00
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :11/06/1985
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/09/2025

Paciente :Isio Nunes da Silva
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 40 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :21680078/sspmt

Orelha Direita

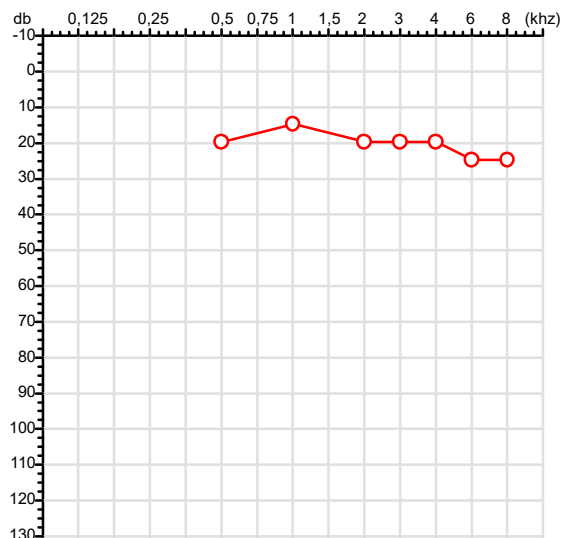

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

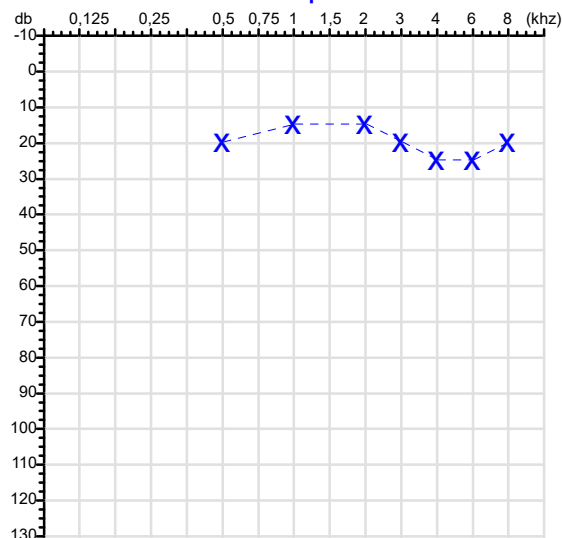

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C10B01F8B9D9AE6F2878AA29D29B0219

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Isio Nunes da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 764092
Primeiro Nome: SIO NUNES
Sobrenome: SILVA
Data: 03/09/2025

Data de nascimento: 11/06/1985
Sexo: Macho
Peso (kg): 73.0
Altura (cm): 175.0

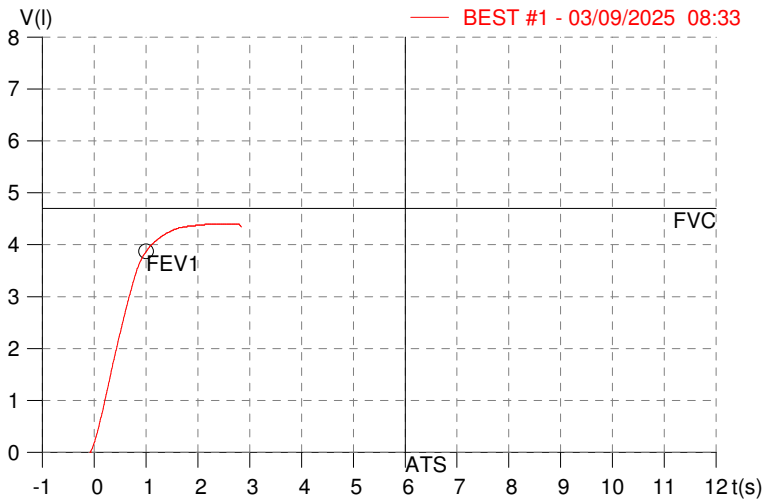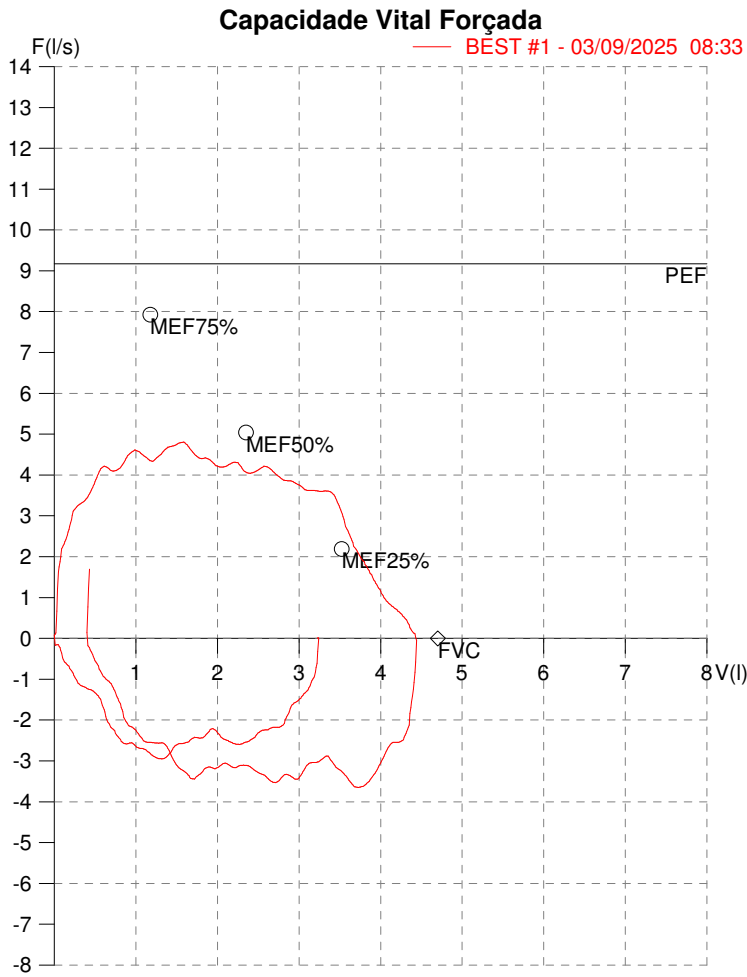

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.70	4.43	94.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.70	4.43	94.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.87	3.87	99.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.18	4.81	52.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.65	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.0	87.4	109.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.38	4.15	94.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.93	4.43	55.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.04	4.32	85.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	3.61	165.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	550.5	288.4	52.4

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 03/09/2025