


Exame n.º :764122

CPF :030.395.623-20
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :14/10/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/09/2025

Paciente :MAURICIO CONCEICAO DA SILVA
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 38 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO I

RG :/

Orelha Direita

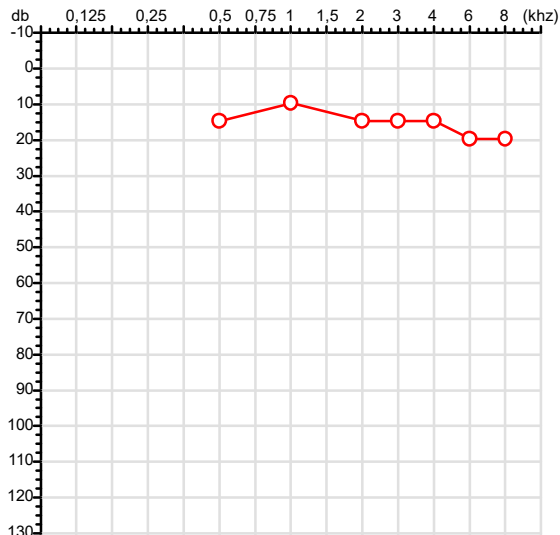

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

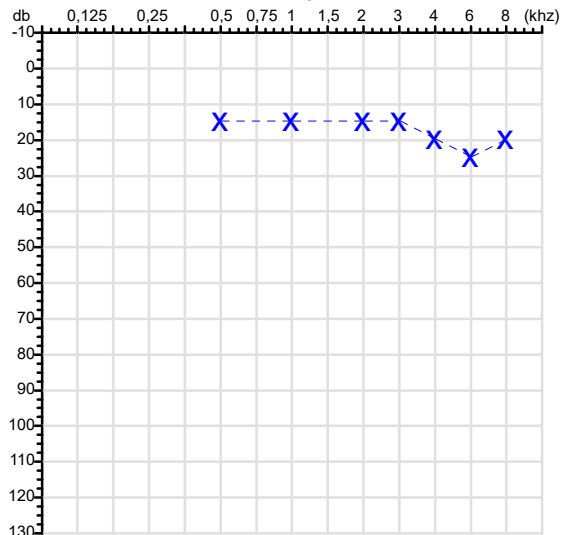

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :B97233258DDFD38FF80A0FA2041BEF2A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mauricio Conceicao da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 764122
Primeiro Nome: MAURICIO CONCEICAO
Sobrenome: DA SILVA
Data: 03/09/2025

Data de nascimento: 14/10/1986
Sexo : Macho
Peso (kg): 57.0
Altura (cm): 165.0

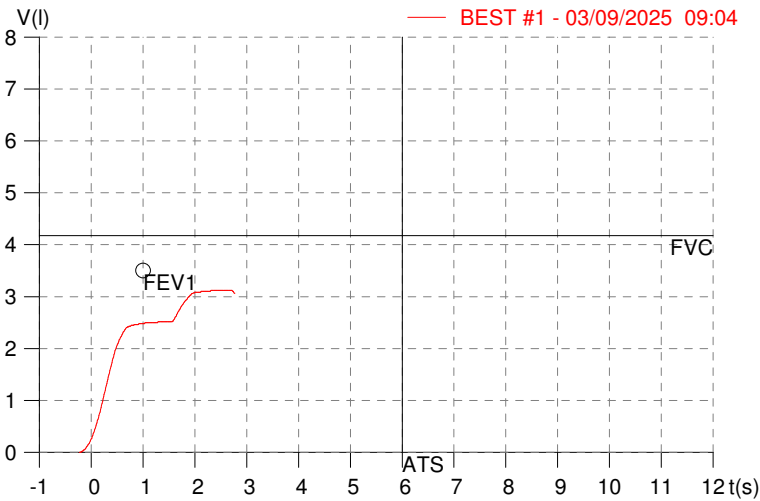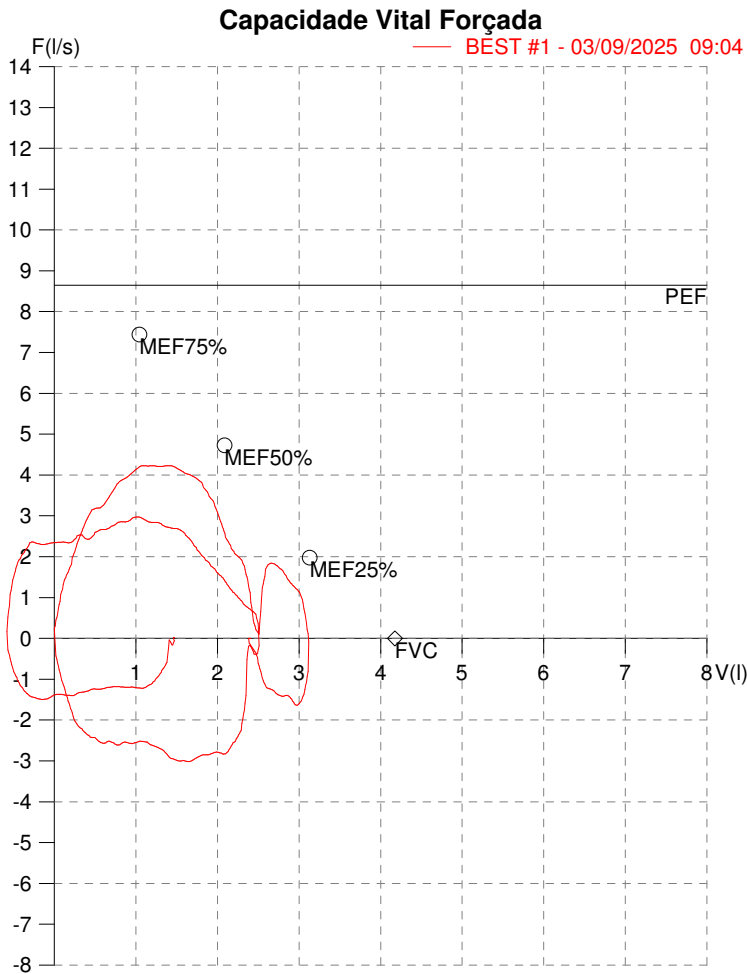

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.18	3.14	75.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.18	3.14	75.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.50	2.50	71.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.65	4.23	48.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.64	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.4	79.6	99.0
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.27	3.36	78.8
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.44	3.78	50.8
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.73	4.09	86.5
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	1.69	85.4
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	518.8	253.9	48.9

Diagnóstico:
ANORMALIDADE MODERADA

Impresso 03/09/2025