


Exame n.º :765671

CPF :469.260.201-59
CNPJ :44.652.938/0001-61
Nascimento :30/06/1966
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/09/2025

Paciente :Aliei Batista da Silva
Razão : ULTRAMIX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
Idade : 59 anos
Setor :OBRA
Função :ENCARREGADO DE OBRAS

RG :/

Orelha Direita

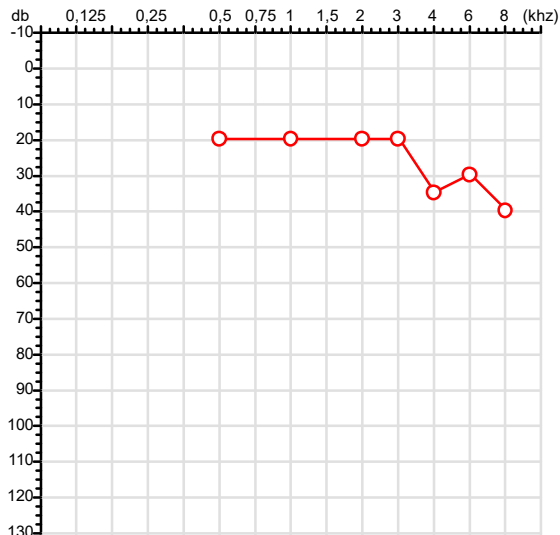

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	35	30	40

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	35	30	28


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

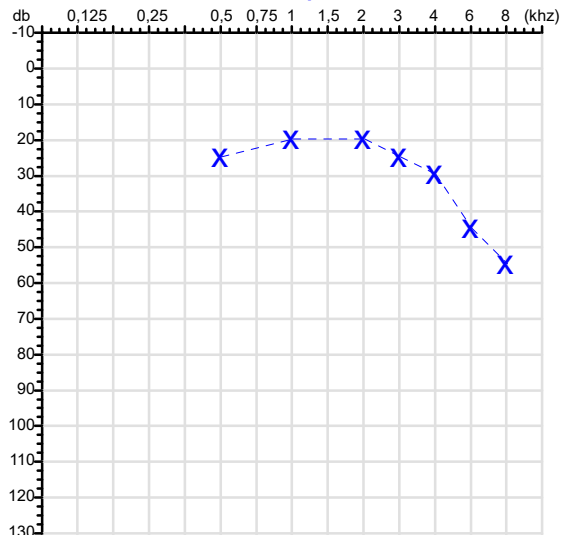

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	30	45	55

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	30	45	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :4C522337FAF933D2C1BA85CECEEE5AEF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aliei Batista da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 10/09/2025
Primeiro Nome: ALIEL BATISTA DA
Sobrenome: SILVA
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 70.0

Data de nascimento: 30/06/1966
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

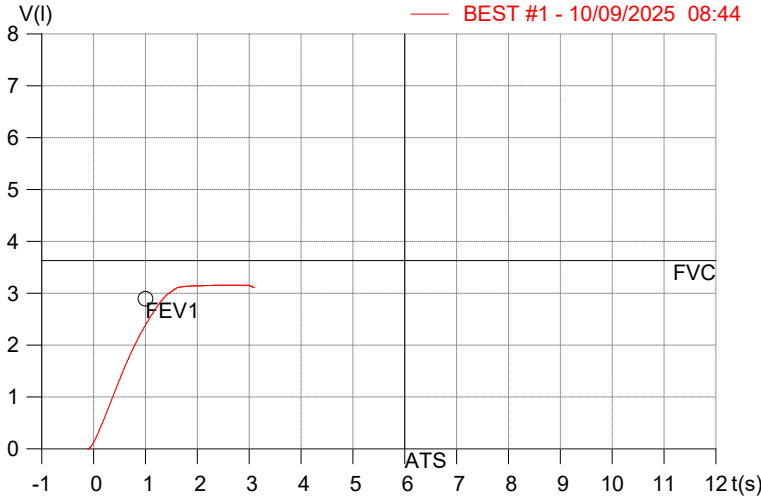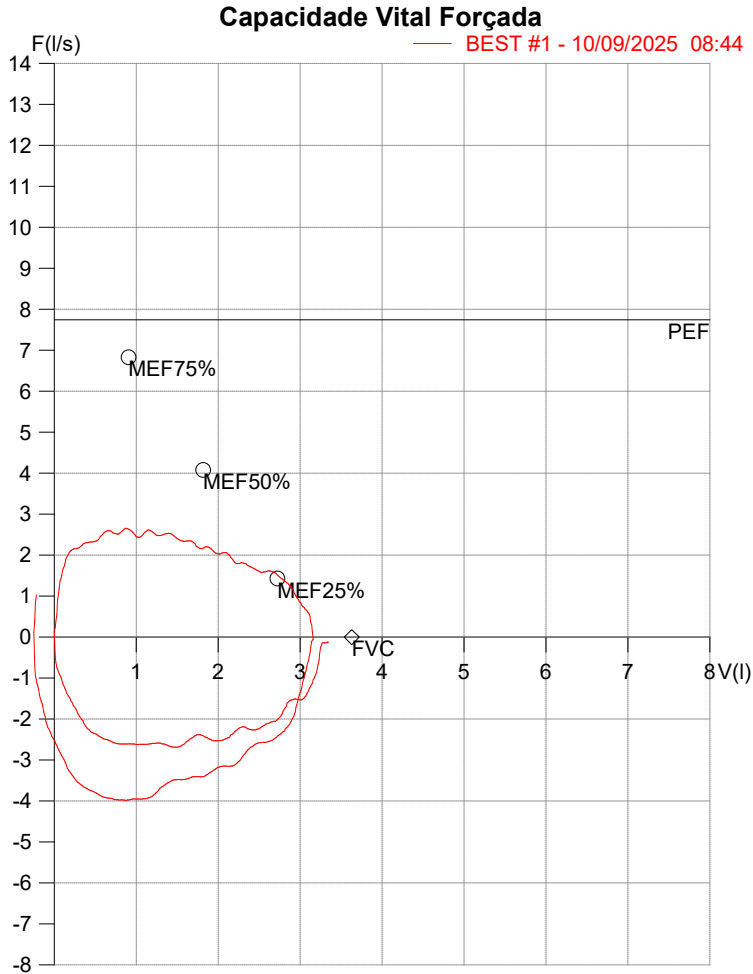

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.63	3.17	87.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.63	3.17	87.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.89	2.37	81.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.74	2.65	34.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.98	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.6	74.7	97.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.36	2.26	67.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.83	2.51	36.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.07	2.34	57.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.43	1.75	121.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	464.6	159.1	34.2

Diagnóstico:
Espirometria normal