



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 766189

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. SERGIO DA SILVA - CRM N.º 1511 MT

CNPJ : 19.293.041/0002-22

Fantasia : EXTRA MAQUINAS

Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C

Complemento : SALA: 02

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.010-500

### Funcionário

Nome : Carla Maiara Batista Chaves

Setor: VENDAS

CPF : 018.551.241-06

Cargo: CONSULTOR DE VENDAS DE MAQUINAS

RG : /

Nascimento: 18/12/1987

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                         | Cód eSocial | Risco      | Agente                                        |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ACIDENTE DE TRANSITO, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS |             | ERGONÔMICO | POSTURAL, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição     |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 281          | 11/09/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 295          | 11/09/2025 | EXAME CLINICO |

### Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 11 de setembro de 2025



Carla Maiara Batista Chaves

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=766189>




# Exame n.º :766189

CPF :018.551.241-06 Paciente :CARLA MAIARA BATISTA CHAVES  
 CNPJ :19.293.041/0002-22 Razão :EXTRA MAQUINAS S/A  
 Nascimento :18/12/1987 Idade : 37 anos  
 Motivo :Admissional Setor :VENDAS  
 Repouso :14h Função :CONSULTOR DE VENDAS DE MAQUINAS  
 Data do Exame : 11/09/2025


RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

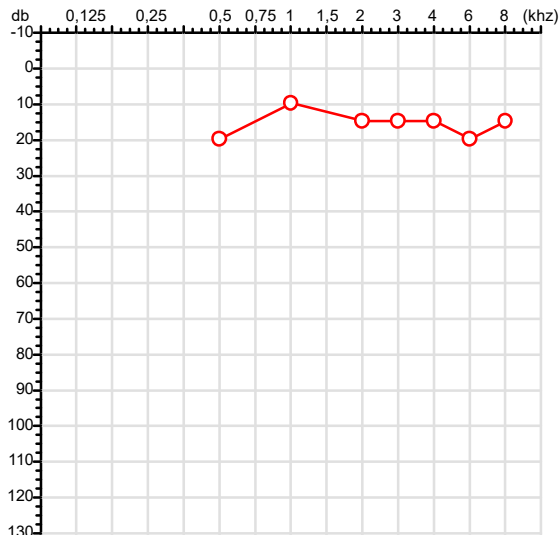

### Orelha Esquerda

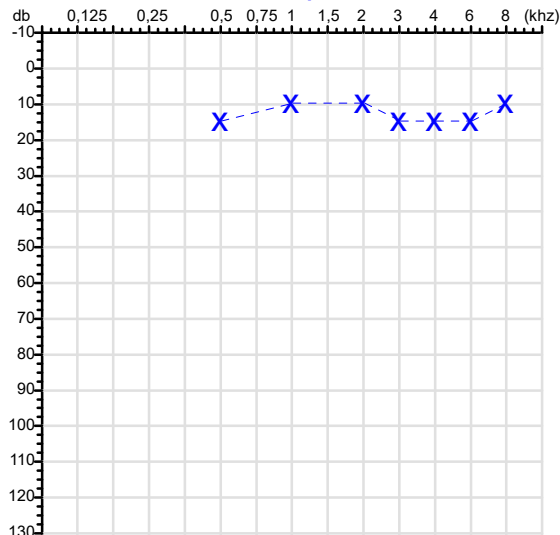

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E97C2A16FB9B29D7768FCC65D9CF260B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
*Carla Maiara Batista Chaves*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 766189

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. SERGIO DA SILVA - CRM N.º 1511 MT

CNPJ : 19.293.041/0002-22

Fantasia : EXTRA MAQUINAS

Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C

Complemento : SALA: 02

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.010-500

### Funcionário

Nome : Carla Maiara Batista Chaves

Setor: VENDAS

CPF : 018.551.241-06

Cargo: CONSULTOR DE VENDAS DE MAQUINAS

RG : /

Nascimento: 18/12/1987

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                         | Cód eSocial | Risco      | Agente                                        |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ACIDENTE DE TRANSITO, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS |             | ERGONÔMICO | POSTURAL, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição     |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 281          | 11/09/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 295          | 11/09/2025 | EXAME CLINICO |

### Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 11 de setembro de 2025



Carla Maiara Batista Chaves

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=766189>

