


Exame n.º :766482

CPF :067.115.871-62
CNPJ :21.215.242/0001-72
Nascimento :25/06/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/09/2025

Paciente :Moises Pereira Moreira
Razão :ELIZEU GOMES PEREIRA
Idade : 30 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

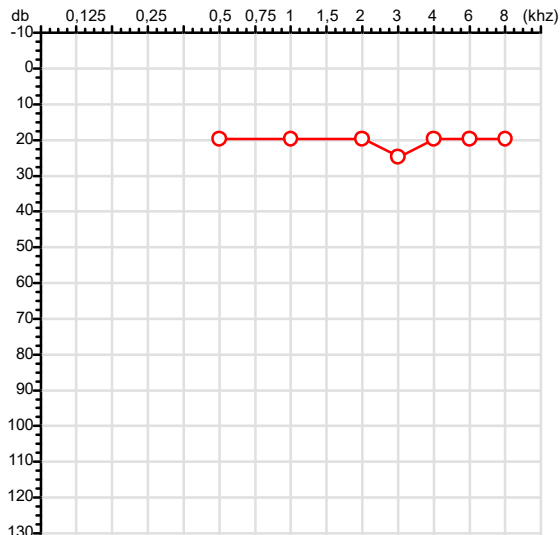

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	20	20	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	20	20	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

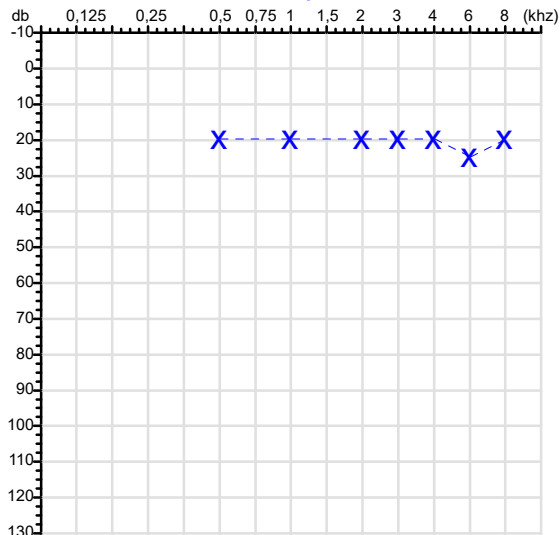

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :24325A8C560BE485DE0EA972DF7ED8D3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Moises Pereira Moreira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 12/09/2025
Primeiro Nome: MOISES PEREIRA
Sobrenome: MOREIRA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 65.0

Data de nascimento: 25/06/1995
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Sim(20/5)

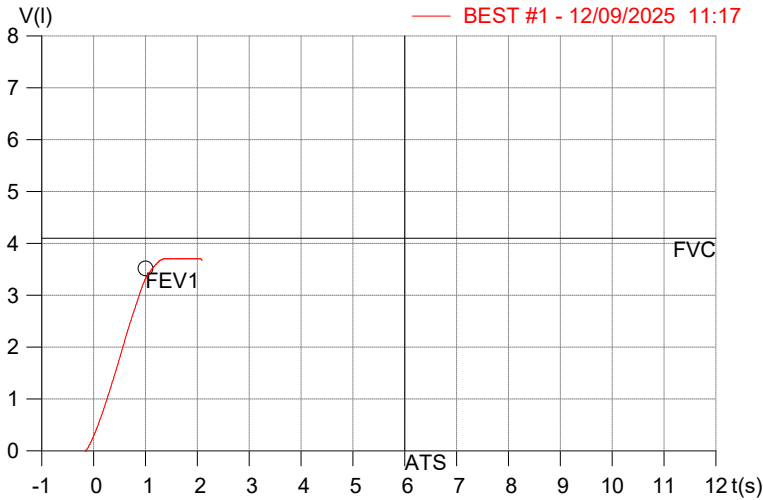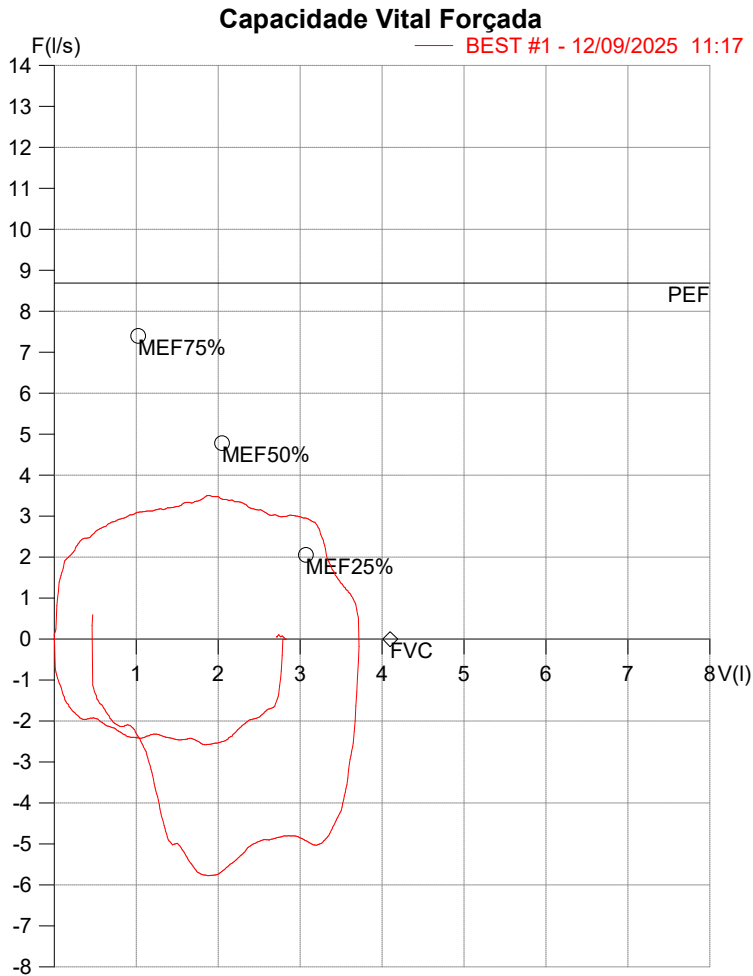

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.10	3.72	90.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.10	3.72	90.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.52	3.29	93.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.68	3.51	40.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.77	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	88.5	108.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.51	3.23	71.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.40	3.03	40.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.78	3.50	73.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.06	2.99	145.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	521.0	210.3	40.4

Diagnóstico:
Espirometria normal