

Exame n.º :766483

CPF :053.477.911-52
CNPJ :21.215.242/0001-72
Nascimento :03/02/1994
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/09/2025

Paciente :Ademilson Junior da Silva
Razão :ELIZEU GOMES PEREIRA
Idade : 31 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

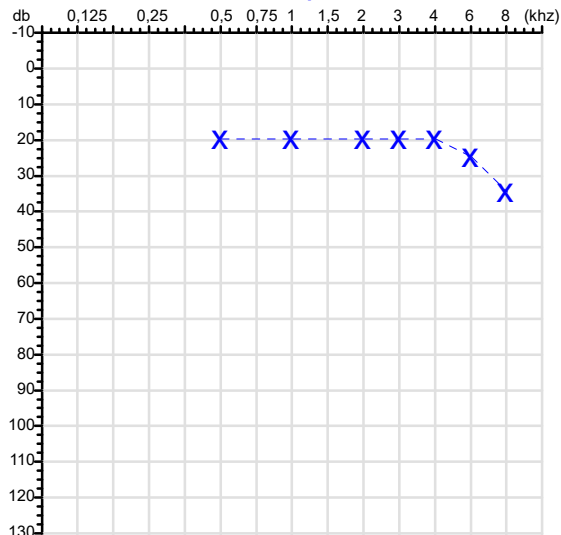

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	25	35

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :024D1EC461D02D970A82EFDE400AAFB4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ademilson Junior da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 12/09/2025
Primeiro Nome: ADEMILSON JUNIOR DA
Sobrenome: SILVA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 65.0

Data de nascimento: 03/02/1994
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Sim(20/3)

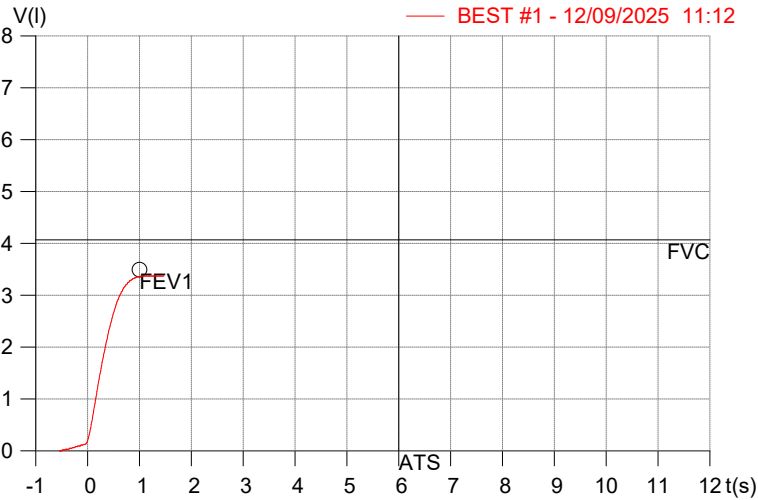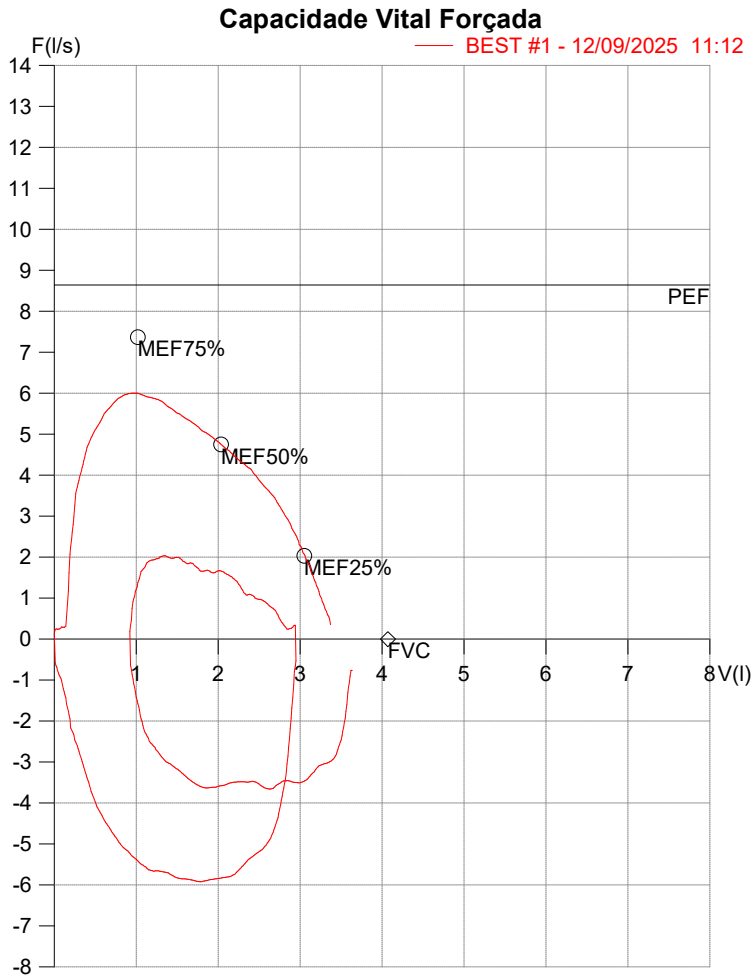

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.07	3.39	83.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.07	3.39	83.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.49	3.37	96.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.64	6.00	69.5
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.6	99.6	122.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.47	5.06	113.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.37	5.95	80.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.75	5.26	110.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	3.76	185.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	518.5	360.1	69.5

Diagnóstico:
Espirometria normal