


# Exame n.º :766809

CPF :076.001.421-39  
CNPJ :78.958.717/0005-61  
Nascimento :17/06/2007  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 15/09/2025

Paciente :Davi Pereira Dos Santos  
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Idade : 18 anos  
Setor :GHE 17 ADMINISTRATIVO  
Função :APRENDIZ OPERADOR DE PROCESSOS LOGISTICOS

RG :/

## Orelha Direita

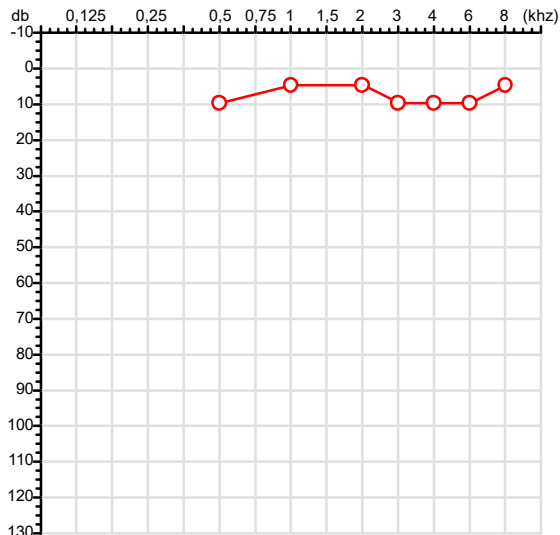

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6  | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|---|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OD db | 10  | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

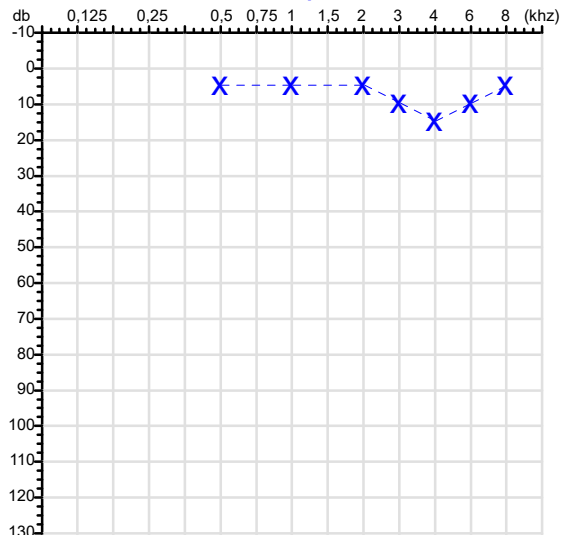

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6  | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|---|
| OE db | NDG  | 5   | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OE db | 5   | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 12 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :32F1A33DE0B4E48E3E55FC61C6EC39C2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Davi Pereira Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025