


Exame n.º :771797

CPF :121.224.921-63
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :28/01/1974
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/10/2025

Paciente :REGURO RAFAEL RAMIREZ DELGADO
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 51 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

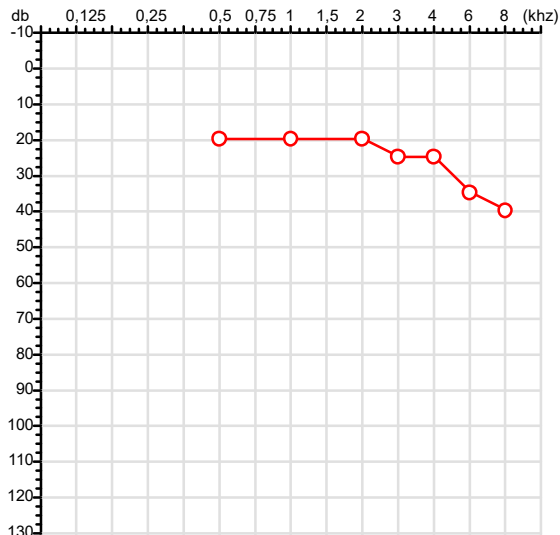

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

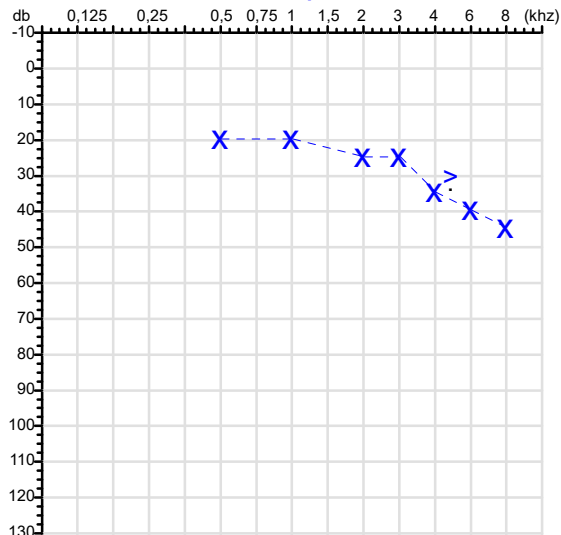

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	40	45

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :99A24889496F9124CC5FC1347FDF9206

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Reguro Rafael Ramirez Delgado

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 771797
Primeiro Nome: REGURO RAFAEL
Sobrenome: RAMIREZ
Data: 08/10/2025

Data de nascimento: 28/01/1974
Sexo: Macho
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 170.0

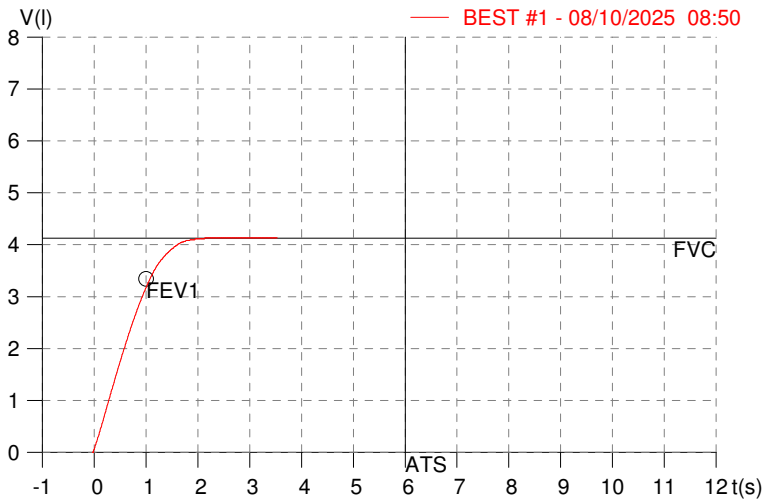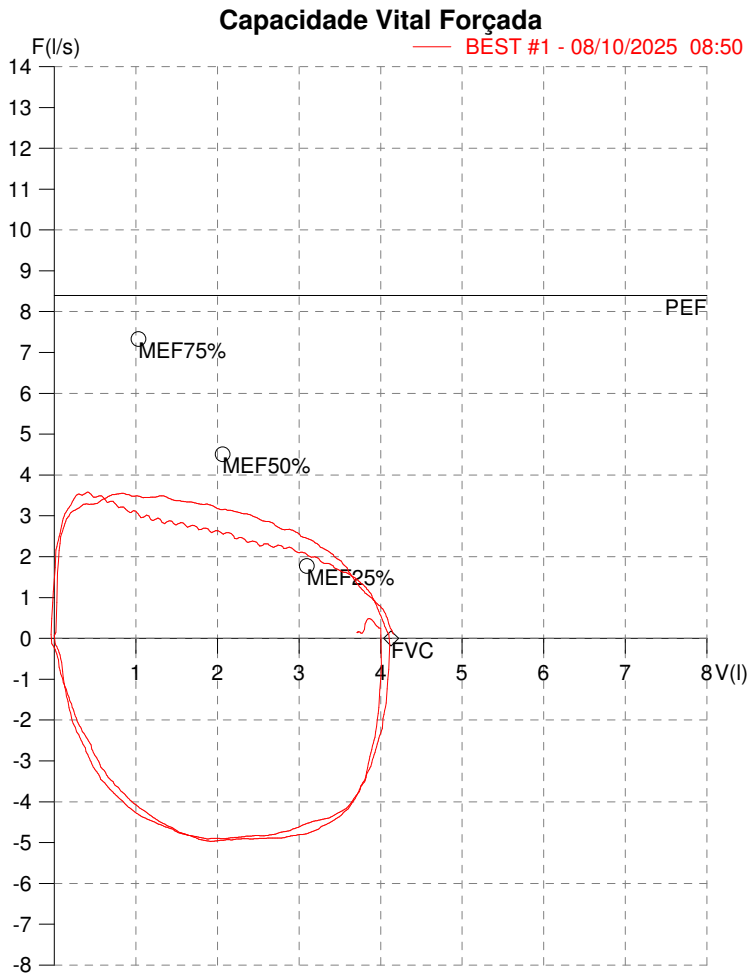

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.13	4.17	101.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.13	4.17	101.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.34	3.17	94.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.40	3.55	42.3
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	78.0	75.9	97.2
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	3.81	3.06	80.4
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.33	3.47	47.3
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.51	3.16	70.0
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.77	2.43	137.3
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	503.7	213.0	42.3

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 08/10/2025