

Exame n.º :772017


CPF :487.584.341-00
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :09/05/1967
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/10/2025

Paciente :Geraldo Claudino da Silva
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 58 anos
Setor :ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

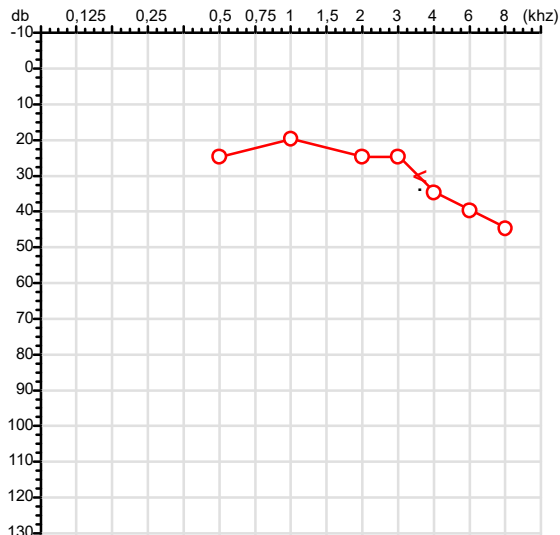

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	35	40	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	25	35	40	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

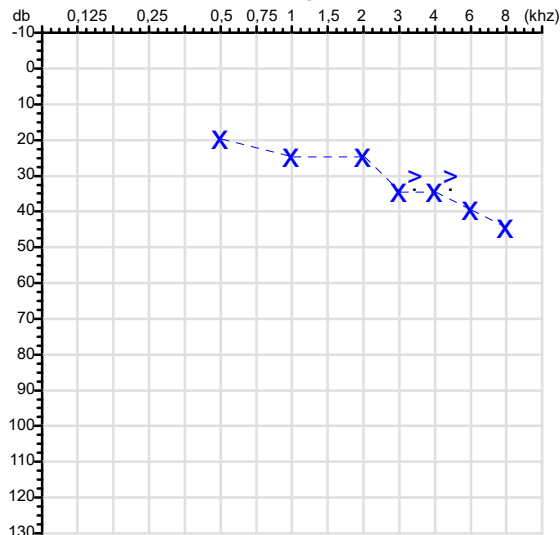

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	35	35	40	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	35	35	40	37

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BB49277E3F1A77CE79FA5755DF5773F7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Geraldo Claudino da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 772017
Primeiro Nome: GERALDO CLAUDINO
Sobrenome: SILVA
Data: 09/10/2025

Data de nascimento: 09/05/1967
Sexo: Macho
Peso (kg): 67.0
Altura (cm): 175.0

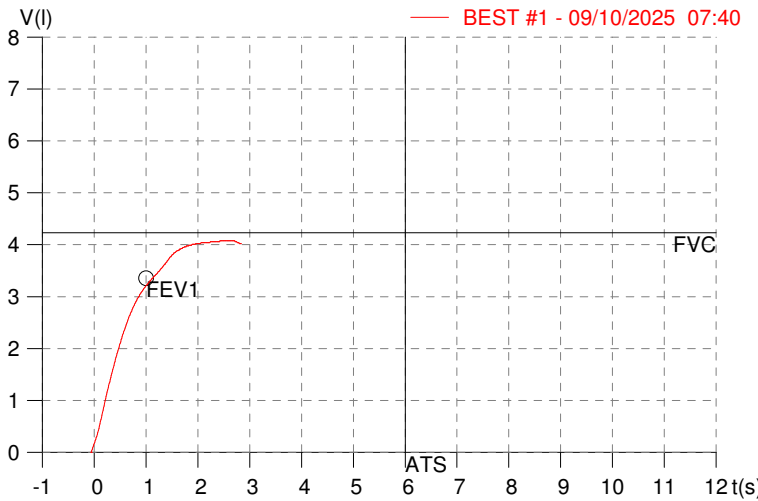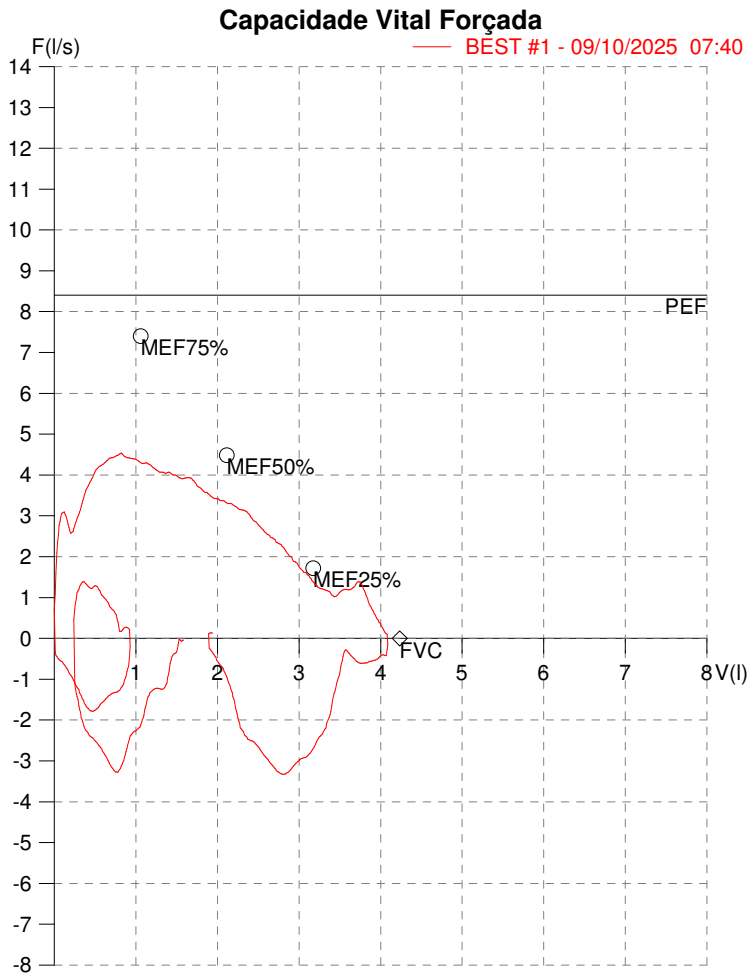

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.23	4.11	97.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.23	4.11	97.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.35	3.21	95.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.40	4.54	54.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.33	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.8	78.3	102.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.60	3.04	84.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.40	4.33	58.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.48	3.38	75.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.72	1.62	94.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	504.1	272.5	54.1

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 09/10/2025