


Exame n.º :773091

CPF :409.598.328-07
CNPJ :26.504.759/0001-03
Nascimento :11/02/1991
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/10/2025

Paciente :Debora Vieira Rufino Santos
Razão :PROMINAS CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA
Idade : 34 anos
Setor :ADMINISTRATIVO
Função :COORDENADOR DE PROJETOS MINERACAO

RG :SSP SP

Orelha Direita

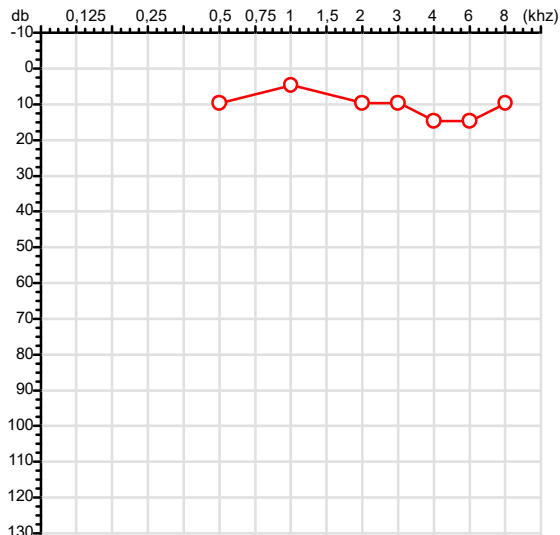

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	15	15	13


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

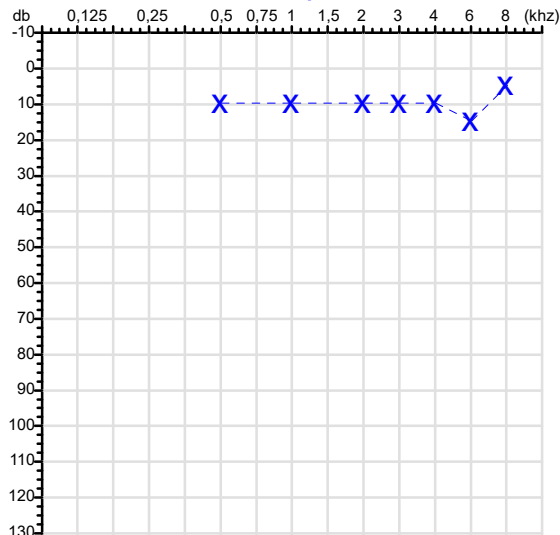

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	10	10	15	5

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :032EBF3BCE272075CF31F0F4C47C3433

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Debora Vieira Rufino Santos

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 773091
Primeiro Nome: DEBORA VIEIRA
Sobrenome: SANTOS
Data: 14/10/2025

Data de nascimento: 11/02/1991
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 57.0
Altura (cm): 170.0

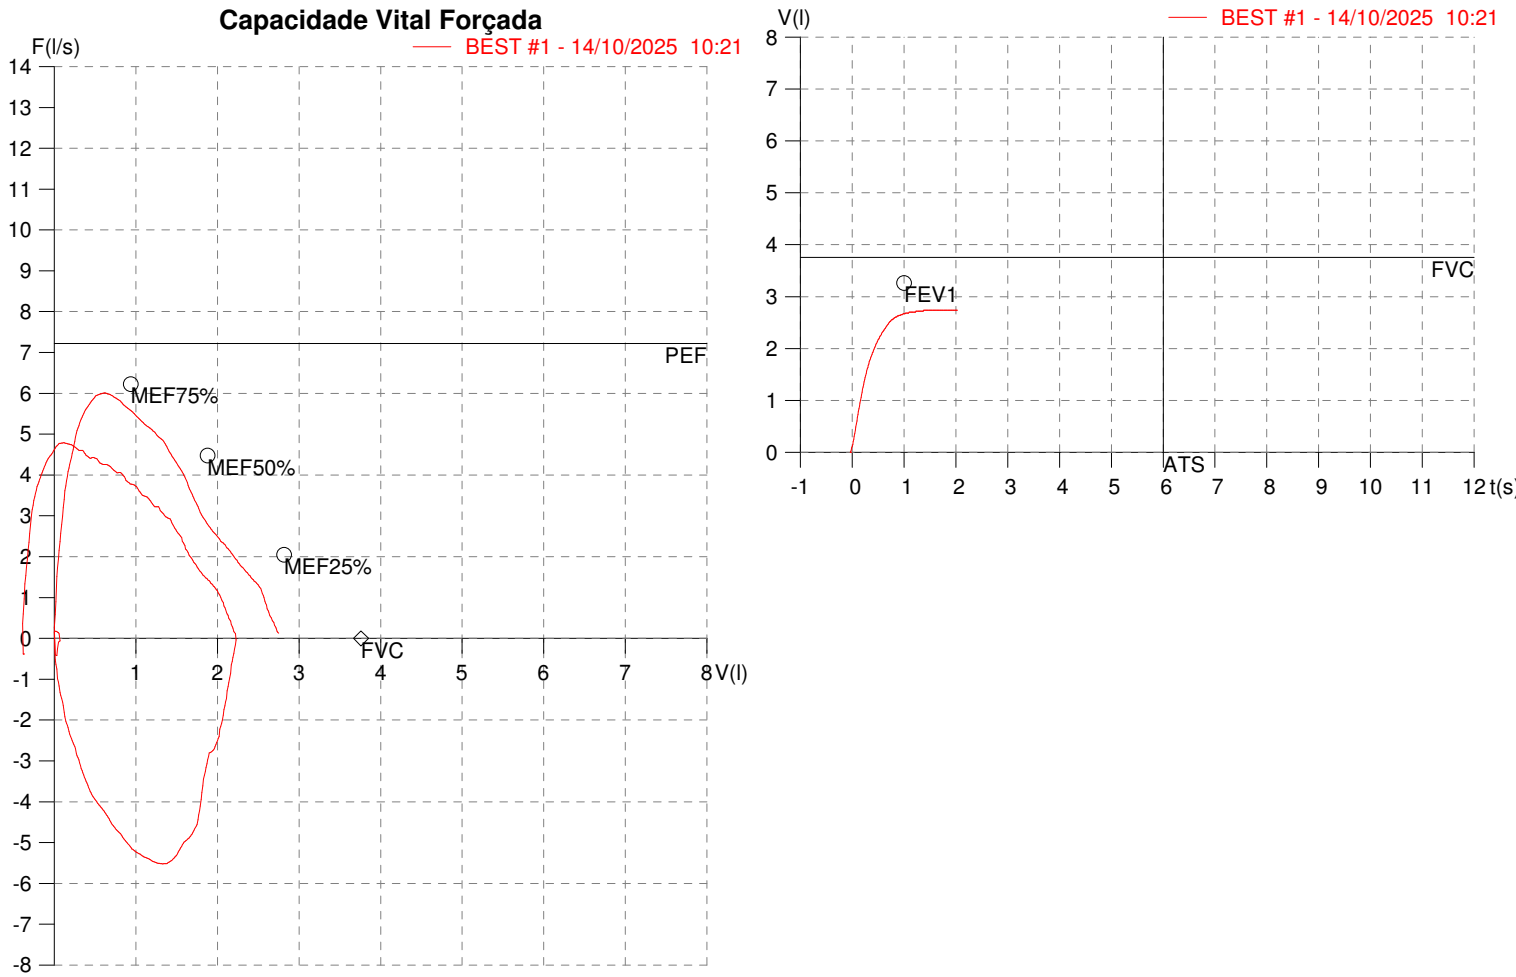

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.76	2.77	73.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.76	2.77	73.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.27	2.70	82.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.22	6.01	83.2
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.6	97.6	118.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.89	3.98	102.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.22	5.97	95.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.48	4.73	105.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.05	2.34	114.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	433.2	360.5	83.2

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 14/10/2025