

Protocolo: 25102312191037

Data: 23/10/2025

Paciente: FRANCISCO MOISES LIMA CARDOSO

Nasc.: 22/05/1995 RG: 3774554-SSP PI

CPF: 07030268369

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=459928847375084204072937269675>



Protocolo : 25102312160637 Data : 23/10/2025
Paciente : FRANCISCO MOISES LIMA CARDOSO
Nasc. : 22/05/1995 RG : 3774554-SSP PI CPF : 07030268369
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432


v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=557755828039754367471065540930>



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 23/10/2025
Primeiro Nome: FRANCISCO MOISES
Sobrenome: LIMA CARDOSO
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento: 22/05/1995
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: LUIZ PAULO MURARO
Fuma: Não

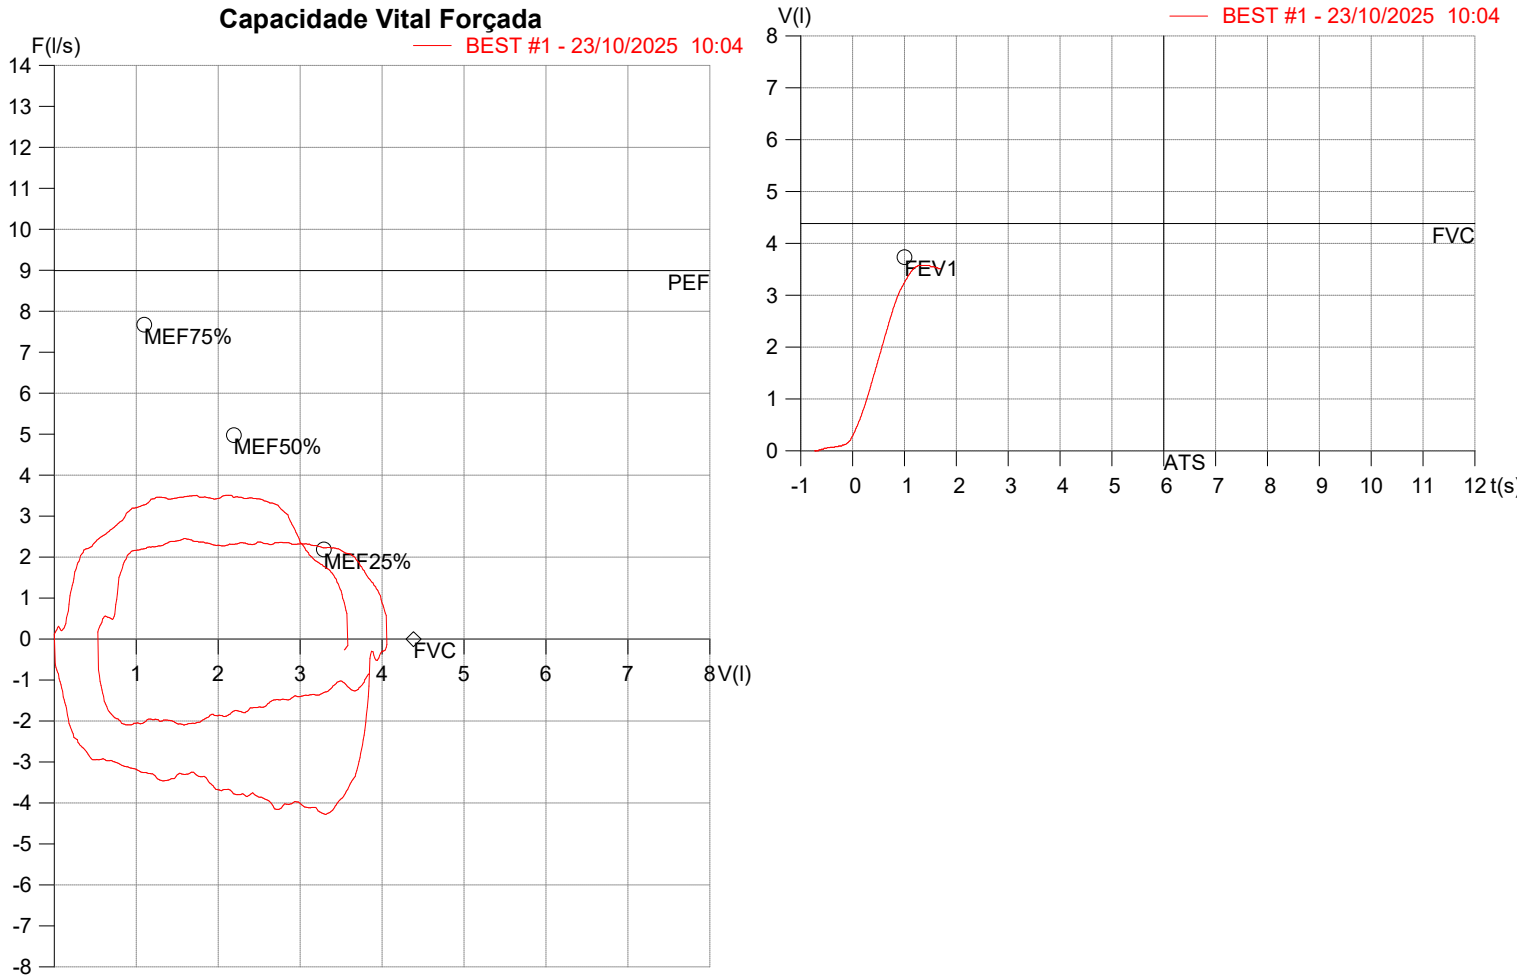

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.38	3.59	81.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.38	3.59	81.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.73	3.23	86.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.99	3.51	39.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	90.1	110.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.61	3.40	73.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.67	3.07	40.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.97	3.46	69.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	3.30	150.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	539.5	210.5	39.0

Diagnóstico:
Espirometria normal


Exame n.º :775014

CPF :070.302.683-69
CNPJ :20.930.377/0001-57
Nascimento :22/05/1995
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 23/10/2025

Paciente :FRANCISCO MOISES LIMA CARDOSO
Razão :LUIZ PAULO MURARO LTDA
Idade : 30 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR (A) DE MAQUINA

RG :3774554/SSP PI

Orelha Direita

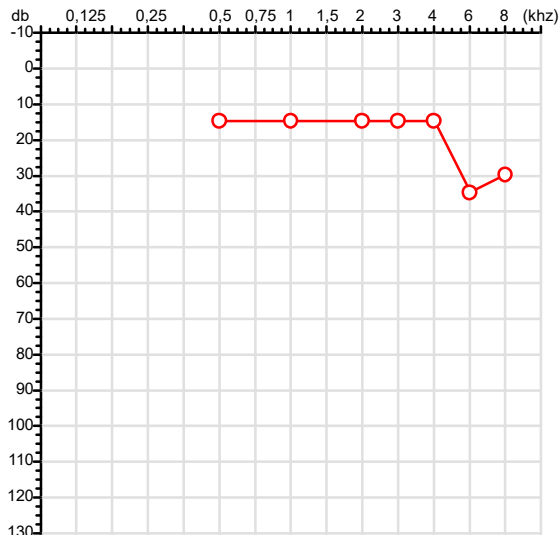

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	35	30

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	35	22


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

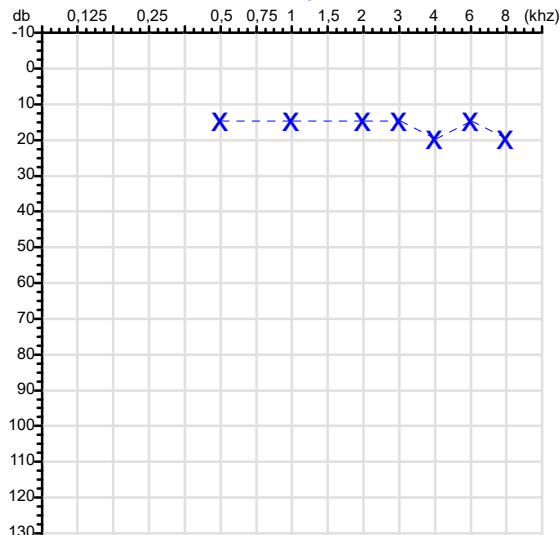

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	15	20

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :CF31CAD7D2AA82755CB390694C64DC1E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francisco Moises Lima Cardoso

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025