

Exame n.º :775644


CPF :032.283.131-82
CNPJ :45.253.105/0001-90
Nascimento :21/01/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/10/2025

Paciente :Jhonatan Alves Rodrigues
Razão :A L SILVA
Idade : 34 anos
Setor :PRODUCAO
Função :SOLDADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

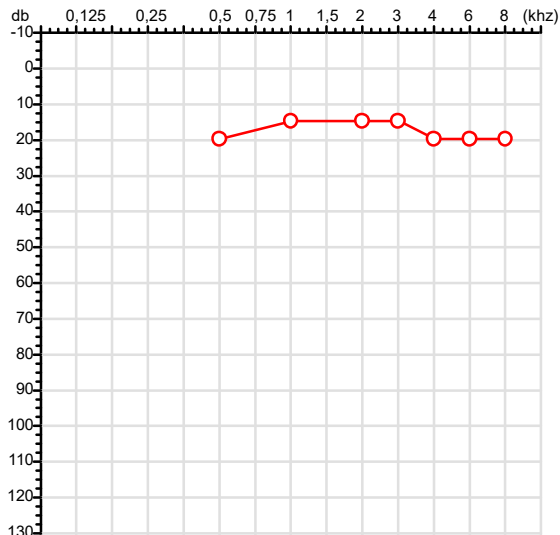

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

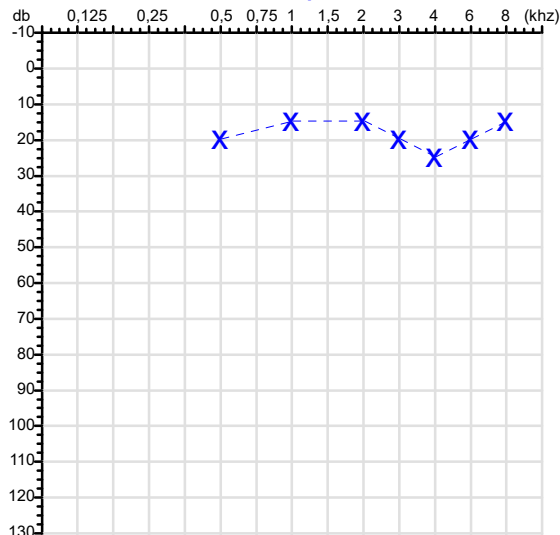

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2AC98A814D7E1FEDDF20ECC01A24BECB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jhonatan Alves Rodrigues

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:775844

Primeiro Nome:Jhonatan Alves

Sobrenome:RODRIGUES


Data:27/10/2025

Data de nascimento:21/01/1991

Sexo :Macho

Peso (kg):82.0

Altura (cm):169.0

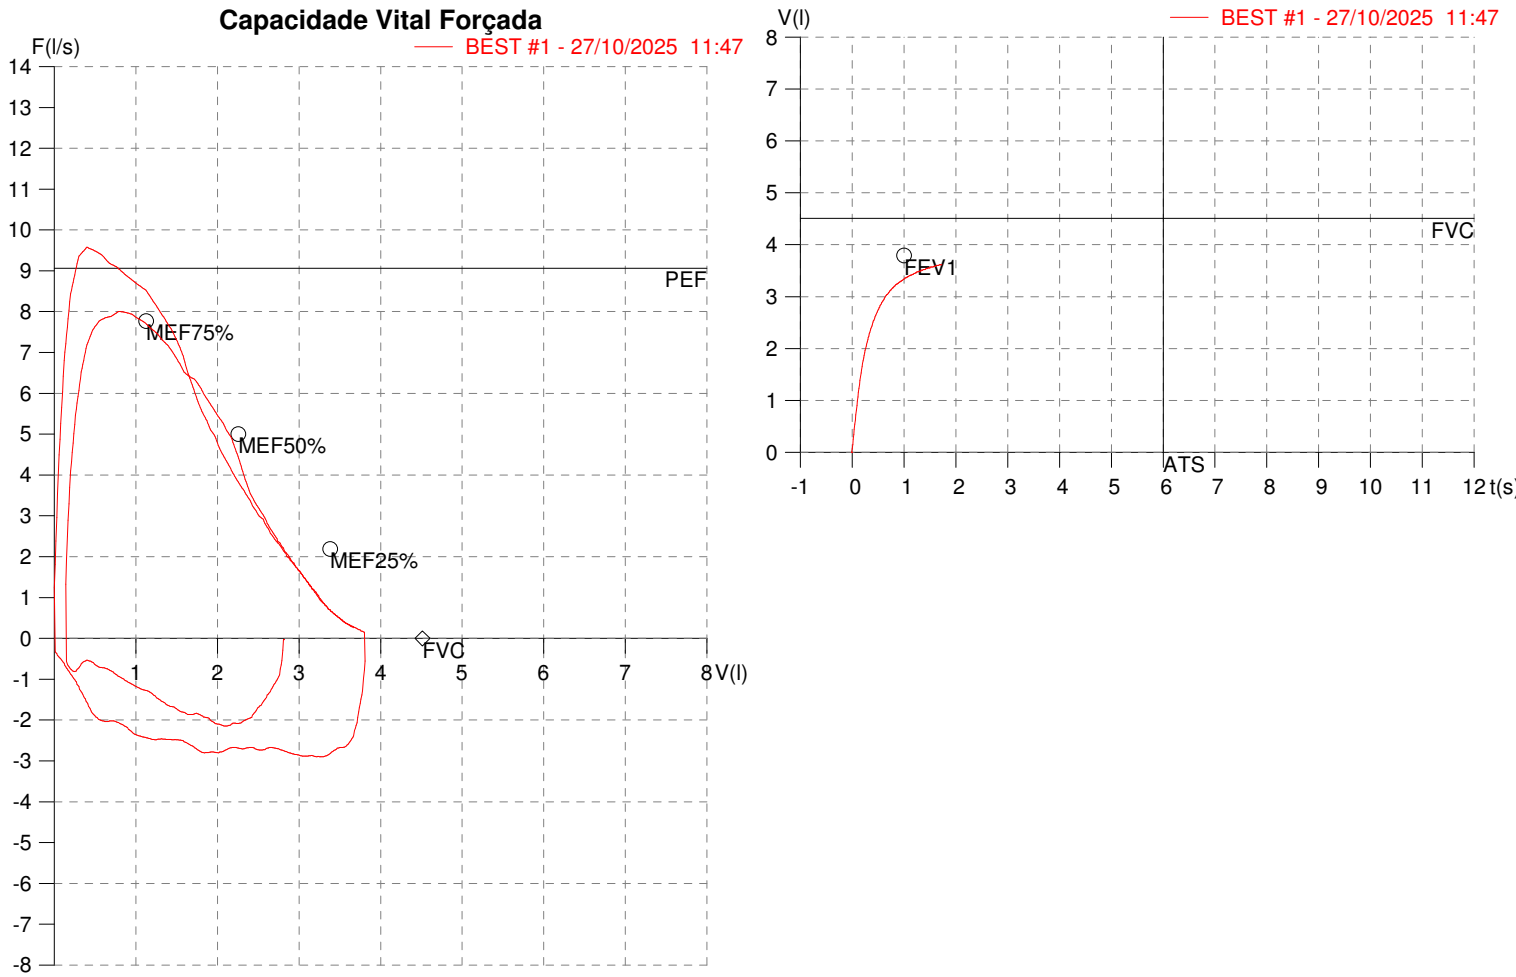

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.51	3.69	81.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.51	3.69	81.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.79	3.40	89.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.06	9.58	105.7
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.1	92.2	113.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.52	4.70	104.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.77	8.78	113.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.00	5.33	106.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	2.32	106.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	543.9	574.6	105.7

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 27/10/2025