



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Stephani Labadessa Nunes de Almeida Setor: ADMINISTRATIVO
CPF : 05331159141 Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA
RG : / Nascimento: 13/11/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :175211558045E7B383B29009DB193E27
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :053.311.591-41	Paciente :STEPHANI LABADESSA NUNES DE ALMEIDA	RG :/
CNPJ :77.591.402/0001-32	Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A	
Nascimento :13/11/2001	Idade : 24 anos	
Motivo :Periódico	Setor :ADMINISTRATIVO	
Repouso :14h	Função :ASSISTENTE DE ENGENHARIA	
Data do Exame : 03/02/2026		

Orelha Direita

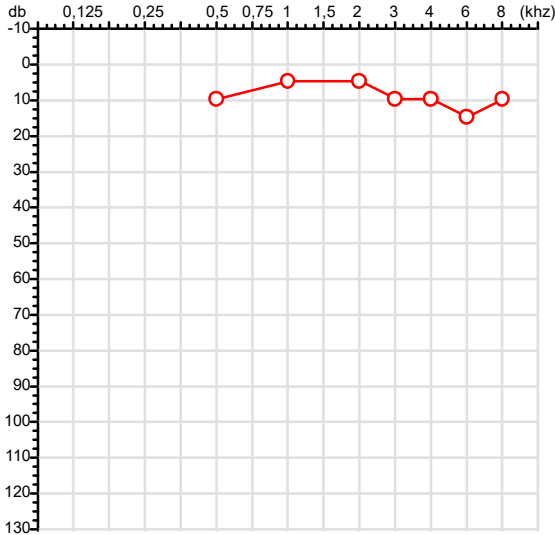

Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :BF37153FEC7D7A75F3104BCD00CC4FB7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Stephani Labadessa Nunes de Almeida
** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 797406
Primeiro Nome: STEPHANI
Sobrenome: LABADESSA NUNES
Data: 03/02/2026

Data de nascimento: 13/11/2001
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 54.0
Altura (cm): 161.0

Capacidade Vital Forçada

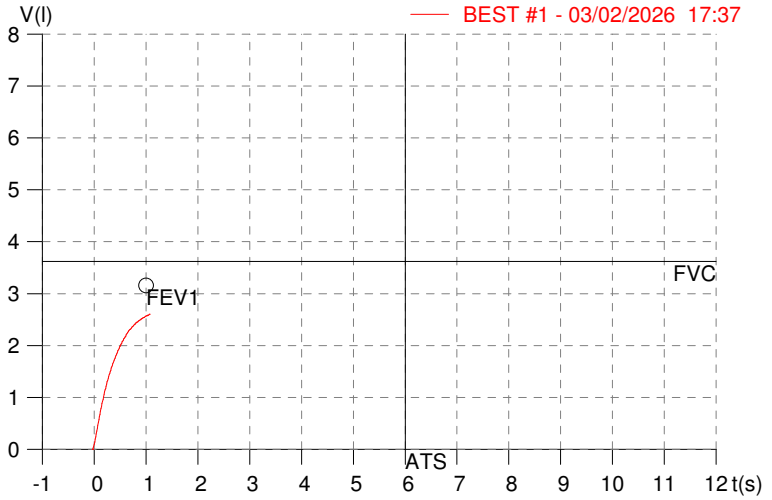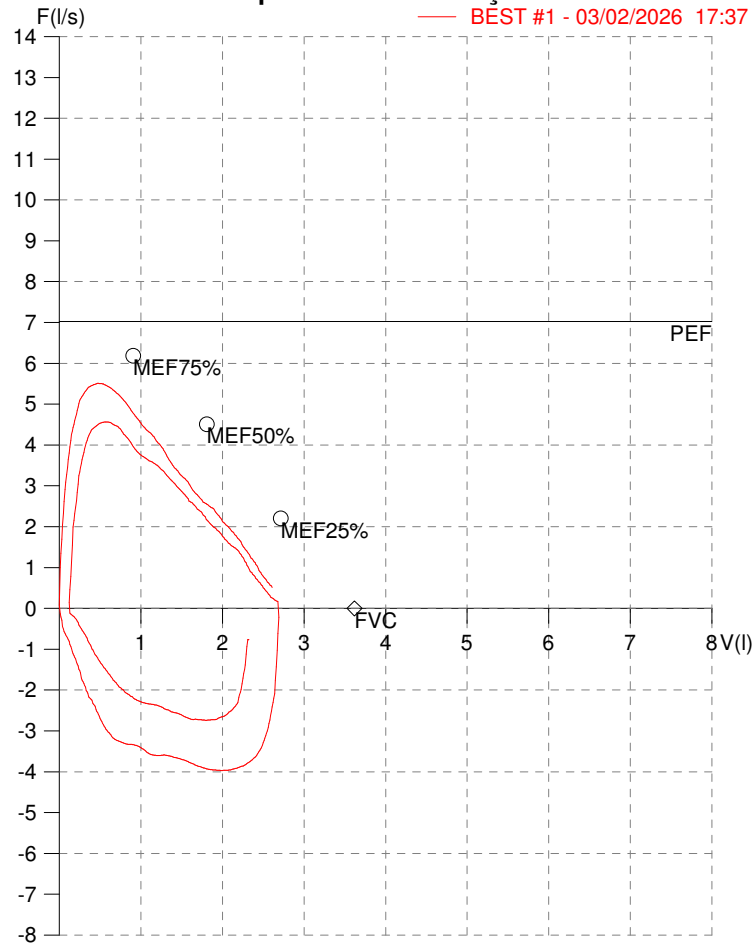

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.62	2.64	72.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.62	2.64	72.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.16	2.59	82.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.03	5.51	78.4
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.5	98.3	116.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.12	3.47	84.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.18	5.38	87.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.50	3.77	83.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.20	2.26	102.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	421.5	330.7	78.4

Diagnóstico:

Anormalidade moderada

Impresso 03/02/2026