
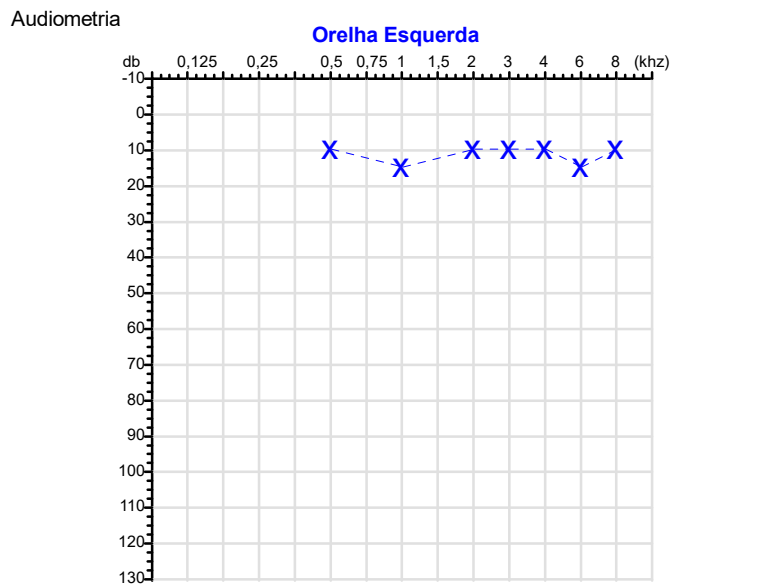


| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| CPF :063.539.201-13 | Paciente :Walison Rodrigues da Silva | RG :28695615/ |
| CNPJ :03.819.157/0011-03 | Razão :LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | |
| Nascimento :05/02/2002 | Idade : 24 anos | |
| Motivo :Demissional | Setor :GERAL | |
| Reposou :14h | Função :COLETOR (A) DE LIXO | |
| Data do Exame : 06/02/2026 | | |

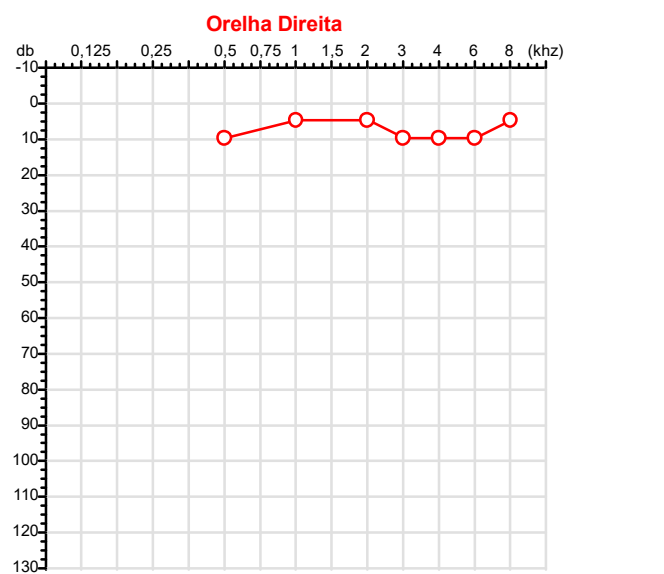

Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|---|
| OD db | NDG | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OD db | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 12 |

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :A871BAB995C73B292CEEF98F935144B5
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Walison Rodrigues da Silva
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025