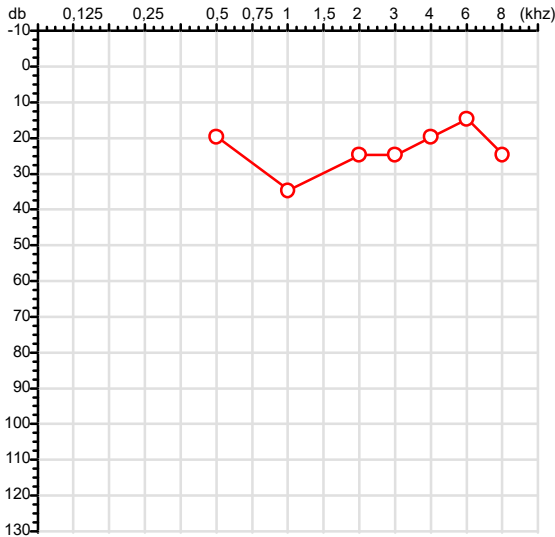
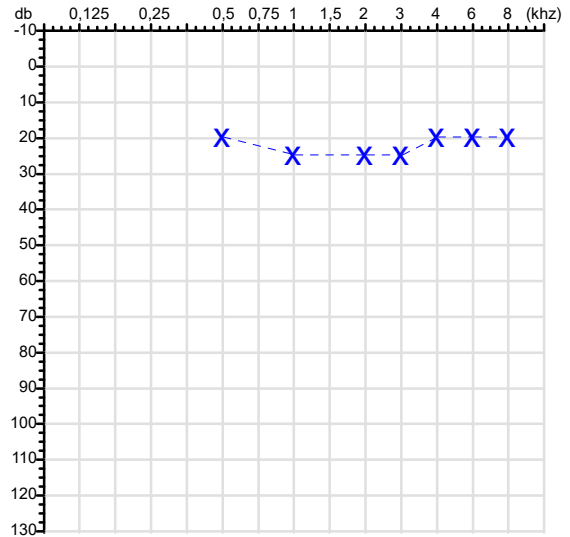


CPF :039.125.601-70 CNPJ :00.187.639/0001-28 Nascimento :05/02/2003 Motivo :Demissional Repouso :14h Data do Exame : 11/02/2026	Paciente :Jose Maria da Costa Razão :EDSON SATELES DE JESUS Idade : 23 anos Setor :TOPOGRAFIA Função :AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	RG :/
--	--	-------

Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	35	25	25	20	15	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	35	25	27	25	20	15	20

Laudo Clínico OD

Perda auditiva de grau leve com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	25	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	25	20	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
 Médica
 CRM-MT 13330
 NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :A0B2669CD7C9E9220C2BE29C94ED1FE4
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Maria da Costa

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 00187639000128 Fantasia : E.S.J. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
Razão Social : EDSON SATELES DE JESUS
Endereço : R CEM N.º 02 Complemento : QUADRA27
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78058000

Funcionário

Nome : Jose Maria da Costa Setor: TOPOGRAFIA
CPF : 03912560170 Cargo: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
RG : / Nascimento: 05/02/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 11 de fevereiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



Autenticação Assintatura :3FCF39D046E769F27F132E2C5AF73998
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 11/02/2026
Primeiro Nome: JOSE MARIA DA COSTA
Sobrenome:
Altura (cm): 184.0
Peso (kg): 100.0

Data de nascimento: 05/02/2003
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: EDSON SATELES
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

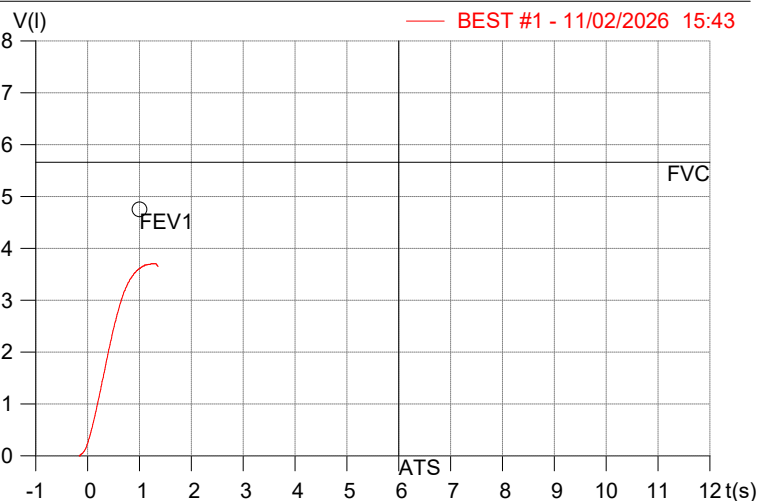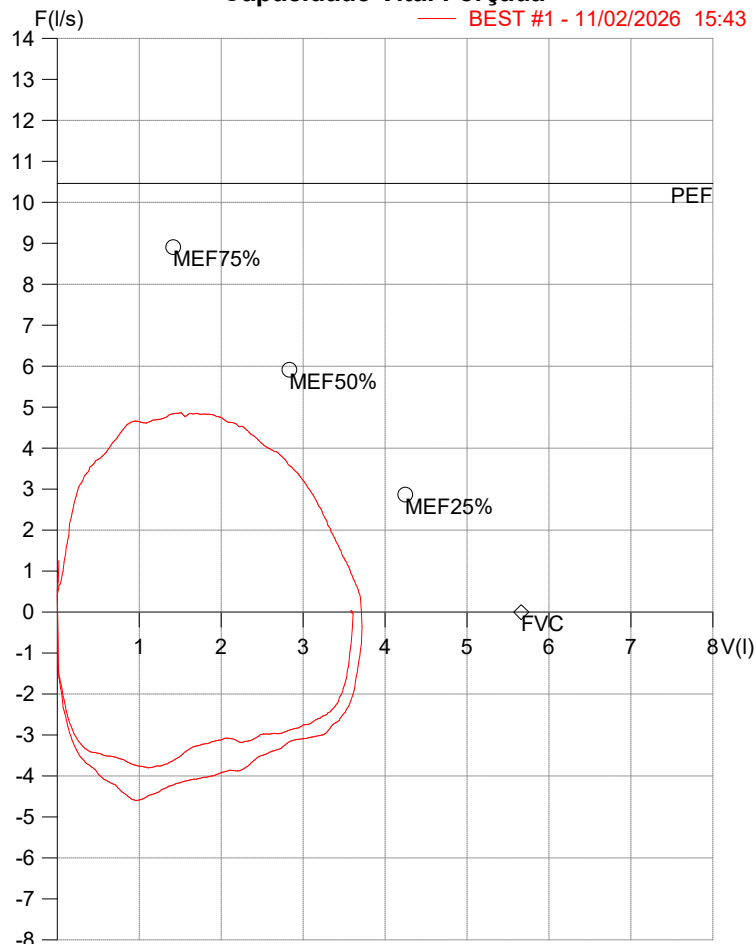

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.66	3.72	65.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.66	3.72	65.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.75	3.61	75.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.46	4.87	46.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.60	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	97.0	116.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.28	4.52	85.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.91	4.65	52.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.91	4.83	81.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.86	3.70	129.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	627.5	292.0	46.5

Diagnóstico:
 Espirometria normal