



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

### Funcionário

Nome : Raimundo Pereira Dos Santos Setor: PAVIMENTACAO  
CPF : 34400699315 Cargo: ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO CAPA  
RG : 1004088 / SSP/MT Nascimento: 09/03/1960

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :C6C1550EF9ADB62BC7B65ADC7F11F0E8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :344.006.993-15	Paciente :Raimundo Pereira Dos Santos	RG :1004088/SSP/MT
CNPJ : 14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :09/03/1960	Idade : 65 anos	
Motivo :Demissional	Setor :PAVIMENTACAO	
Reposuo :14h	Função :ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO CAPA	
Data do Exame : 12/02/2026		

**Orelha Direita**

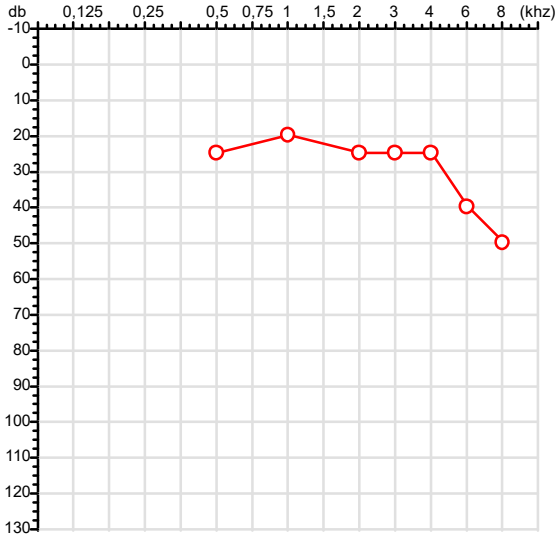

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

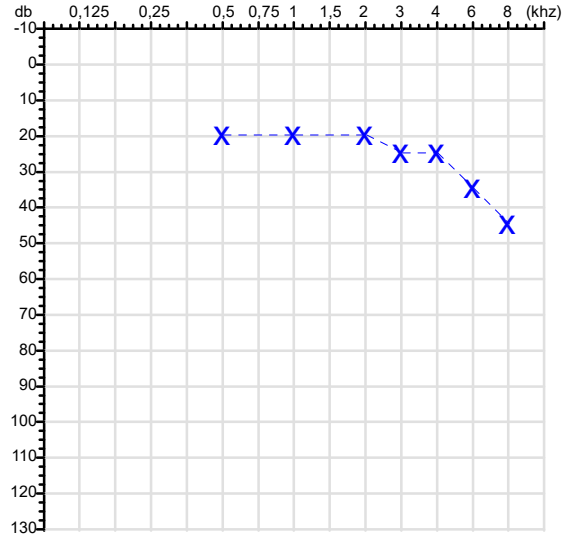

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	25	40	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	45

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	25	25	40	30

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :2690AD561B6FD3C7534A5147396327E3  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



*Raimundo Pereira Dos Santos*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		ID1	799999	Sexo	Masculino	Idade	65,9	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	163,0
Agrupamento	--	D.O.B.	09/03/1960	--	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	28,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	07:37	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,91	3,29	89	
FEV1	L 2,38	2,59	92	
FEV1/FVC%	% 81,5	78,5	104	
FEV1/Vcmax%	% 81,5	78,5	104	

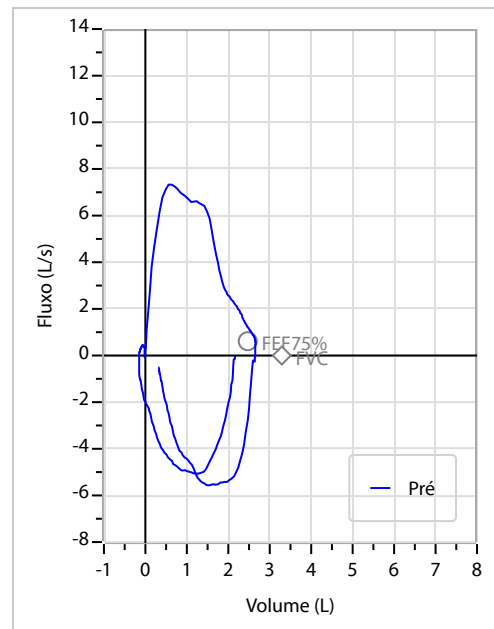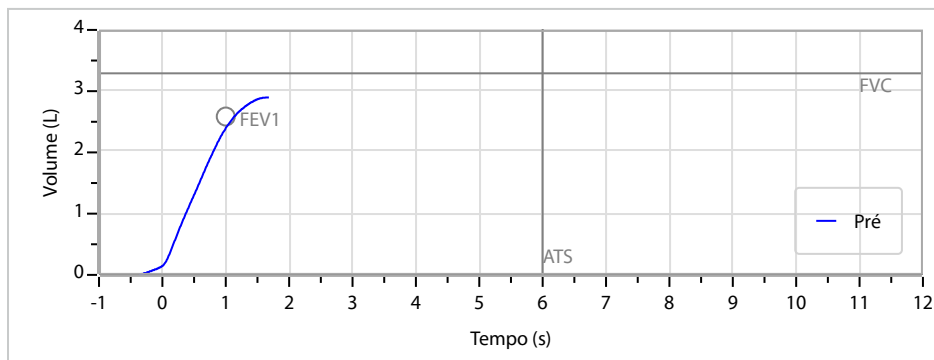

**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 81,5% e um valor FVC de 2,91 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_