
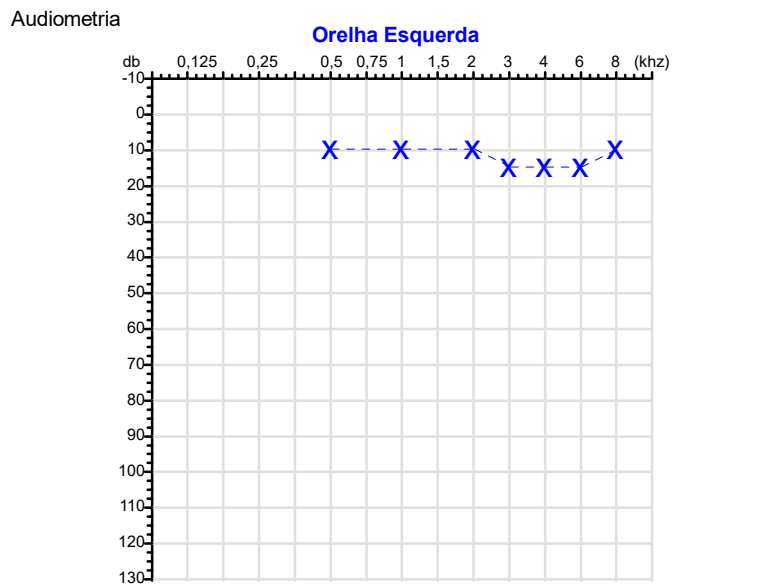


CPF :110.538.432-24	Paciente :VIRGEM AIRAMYANAI FERREIRA NOCEDO	RG :N/A/N/A
CNPJ :09.607.696/0001-93	Razão :J A D SERVICOS EM CONSTRUÇOES LTDA	
Nascimento :18/03/2001	Idade : 24 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :SERVICO GERAIS	
Data do Exame : 25/02/2026		

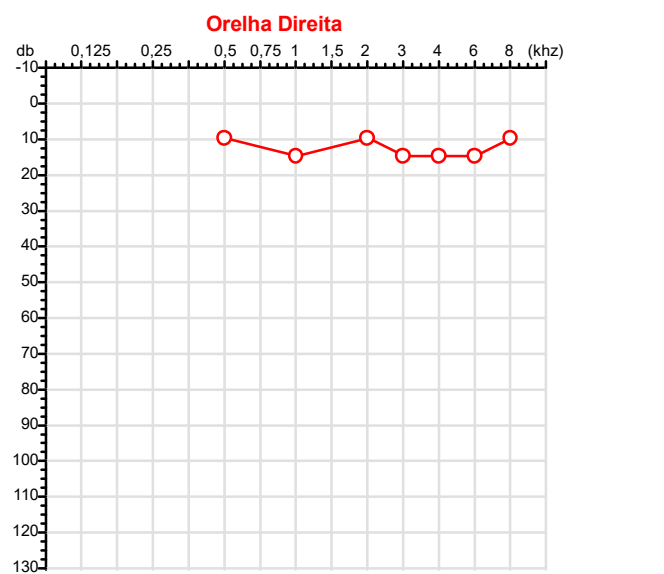

Aérea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	15	15	15	10

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Ossea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	15	15	15	15

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :CF4953AFC8DDC4010663B15C9FBAF3F1
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Virgem Airamyanaí Ferreira Nocedo
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025