



CPF :040.091.531-64 Paciente :Delaine Patricia de Fatima Lopes Cesario RG :/  
 CNPJ :33.381.480/0001-37 Razão :IFORMS ICF FABRICACAO DE ARTEFATOS DE ISOPOR LTDA  
 Nascimento :02/05/1992 Idade : 33 anos  
 Motivo :Periódico Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Data do Exame : 26/02/2026

**Orelha Direita**

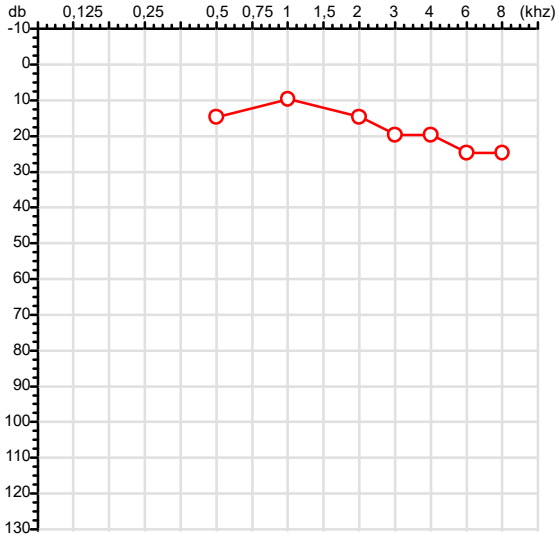

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

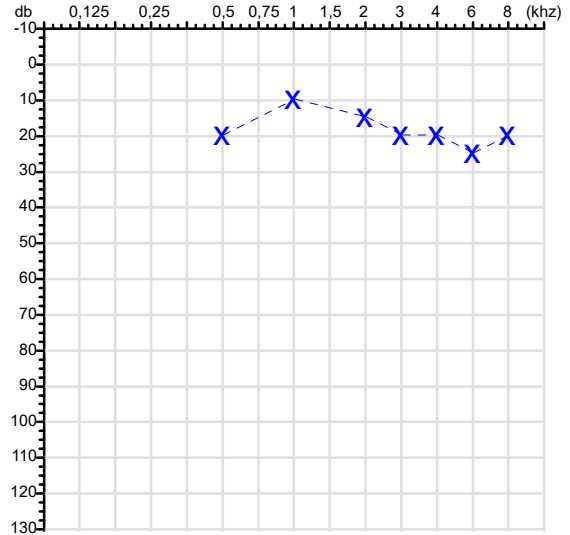

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	20	20	25	20

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	15	15	20	20	25	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B051F545AA33B62D0FC0633FF11D4B84  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Delaine Patricia de Fatima Lopes Cesario*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025