
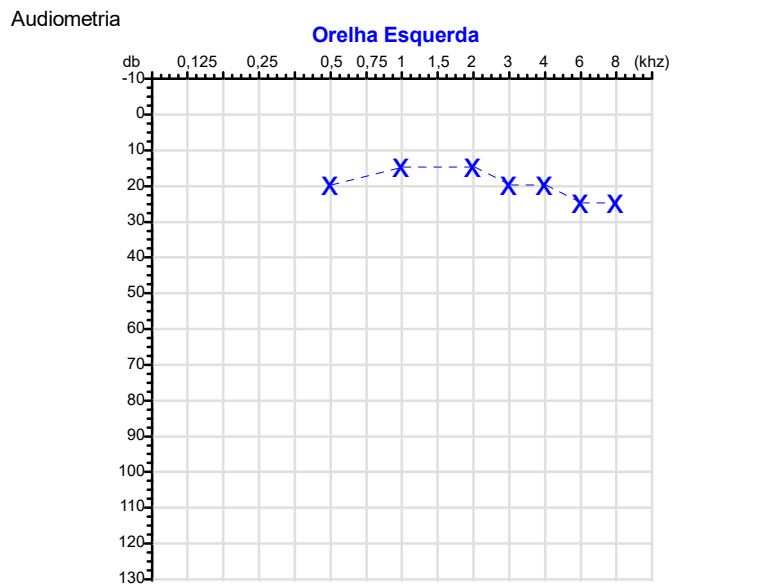


CPF :018.797.341-50 Paciente :Ewerton de Lima Pinto RG :15215105/SSP MT  
 CNPJ :00.467.600/0001-64 Razão :TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA  
 Nascimento :29/03/1986 Idade : 39 anos  
 Motivo :Admissional Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :ANALISTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO I  
 Data do Exame : 27/02/2026

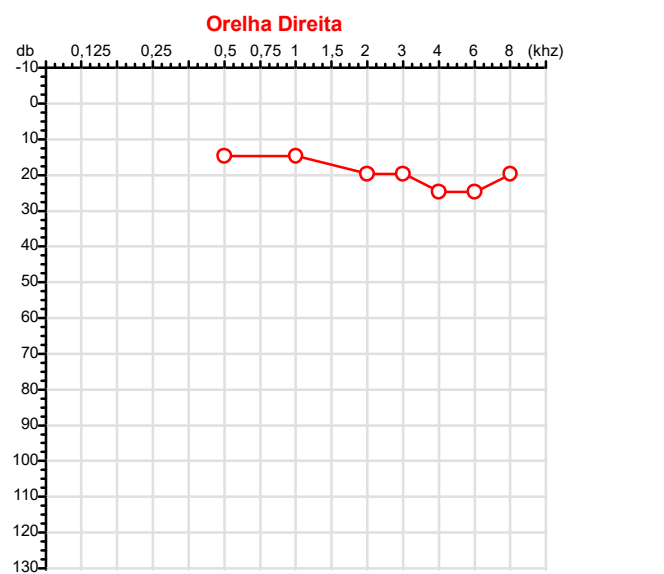

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	25

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

**Lauda Clínico OD**  
 Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :9CCB6326F869BEFE1A9E5779FDF63D01  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Ewerton de Lima Pinto*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025