



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 10395411000187 Fantasia : CLARIMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Razão Social : CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço : RUA 76 N.º 02 Complemento : QUADRA02 CPA III SETOR I
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78058000

Funcionário

Nome : Weberton Campos Dikerts Ferreira Setor: OPERACIONAL
CPF : 01284771130 Cargo: MOTORISTA
RG : / Nascimento: 30/10/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de fevereiro de 2026



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura : 79E101227EC2C4635F935A50BB3E6ECO
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :012.847.711-30	Paciente :Weberton Campos Dikerts Ferreira	RG :/
CNPJ : 10.395.411/0001-87	Razão :CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
Nascimento :30/10/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA	
Data do Exame : 27/02/2026		

Orelha Direita

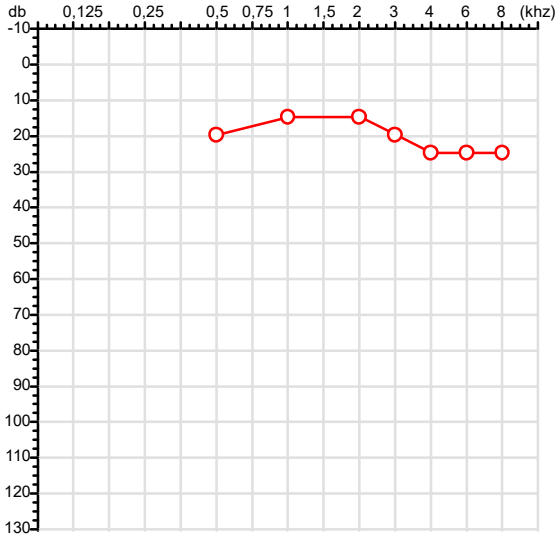

Audiometria

Orelha Esquerda

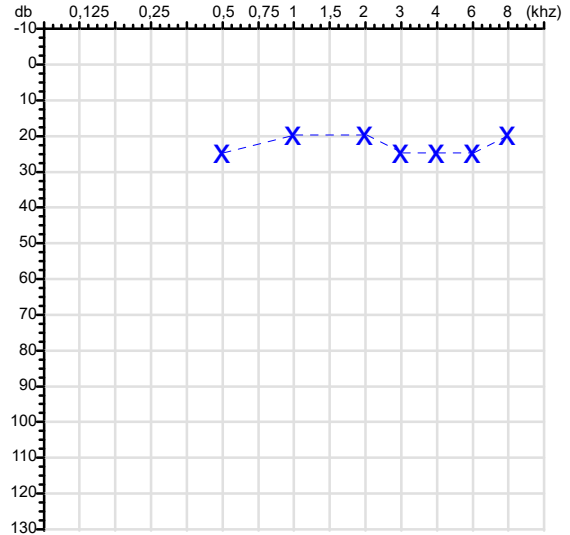

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EAB8293D3DF97D10F32B65FB890C1D98
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Weberton Campos Dikerts Ferreira
** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 803686
Primeiro Nome: WEBERTON CAMPOS
Sobrenome: FERREIRA
Data: 27/02/2026

Data de nascimento: 30/01/1987
Sexo : Macho
Peso (kg): 120.0
Altura (cm): 187.0

Capacidade Vital Forçada

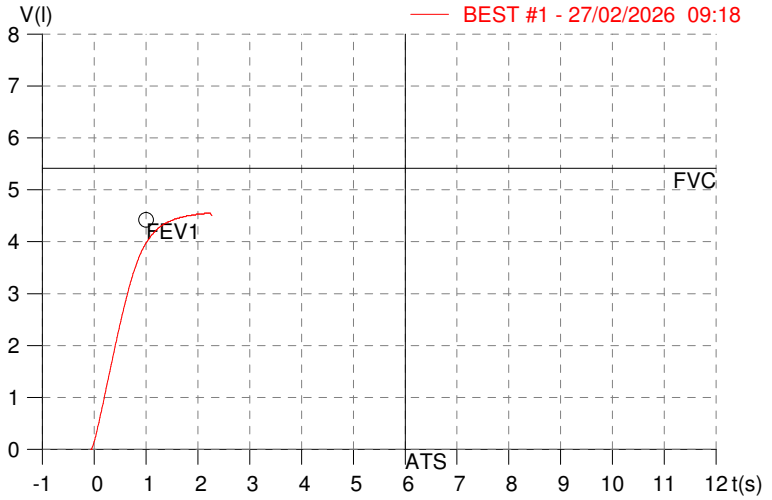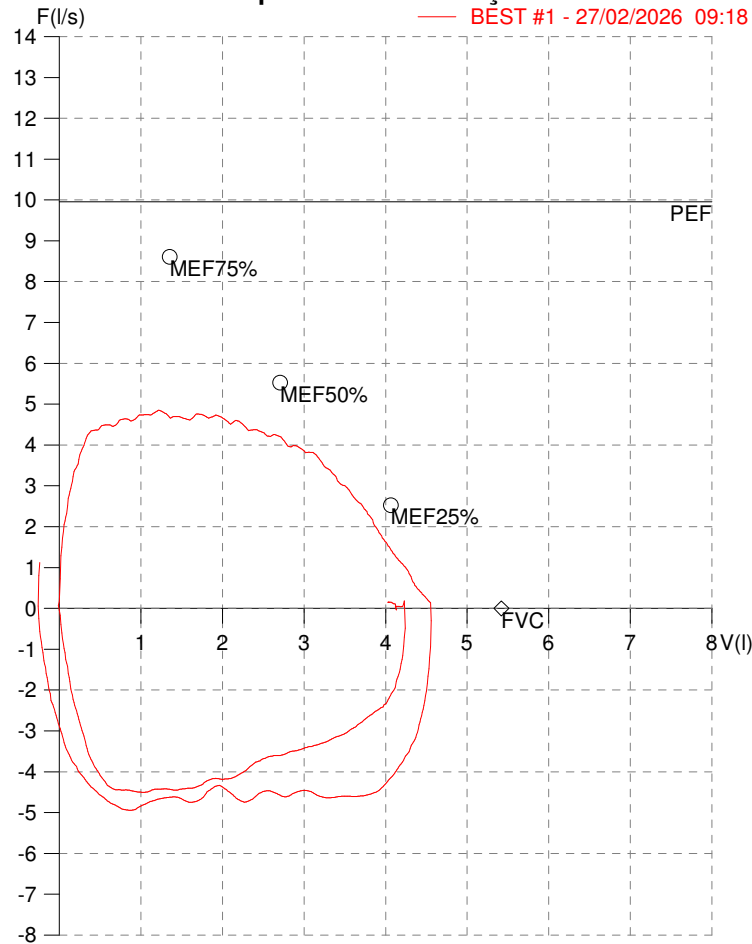

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.42	4.59	84.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.42	4.59	84.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.42	3.99	90.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.95	4.86	48.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.95	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.2	86.9	108.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.65	4.25	91.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.61	4.74	55.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.53	4.45	80.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.53	3.13	123.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	597.3	291.4	48.8

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 27/02/2026