



CPF :559.210.781-15 Paciente :Joselmo Camilo da Conceicao RG :/  
 CNPJ :14.574.632/0001-73 Razão :RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.  
 Nascimento :23/01/1975 Idade : 51 anos  
 Motivo :Demissional Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :MECANICO I  
 Data do Exame : 06/03/2026

**Orelha Direita**

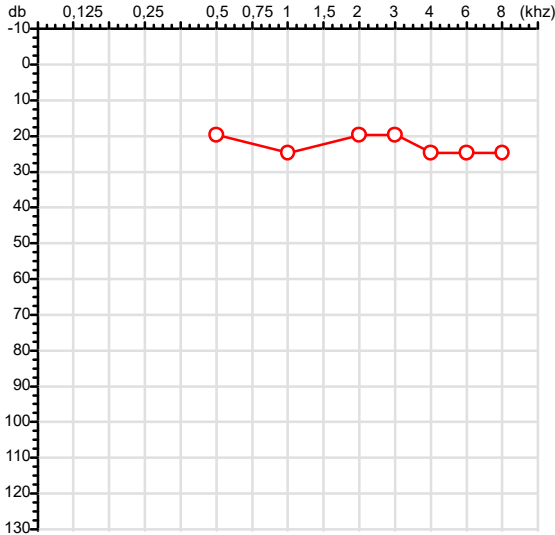

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

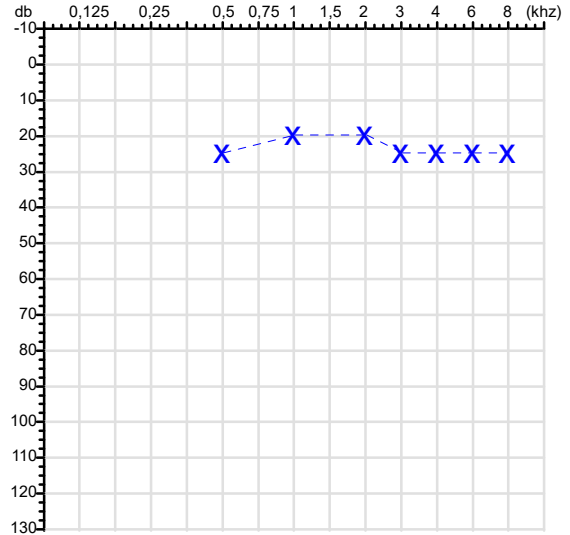

**Aérea**

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	25	25	25

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

**Ossea**

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	25	25	23

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :520CA93B21F34EB5DA736B031E710BB5  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joselmo Camilo da Conceicao*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025