



CPF :022.096.141-71 Paciente :Giovanna Carla Domingas Lemos RG :/
 CNPJ :26.504.759/0001-03 Razão :PROMINAS CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA
 Nascimento :15/06/1995 Idade : 30 anos
 Motivo :Demissional Setor :ADMINISTRATIVO
 Repouso :14h Função :ANALISTA AMBIENTAL II
 Data do Exame : 20/03/2026

Orelha Direita

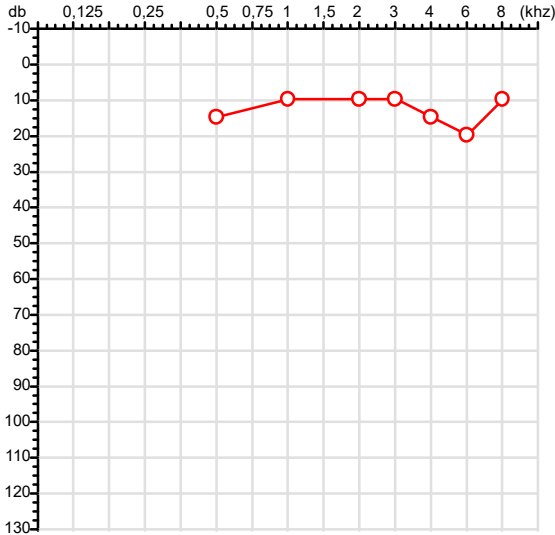

Audiometria

Orelha Esquerda

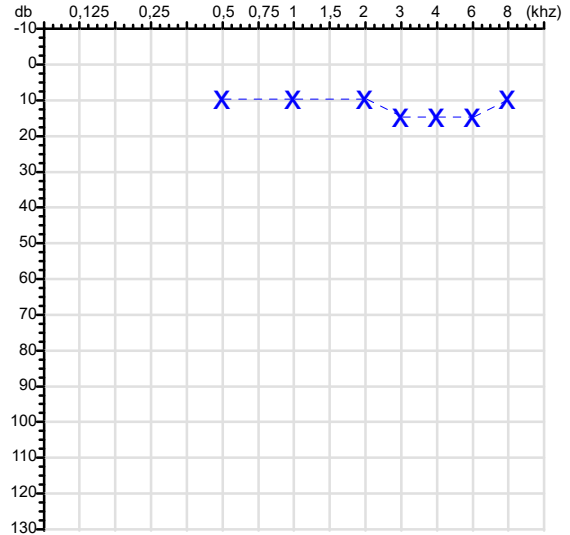

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	20	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3C20AD395D283349A5233845F9390224
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Giovanna Carla Domingas Lemos
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	GIOVANNA CARLA DOMINGAS LEMOS		ID1	809123	Sexo	Feminino	Idade	30,7	Peso (kg)	88,00	Altura (cm)	180,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	15/06/1995	ID2	--	BMI (kg/m2)	27,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,5% e um valor FVC de 3,88 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:09	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,88	4,40	88	
FEV1	L 3,58	3,70	97	
FEV1/FVC%	% 92,5	84,8	109	
FEV1/Vcmax%	% 92,5	84,8	109	

